Desempenho cirúrgico
personalizado

TSX®

Sistema de kit cirúrgico modular

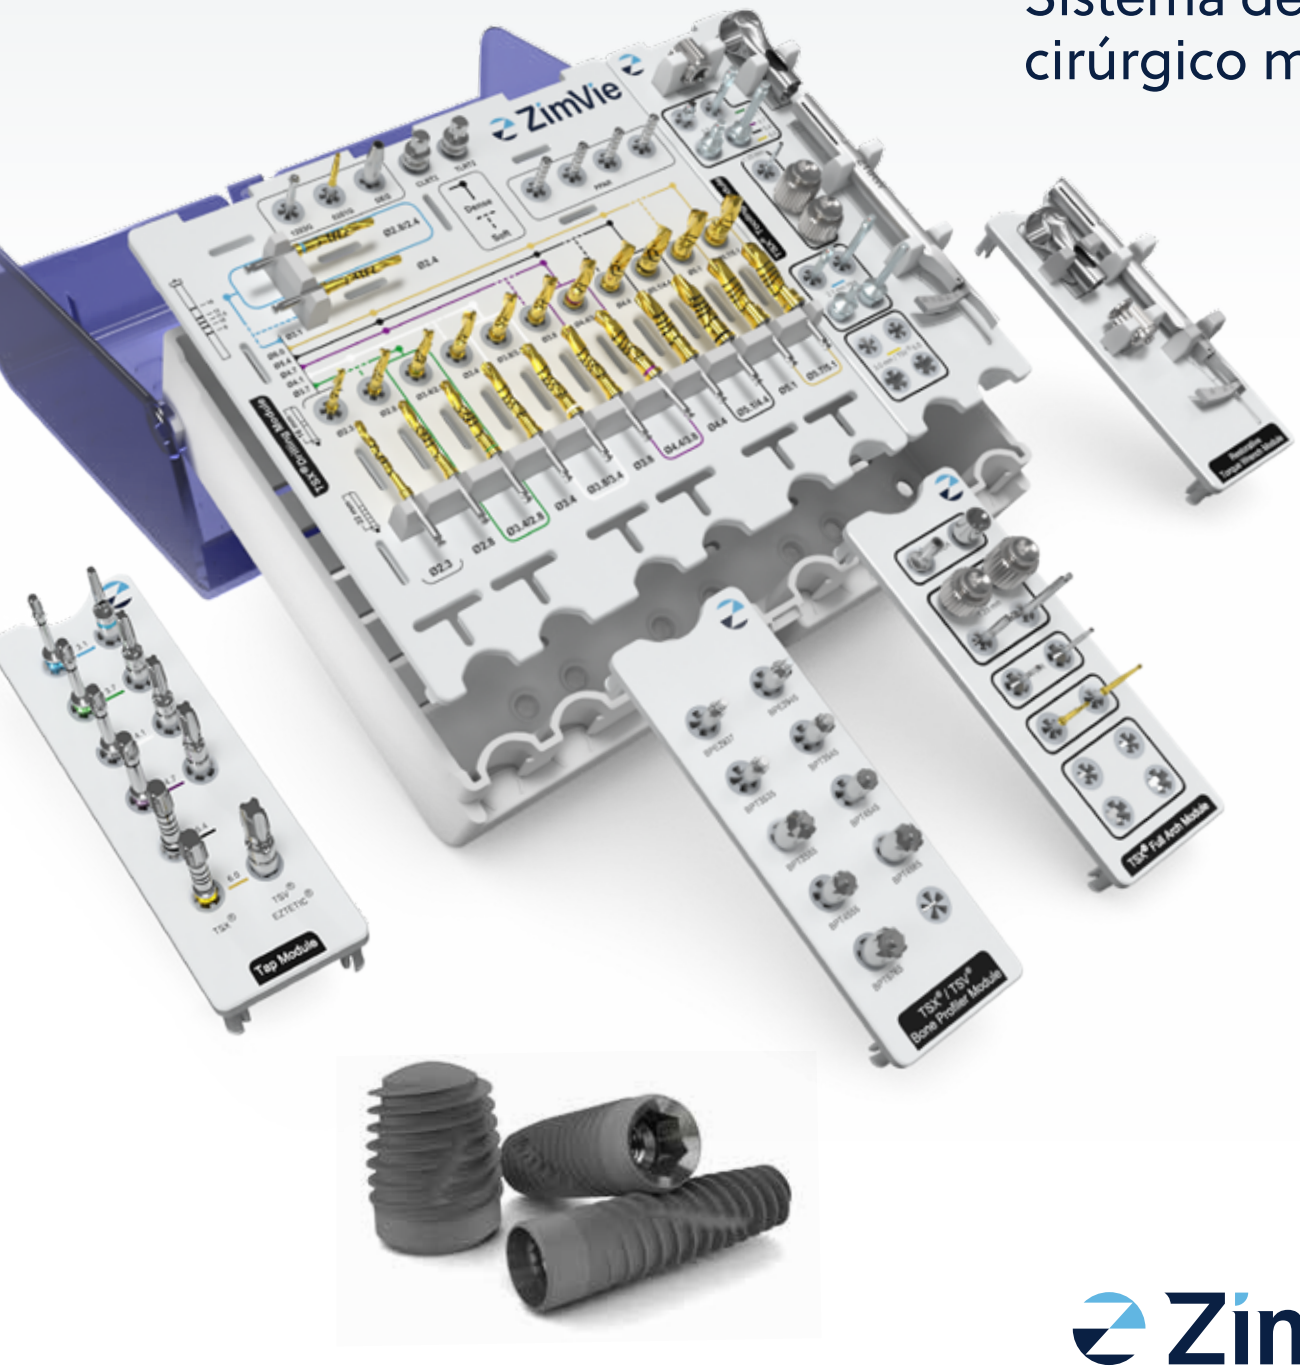

ZimVie

Adapta-se às suas necessidades clínicas

Desde instrumentos nucleares ate configurações especializadas

O **kit cirúrgico TSX®** (TSXKIT) oferece modularidade para se adaptar às suas necessidades clínicas e preferências personalizadas.

Com uma configuração de fácil navegação, o kit fornece instrumentos de preparação do local no nível superior, para colocação dos implantes TSX®, TSV® e Eztetic®.

Escolha exatamente o que precisa

Comece com o módulo de perfuração e o módulo de ferramentas no nível superior e, em seguida, adicione módulos e as suas ferramentas favoritas ao nível inferior para personalizar o kit e torná-lo seu.

MÓDULO DE FORMADORES DE ROSCA
TAPMOD

MÓDULO DE CRIAÇÃO DE PERFIS ÓSSEOS
TSXBPRO

MÓDULO VAZIO E ANILHAS EXTRA
Tem instrumentos favoritos? O espaço extra permite-lhe adicionar os seus favoritos pessoais

MÓDULO DE ARCADA COMPLETA
TSXRESTOR

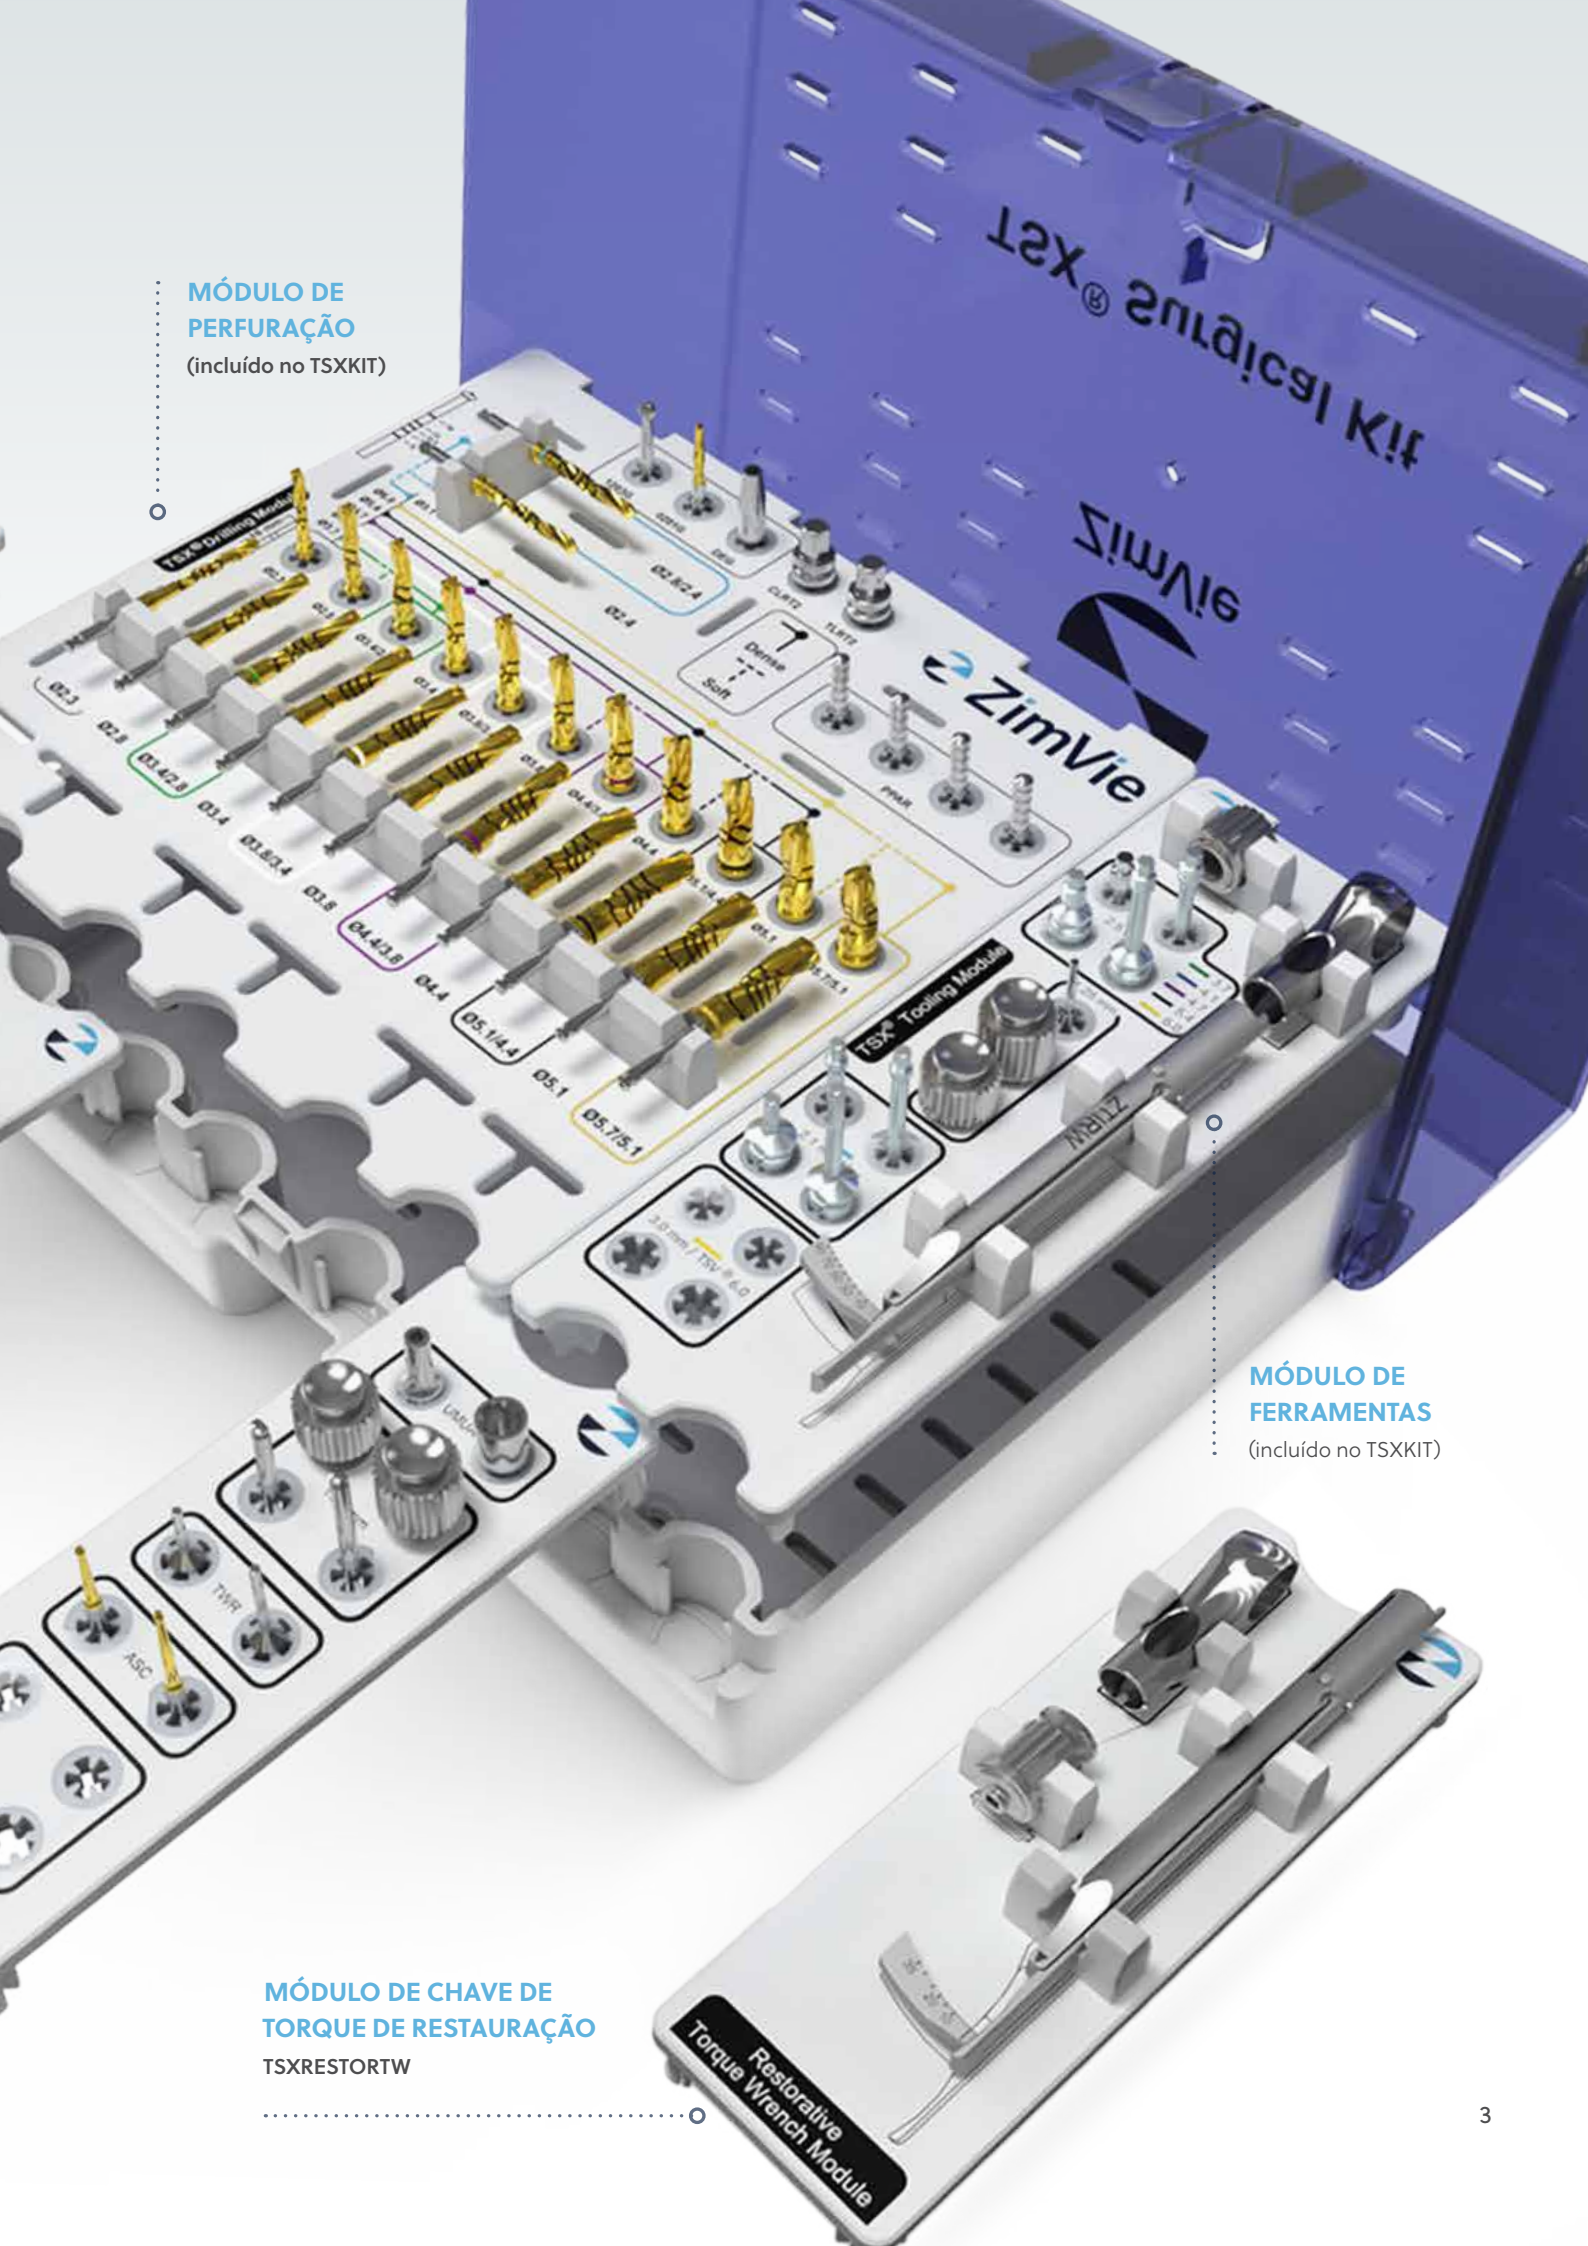

MÓDULO DE PERFURAÇÃO
(incluído no TSXKIT)

MÓDULO DE FERRAMENTAS
(incluído no TSXKIT)

MÓDULO DE CHAVE DE TORQUE DE RESTAURAÇÃO
TSXRESTORTW

Adicione exatamente o que precisa para personalizá-lo

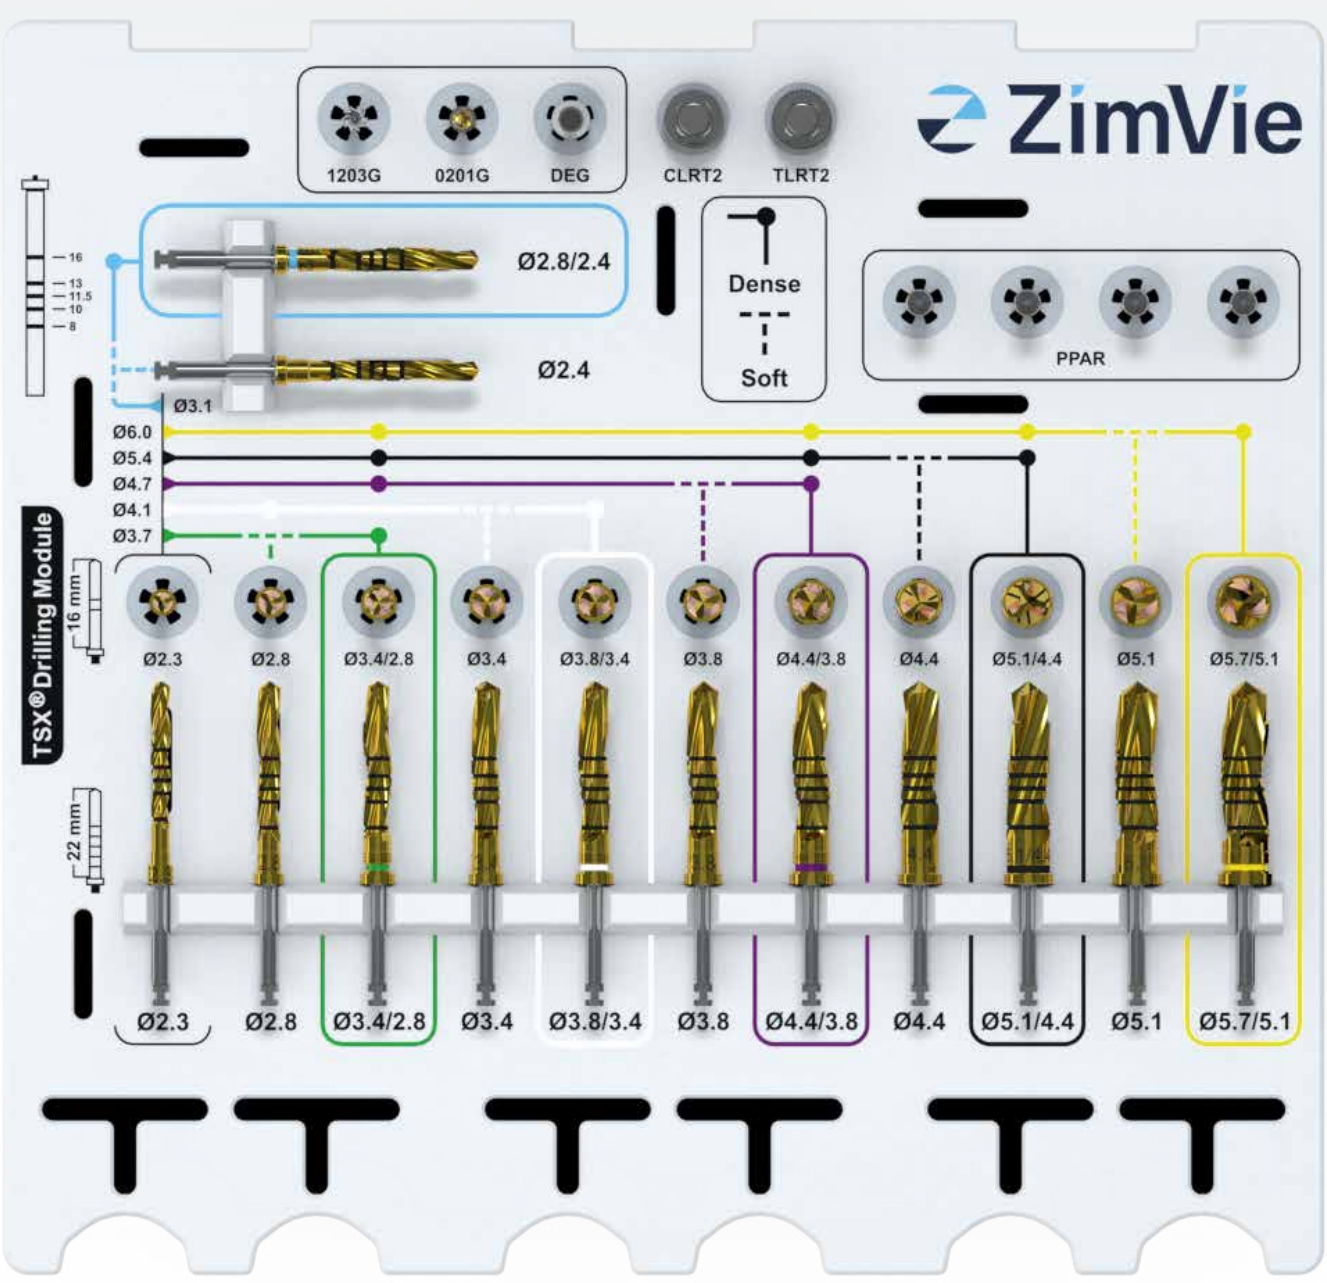

Módulo de perfuração

As linhas intuitivas codificadas por cores orientam a utilização das brocas Dríva® Gold Series em protocolos de ossos moles e densos para diâmetros de implante de 3,1 mm a 6,0 mm.

Módulo de ferramentas

As referências visuais úteis indicam as suas chaves GemLock® favoritas e ferramentas para a colocação de implantes.

Módulo de formadores de rosca

Formar ou não formar a rosca? Com várias configurações à escolha, terá sempre à disposição as opções que deseja.

Módulo de arcada completa

Para uma disposição organizada e conveniente dos pilares universais de restaurações múltiplas e respetivos componentes, para colocação na clínica, este módulo mantém ao seu alcance a instrumentação para arcada completa.

Módulo de chave de torque de restauração

Chega de procurar ferramentas! As suas chaves de torque de restauração TWR ou L-TIRW estão convenientemente disponíveis quando precisar.

NOTA: a chave de torque de restauração TWR pode ser colocada no módulo da chave de torque de restauração, do lado esquerdo.

Módulo de criação de perfis ósseos

Quer seja para implantes TSX, TSV ou Eztetic, todas as suas criações de perfis ósseos podem ser alojadas num único módulo.

Módulo vazio e anilhas extra

Tem instrumentos favoritos? O espaço extra permite-lhe adicionar os seus favoritos pessoais!

Kit cirúrgico TSX

Informações para encomendas

Descrição	N.º do artigo	TSXSTRKIT	TSXKIT
Tabuleiro cirúrgico TSX para módulos de perfuração e ferramentas, com tampa e base (vazio)	TSXTRAY	•	•
Broca esférica de 2,0 mm (D)	1203G		•
Broca piloto cónica de 2,1/1,6 mm (D), 8,0 mm–11,5 mm (C)	0201G	•	•
Extensor de broca	DEG	•	•
Ferramenta de remoção para pilares NP	CLRT2		•
Ferramenta de remoção para pilares hexagonais internos	TLRT2	•	•
Paralelizador (Qtd. 4)	PPAR	•	•
Broca escalonada de 2,8/2,4 mm (D), 22 mm (C)	EZT28D24G		•
Broca de 2,4 mm (D), 22 mm (C)	EZT24G		•
Broca de 2,3 mm (D), 16 mm (C)	TSV23SG	•	•
Broca de 2,8 mm (D), 16 mm (C)	TSV28SG	•	•
Broca escalonada de 3,4/2,8 mm (D), 16 mm (C)	TSV34D28SG	•	•
Broca de 3,4 mm (D), 16 mm (C)	TSV34SG	•	•
Broca escalonada de 3,8/3,4 mm (D), 16 mm (C)	TSV38D34SG	•	•
Broca de 3,8 mm (D), 16 mm (C)	TSV38SG	•	•
Broca escalonada de 4,4/3,8 mm (D), 16 mm (C)	TSV44D38SG	•	•
Broca de 4,4 mm (D), 16 mm (C)	TSV44SG		•
Broca escalonada de 5,1/4,4 mm (D), 16 mm (C)	TSV51D44SG		•
Broca de 5,1 mm (D), 16 mm (C)	TSV51SG		•
Broca escalonada de 5,7/5,1 mm (D), 16 mm (C)	TSV57D51SG		•
Broca de 2,3 mm (D), 22 mm (C)	TSV23G	•	•
Broca de 2,8 mm (D), 22 mm (C)	TSV28G	•	•
Broca escalonada de 3,4/2,8 mm (D), 22 mm (C)	TSV34D28G	•	•
Broca DE 3,4 mm (D), 22 mm (C)	TSV34G	•	•
Broca escalonada de 3,8/3,4 mm (D), 22 mm (C)	TSV38D34G	•	•
Broca de 3,8 mm (D), 22 mm (C)	TSV38G	•	•
Broca escalonada de 4,4/3,8 mm (D), 22 mm (C)	TSV44D38G	•	•
Broca de 4,4 mm (D), 22 mm (C)	TSV44G		•
Broca escalonada de 5,1/4,4 mm (D), 22 mm (C)	TSV51D44G		•
Broca de 5,1 mm (D), 22 mm (C)	TSV51G		•
Broca escalonada de 5,7/5,1 mm (D), 22 mm (C)	TSV57D51G		•
Chave de roquete indicadora de torque elevado (0–90 Ncm)	ZTIRW	•	•
Broca hexagonal GemLock de 2,5 mm (D), com encaixe de contra-ângulo, curta	GHX2.5D	•	•
Broca hexagonal GemLock de 2,5 mm (D), com encaixe de contra-ângulo, longa	GHX2.5DL	•	•
Chave hexagonal manual GemLock de 2,5 mm (D), curta	GHX2.5	•	•
Chave hexagonal manual GemLock de 2,5 mm (D), longa	GHX2.5L	•	•
Chave hexagonal de 1,25 mm (D), contra-ângulo, curta	HX1.25D	•	•
Chave hexagonal GemLock de 1,25 mm (D), longa	HXLGR1.25	•	•
Chave hexagonal GemLock de 1,25 mm (D), curta	HXGR1.25	•	•
Broca hexagonal GemLock de 2,1 mm (D), contra-ângulo, curta	CHD2.1		•
Broca hexagonal GemLock de 2,1 mm (D), contra-ângulo, longa	CHDL2.1		•
Chave hexagonal GemLock de 2,1 mm (D), curta	CHR2.1		•
Chave hexagonal GemLock de 2,1 mm (D), longa	CHRL2.1		•

Descrição	N.º do artigo	TSVTAPMOD	TSXTAPMOD	TAPMOD
Tabuleiro do módulo de formadores de rosca TSX (vazio)	TAPTRAY	•	•	•
Formador de rosca TSX de 3,1 mm (D)	TSXTAP31		•	•
Formador de rosca TSX de 3,7 mm (D)	TSXTAP37		•	•
Formador de rosca TSX de 4,1 mm (D)	TSXTAP41		•	•
Formador de rosca TSX de 4,7 mm (D)	TSXTAP47		•	•
Formador de rosca TSX de 5,4 mm (D)	TSXTAP54		•	•
Formador de rosca TSX de 6,0 mm (D)	TSXTAP60		•	•
Formador de rosca Eztetic 3,0 mm (D)	ZOPTT30	•		•
Formador de rosca TSV de 3,7 mm (D)	TT3.7	•		•
Formador de rosca TSV de 4,1 mm (D)	TT4.1	•		•
Formador de rosca TSV de 4,7 mm (D)	TT4.7	•		•
Formador de rosca TSV de 6,0 mm (D)	TT6.0	•		•

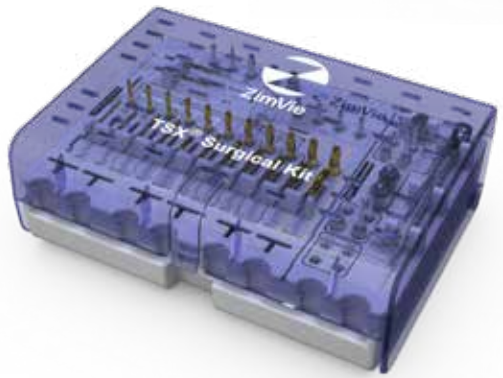

Kit cirúrgico TSX

Informações para encomendas

Módulo de arcada completa TSX

Número do artigo	Módulo/Ferramentas	Descrição
TSXRESTOR	**Módulo de arcada completa TSX** *com instrumentos*	Inclui tabuleiro para arcada completa [TSXRESTORTRAY] e instrumentos, para colocação na clínica, de pilares universais de restaurações múltiplas e TiBases em implantes TSX, TSV e Eztetic
TSXRESTORTRAY	**Módulo de arcada completa TSX**	Tabuleiro (vazio)
UMUA-D	**Chave Multi-Unit universal**	Utilizado com chave de torque TWR para apertar pilares UMUA retos
ISO4X4A	**Adaptador de chave de bloqueio ISO**	Utilizado com a chave de torque L-TIRW para apertar pilares UMUA
HXGR1.25	**Chave hexagonal GemLock**	Curto, 1,25 mm (D)
HXLGR1.25	**Chave hexagonal GemLock**	Comprido, 1,25 mm (D)
HX1.25D	**Chave hexagonal, contra-ângulo**	Curto, 1,25 mm (D)
HXL1.25D	**Chave hexagonal, contra-ângulo**	Comprido, 1,25 mm (D)
TW1.25	**Ponta para chave de torque hexagonal**	Curta, 1,25 mm (D), utilizada com a chave de torque TWR
TW1.25L	**Ponta para chave de torque hexagonal**	Comprido, 1,25 mm (D), utilizado com chave de torque TWR
ASC-SD24	**Chave de parafusos com canal de parafuso angulado**	24 mm (C), aperta o canal de parafuso angulado TiBase
ASC-SD30	**Chave de parafusos com canal de parafuso angulado**	30 mm (C), aperta o canal de parafuso angulado TiBase

Módulo de chave de torque de restauração TSX

Número do artigo	Módulo/Ferramentas	Descrição
TSXRESTORTW	**Módulo de chave de torque de restauração TSX** *com instrumentos*	Inclui tabuleiro de chaves de torque de restauração [TSXRESTORTWTRAY], L-TIRW e chaves de torque de restauração TWR
TSXRESTORTWTRAY	**Módulo de chave de torque de restauração TSX**	Tabuleiro (vazio)
L-TIRW	**Chave de roquete indicadora de baixo torque**	Inclui adaptador de bloqueio C9980, utilizado com chaves de ligação de bloqueio
TWR	**Chave de torque**	Utilizado com chaves TW1.25 e TW1.25L

Kit cirúrgico TSX

Informações para encomendas

Módulo de criação de perfis ósseos TSX

Número do artigo	Módulo/Ferramentas	Descrição
TSXBPRO	**Módulo de criação de perfis ósseos TSX** *para implantes TSX, TSV e Eztetic*	Inclui tabuleiro para criações de perfis ósseos [TSXBPROTRAY] e criações de perfis ósseos para Implantes TSX, TSV e Eztetic
TSXBPROTRAY	**Módulo de criação de perfis ósseos TSX**	Tabuleiro (vazio)
BPE2937	**Perfilador ósseo NP**	2,9 mm (D) x 3,7 mm (P)
BPE2945	**Perfilador ósseo NP**	2,9 mm (D) x 4,5 mm (P)
BPT3535	**Perfilador ósseo**	3,5 mm (D) x 3,5 mm (P)
BPT3545	**Perfilador ósseo**	3,5 mm (D) x 4,5 mm (P)
BPT3555	**Perfilador ósseo**	3,5 mm (D) x 5,5 mm (P)
BPT4545	**Perfilador ósseo**	4,5 mm (D) x 4,5 mm (P)
BPT4555	**Perfilador ósseo**	4,5 mm (D) x 5,5 mm (P)
BPT4565	**Perfilador ósseo**	4,5 mm (D) x 6,5 mm (P)
BPT5765	**Perfilador ósseo**	5,7 mm (D) x 6,5 mm (P)

Preferências modulares pessoais

Informações para encomendas

Kit cirúrgico e módulos TSX

Número do artigo	Kit cirúrgico	Descrição
TSXKIT	**Kit cirúrgico TSX** *para implantes TSX, TSV e Eztetic*	Inclui Tabuleiro Cirúrgico [TSXTRAY], Módulo de Broca e Módulo de Ferramentas, com instrumentos para colocar Implantes TSX de 3,1 mm (D), 3,7 mm (D), 4,1 mm (D), 4,7 mm (D), 5,4 mm (D) e 6,0 mm (D), Implantes TSV de 3,7 mm (D), 4,1 mm (D), 4,7 mm (D) e 6,0 mm (D) e Implantes Eztetic de 3,1 mm (D)
TSXSTRKIT	**Kit cirúrgico inicial TSX** *para implantes TSX e TSV*	Inclui tabuleiro cirúrgico [TSXTRAY], módulo de perfuração e módulo de ferramentas com instrumentos para implantes TSX e TSV de 3,7 mm (D), 4,1 mm (D) e 4,7 mm (D)
TAPMOD	**Módulo de formadores de rosca TSX** *para implantes TSX, TSV e Eztetic*	Inclui tabuleiro para formadores de rosca [TAPTRAY] e formadores de rosca TSX, TSV e Eztetic
TSXTAPMOD	**Módulo de formadores de rosca TSX** *para implantes TSX*	Inclui tabuleiro para formadores de rosca [TAPTRAY] e formadores de rosca TSX
TSVTAPMOD	**Módulo de formadores de rosca TSX** *para implantes TSV e Eztetic*	Inclui tabuleiro para formadores de rosca [TAPTRAY] e formadores de rosca TSV e Eztetic
TSXBPRO	**Módulo de criação de perfis ósseos TSX** *para implantes TSX, TSV e Eztetic*	Inclui tabuleiro para criações de perfis ósseos [TSXBPROTRAY] e criações de perfis ósseos para Implantes TSX, TSV e Eztetic
TSXRESTOR	**Módulo de arcada completa TSX**	Inclui tabuleiro para arcada completa [TSXRESTORTRAY] e instrumentos, para colocação na clínica, de pilares universais de restaurações múltiplas e TiBases em implantes TSX, TSV e Eztetic.
TSXRESTORTW	**Módulo de chave de torque de restauração TSX**	Inclui tabuleiro de chaves de torque de restauração [TSXRESTORTWTRAY]; chaves de torque de restauração L-TIRW e TWR
TSXTRAY	**Tabuleiro cirúrgico TSX**	Tabuleiros de módulos de perfuração e ferramentas com tampa e base (vazios)
TAPTRAY	**Módulo de formadores de rosca TSX**	Tabuleiro do módulo de formadores de rosca (vazio)
TSXBPROTRAY	**Módulo de criação de perfis ósseos TSX**	Tabuleiro para criações de perfis ósseos (vazio)
TSXRESTORTRAY	**Módulo de arcada completa TSX**	Arcada completa (vazio)
TSXRESTORTWTRAY	**Módulo de chave de torque de restauração TSX**	Chave de torque de restauração (vazia)
UNPMODTRAY	**Tabuleiro modular**	Tabuleiro (vazio), suporta com segurança instrumentos com fecho ISO

TSX® Surgical Kit
ZimVie
ZimVie
Ø2.8
Ø3.4
Ø3.4
Ø4.4
Ø5.1
Ø5.7/5.1

Para obter mais informações, visite ZimVie.com

ZimVie US Corp LLC
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Telefone: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272
dentalcs@ZimVie.com

ZimVie Spain S.L.U.
WTC Almeda Park, Ed. 4, Pl. 2
C/Tirso de Molina, 40 (entrada Plaça de la Pau)
08940, Cornellà de Llobregat, Espanha
Atención al cliente: 800-827-836
Fax para pedidos: +34-93-445-81-36
ZV.pedidos@ZimVie.com

Salvo indicação em contrário, conforme mencionado no presente documento, todas as marcas comerciais e os direitos de propriedade intelectual são propriedade da ZimVie Inc. e das suas afiliadas, e todos os produtos são fabricados por uma ou mais subsidiárias da divisão de medicina dentária da ZimVie US Corp LLC (Biomet 3i, LLC, etc.) e distribuídos pela ZimVie US Corp LLC e pelos seus parceiros de comercialização autorizados. A chave de roquete indicadora de alto torque Z-TIRW é fabricada pela Elos Medtech Pinol A/S. A TRW é fabricada pela Josef Ganter GmbH. Os instrumentos universais de restaurações multi-unit e TiBase são fabricados pela Terrats Medical S.L. Classificação de dispositivos médicos da UE: Implantes TSV, TSX e Eztetic (Classe IIb), componentes de restauração (Classe IIb), instrumentos dentários (Classe IIa; I). Os implantes dentários destinam-se a substituir dentes individuais em falta (restaurações de um único dente), vários dentes ou restaurar arcadas dentárias edêntulas (ponte fixa retida por implantes, sobredentadura suportada por implantes). Os instrumentos dentários destinam-se a facilitar a implantação e explantação dos implantes dentários correspondentes e a serem utilizados em conjunto com dispositivos e processos de restauração dentária. Os produtos aqui apresentados não são elegíveis para reembolso em França. Para outros países, consulte as leis e os regulamentos locais. Para obter informações adicionais sobre os produtos, consulte a rotulagem individual dos produtos ou as instruções de utilização respetivas. Os produtos podem não estar disponíveis ou autorizados em determinados países/regiões. Este material destina-se apenas a profissionais médicos e não constitui parecer ou recomendações médicas. É proibida a distribuição a qualquer outro destinatário. Este material não pode ser copiado nem reproduzido sem o expresso consentimento escrito da ZimVie. ZV2413-GLBL-PT REV A 12/25 ©2025 ZimVie. Todos os direitos reservados.

O número do ON aplicável a cada dispositivo pode ser encontrado na rotulagem do produto, se aplicável.

CE 0426 CE 0051 CE