Produktkatalog

# TSX®

## Implantatsystem

ZimVie

ZimVie ZAHNÄRZTLICHE LÖSUNGEN

# Inhaltsverzeichnis


**Implantate** **3**
TSX® Implantate 3

**Einheilkomponenten** **4**
Richtlinien zur Auswahl von Gingivaformern 4
Encode® Emergence Gingivaformer 4
Gingivaformer 5

**Restaurative Lösungen** **6**
Herkömmliche Abdruck-Transfers 6
Provisorische Restaurationen 7
Digitale Restaurationen 8
Zementierte Restaurationen 10
Angussfähige Goldrestaurationen 13
Verschraubte Restaurationen 14
OverdenSURE® herausnehmbares Attachment-System 17
Prothetische Instrumente 20

**Chirurgie-Kit und Instrumente** **22**
Instrumenten-Kit-Systemübersicht 22
Chirurgische Bohrer der Dríva Gold Serie 31
Instrumente für die geführte Chirurgie 35
Knochenkonturierer 37

## TSX Implantat

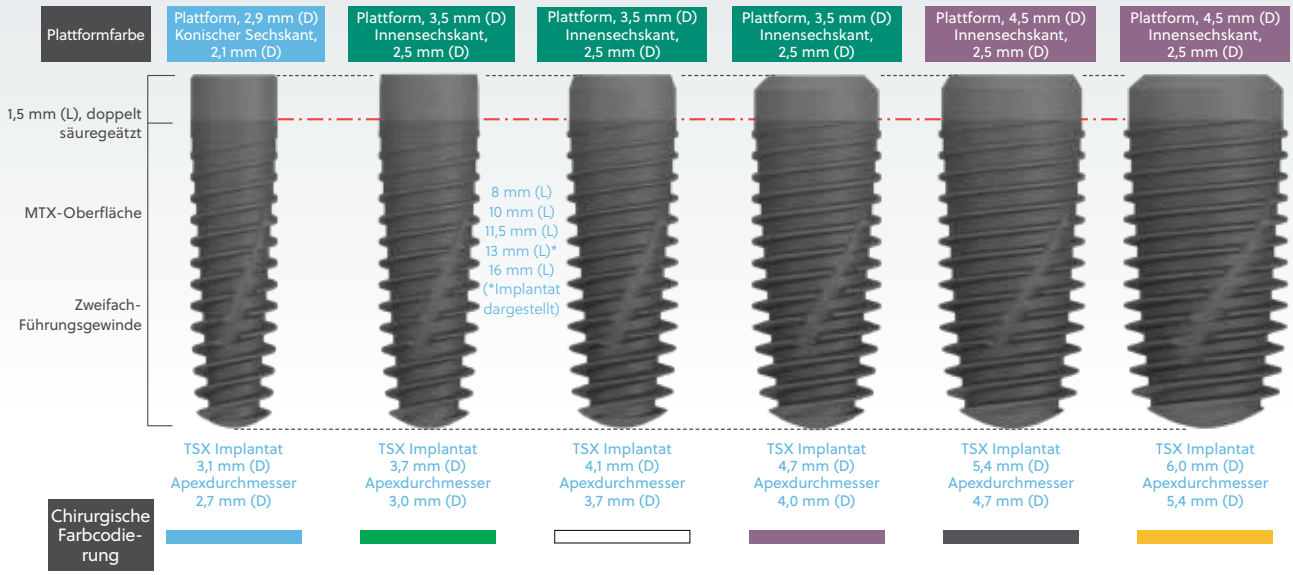


## TSX Short Implantate (6 mm (L))

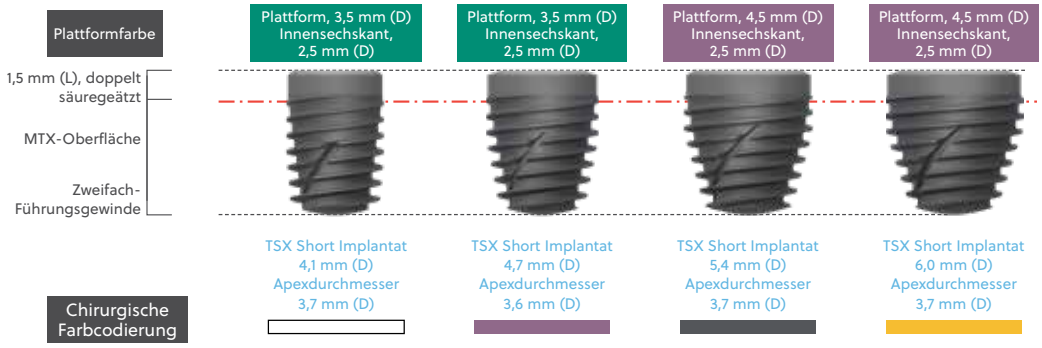


## Chirurgische Deckschrauben

Im Lieferumfang des Implantats enthalten.

| Implantatplattform | | |
|---|---|---|
| NP (2,9 mm (D)) | 3,5 mm (D) | 4,5 mm (D) |
| CCSNP | TSC | TSCW |

## TSX Implantate

Enthält eine Abdeckschraube und einen optionalen Ausrichtungsstift, der die parallele Insertion mehrerer Implantate erleichtert.

| Implantat-durchmesser | Implantat-plattform | Innensechskant-verbindung | Implantatlänge | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6 mm (L) | 8 mm (L) | 10 mm (L) | 11,5 mm (L) | 13 mm (L) | 16 mm (L) |
| 3,1 mm (D) | 2,9 mm (D) | 2,1 mm (D) | - | TSX31B8 | TSX31B10 | TSX31B11 | TSX31B13 | TSX31B16 |
| 3,7 mm (D) | 3,5 mm (D) | 2,5 mm (D) | - | TSX37B8 | TSX37B10 | TSX37B11 | TSX37B13 | TSX37B16 |
| 4,1 mm (D) | 3,5 mm (D) | 2,5 mm (D) | TSX41B6 | TSX41B8 | TSX41B10 | TSX41B11 | TSX41B13 | TSX41B16 |
| 4,7 mm (D)* | 3,5 mm (D) | 2,5 mm (D) | TSX47B6 | TSX47B8 | TSX47B10 | TSX47B11 | TSX47B13 | TSX47B16 |
| 5,4 mm (D) | 4,5 mm (D) | 2,5 mm (D) | TSX54B6 | TSX54B8 | TSX54B10 | TSX54B11 | TSX54B13 | TSX54B16 |
| 6,0 mm (D)* | 4,5 mm (D) | 2,5 mm (D) | TSX6B6 | TSX6B8 | TSX6B10 | TSX6B11 | TSX6B13 | TSX6B16 |

*Hinweis: Im Gegensatz zu TSV® Implantaten besitzt das Implantat mit 4,7 mm (D) eine grün farbcodierte Plattform mit 3,5 mm (D) und das Implantat mit 6,0 mm (D) eine violett farbcodierte Plattform mit 4,5 mm (D).

# Einheilkomponenten

## Richtlinien zur Auswahl von Gingivaformern

### Auswahl eines Gingivaformers:

- Bestimmen Sie die Größe der Implantatplattform.
- Wählen Sie das Emergenzprofil aus, das am besten zur zu versorgenden Position passt. Das Profil muss zum Transfer und/oder zum verwendeten Abutment passen.
- Wählen Sie die Schulterhöhe so aus, dass das obere Ende der Komponente leicht über das umgebende Gewebe hinausragt.




**HC3/TEEHA3 = Gingivaformer für Implantatplattform, 3,5 mm (D)**
**HC4/TEEHA4 = Gingivaformer für Implantatplattform, 4,5 mm (D)**

Beispiel:
TEEHA333 = Gingivaformer für Implantatplattform, 3,5 mm (D), Emergenzprofil 3,8 mm (D), Schulterhöhe 3,0 mm (mittlere Ziffer = Profil, letzte Ziffer = Höhe)
HC343 = Gingivaformer für Implantatplattform, 3,5 mm (D), Emergenzprofil 4,5 mm (D), Schulterhöhe 3,0 mm (zweite Ziffer = Profil, dritte Ziffer = Höhe)

## Encode Emergence Gingivaformer*

Der Encode Gingivaformer ist ein zweiteiliger 3-in-1-Gingivaformer/Abformpfosten/Scankörper.

| Implantat-plattform | Emergenzprofil | Schulterhöhe | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 3,0 mm | 5,0 mm | 7,0 mm |
| 2,9 mm (D) | 3,7 mm (D) | CEEHA333 | CEEHA335 | CEEHA337 |
| 2,9 mm (D) | 4,5 mm (D) | CEEHA343 | CEEHA345 | CEEHA347 |
| 3,5 mm (D) | 3,8 mm (D) | TEEHA333 | TEEHA335 | TEEHA337 |
| 3,5 mm (D) | 5,0 mm (D) | TEEHA353 | TEEHA355 | TEEHA357 |
| 3,5 mm (D) | 6,5 mm (D) | TEEHA363 | TEEHA365 | TEEHA367 |
| 4,5 mm (D) | 4,5 mm (D) | TEEHA443 | TEEHA445 | TEEHA447 |
| 4,5 mm (D) | 5,5 mm (D) | TEEHA453 | TEEHA455 | TEEHA457 |
| 4,5 mm (D) | 6,5 mm (D) | TEEHA463 | TEEHA465 | TEEHA467 |
| 4,5 mm (D) | 7,5 mm (D) | TEEHA473 | TEEHA475 | TEEHA477 |

* Nicht in allen Märkten erhältlich.

## Gingivaformer

| Implantatplattform | Emergenzprofil | Schulterhöhe | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1,5 mm | 3,0 mm | 4,5 mm |
| NP (2,9 mm (D)) | 3,7 mm (D) | CHCNP31 | CHCNP33 | CHCNP34 |
| NP (2,9 mm (D)) | 4,5 mm (D) | CHCNP41 | CHCNP43 | CHCNP44 |

| Implantatplattform | Emergenzprofil | Schulterhöhe | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 3,0 mm | 5,0 mm | 7,0 mm |
| 3,5 mm (D) | 3,5 mm (D) (kein Profil) | HC333 | HC335 | — |
| 3,5 mm (D) | 4,5 mm (D) | HC343 | HC345 | HC347 |
| 3,5 mm (D) | 5,5 mm (D) | HC353 | HC355 | — |
| 4,5 mm (D) | 4,5 mm (D) (kein Profil) | HC443 | HC445 | — |
| 4,5 mm (D) | 5,5 mm (D) | HC453 | HC455 | HC457 |
| 4,5 mm (D) | 6,5 mm (D) | HC463 | HC465 | — |

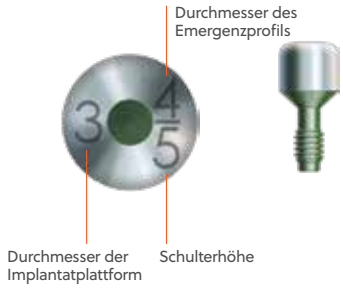

# Restaurative Lösungen

## Herkömmliche Abdruck-Transfers

### Einbringhilfen/Abdruckpfosten

Nicht im Lieferumfang des TSX Implantats enthalten. Einschließlich Halteschraube (URS2). Kann als präparierbares temporäres Abutment verwendet werden.

| Implantatplattform | Emergenzprofil | Artikelnr. |
|---|---|---|
| 3,5 mm (D) | 4,5 mm (D) | FMT3 |
| 4,5 mm (D) | 5,5 mm (D) | FMT4 |
| Ersatz-Halteschraube | — | URS2 |

### Indirekte Transfers (geschlossener Löffel)

Farbcodiert nach Implantatplattform. Einschließlich Halteschraube (CASLT).

| Implantatplattform | Emergenzprofil | Schulterhöhe | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1,5 mm | 3,0 mm | 4,5 mm |
| NP (2,9 mm (D)) | 3,7 mm (D) | CITNP31 | CITNP33 | CITNP34 |
| NP (2,9 mm (D)) | 4,5 mm (D) | CITNP41 | CITNP43 | CITNP44 |
| Ersatz-Halteschraube | | CASLT | CASLT | CASLT |

Farbcodiert nach Implantatplattform. Einschließlich Halteschraube (HLTS2).

| Implantatplattform | Emergenzprofil | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3,5 mm (D) | 4,5 mm (D) | 5,5 mm (D) | 6,5 mm (D) |
| 3,5 mm (D) | HLT3/3 | HLT3/4 | HLT3/5 | — |
| 4,5 mm (D) | — | HLT4/4 | HLT4/5 | HLT4/6 |
| 3,0 mm Verlängerungsschraube für indirekten Transfer | HLTE | HLTE | HLTE | HLTE |
| Ersatz-Halteschraube | HLTS2 | HLTS2 | HLTS2 | HLTS2 |

### Direkte Transfers (offener Löffel)

Farbcodiert nach Implantatplattform. Einschließlich Halteschraube (CASLC).

| Implantatplattform | Emergenzprofil | Schulterhöhe | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1,5 mm | 3,0 mm | 4,5 mm |
| NP (2,9 mm (D)) | 3,7 mm (D) | CDTNP31 | CDTNP33 | CDTNP34 |
| NP (2,9 mm (D)) | 4,5 mm (D) | CDTNP41 | CDTNP43 | CDTNP44 |
| Ersatz-Halteschraube | | CASLC | CASLC | CASLC |

Farbcodiert nach Implantatplattform. Einschließlich Halteschraube (DHTS).

| Implantatplattform | Emergenzprofil | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3,5 mm (D) | 4,5 mm (D) | 5,5 mm (D) | 6,5 mm (D) |
| 3,5 mm (D) | DHT3/3 | DHT3/4 | DHT3/5 | — |
| 4,5 mm (D) | — | DHT4/4 | DHT4/5 | DHT4/6 |
| Ersatz-Halteschraube | DHTS | DHTS | DHTS | DHTS |

### Titan-Implantatanaloge für Gipsmodelle

Farbcodiert nach Implantatplattform.

| Implantatplattform | Artikelnr. |
|---|---|
| NP (2,9 mm (D)) | CIANP |
| 3,5 mm (D) | IA3 |
| 4,5 mm (D) | IA4 |

## Provisorische Restaurationen

### Temporäres Abutment aus Titan

Einschließlich Halteschraube (CUAS) und langer Verarbeitungsschraube (CASLC).

| Implantatplattform | Emergenzprofil | Artikelnr. |
|---|---|---|
| NP (2,9 mm (D)) | 3,5 mm (D) | CTANP31 |
| Ersatz-Halteschraube | | CUAS |
| Ersatz-Verarbeitungsschraube, lang | | CASLC |

### Temporäre Kunststoff-Abutments, gerade

Einschließlich Halteschraube und Verarbeitungsschraube (DHTS2).

| Implantatplattform | Emergenzprofil | Schulterhöhe | |
|---|---|---|---|
| | | 1,0 mm | 4,0 mm |
| 3,5 mm (D) | 4,5 mm (D) | PT341S | PT344S |
| 4,5 mm (D) | 5,5 mm (D) | PT451S | PT454S |
| Ersatz-Halteschraube, lang | | DHTS2 | DHTS2 |

### Temporäre Kunststoff-Abutments, abgewinkelt, 17°

Einschließlich Halteschraube und Verarbeitungsschraube (DHTS2).

| Implantatplattform | Emergenzprofil | Schulterhöhe | |
|---|---|---|---|
| | | 1,0 mm | 4,0 mm |
| 3,5 mm (D) | 4,5 mm (D) | PT341A | PT344A |
| 4,5 mm (D) | 5,5 mm (D) | PT451A | PT454A |
| Ersatz-Halteschraube, lang | | DHTS2 | DHTS2 |

# Digitale Restaurationen

## GenTek® Ti-Basen mit abgewinkeltem Schraubenkanal

Ti-Basis mit Rotationsschutz einschließlich Sechsrund-Halteschraube und Klebeschraube

| Implantatplattform | Schulterhöhe | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,3 mm | 1,0 mm | 1,3 mm | 1,7 mm | 2,6 mm |
| NP (2,9 mm (D)) | - | ZFX11ZB-EZ29AS10E | - | ZFX11ZB-EZ29AS17E | ZFX11ZB-EZ29AS26E |
| 3,5 mm (D) | ZFX11ZB-TSV35AS03E | - | ZFX11ZB-TSV35AS13E | - | ZFX11ZB-TSV35AS26E |
| 4,5 mm (D) | ZFX11ZB-TSV45AS03E | - | ZFX11ZB-TSV45AS13E | - | ZFX11ZB-TSV45AS26E |

* Nicht in allen Märkten erhältlich

Ti-Basis ohne Rotationsschutz einschließlich Sechsrund-Halteschraube und Klebeschraube

| Implantatplattform | Schulterhöhe | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,3 mm | 1,0 mm | 1,3 mm | 1,7 mm |
| NP (2,9 mm (D)) | - | ZFX11ZB-EZ29AS10N | - | ZFX11ZB-EZ29AS17N |
| 3,5 mm (D) | ZFX11ZB-TSV35AS03N | - | ZFX11ZB-TSV35AS13N | - |
| 4,5 mm (D) | ZFX11ZB-TSV45AS03N | - | ZFX11ZB-TSV45AS13N | - |

* Nicht in allen Märkten erhältlich

## Patientenspezifische Abutments

Erhältlich in Titan.

Computergestützte Konstruktion und individuell gefräste CAD/CAM-Präzision.
Weitere Informationen erhalten Sie von einem ZimVie Dental Mitarbeiter.

**Hinweis:** Patientenspezifische Abutments sind nur in ausgewählten Märkten erhältlich.

## ASC-Ersatzschrauben

| Beschreibung | Artikelnr. |
|---|---|
| GenTek ASC-Schraube (2,9 mm (D)) | ZFX09-ZB-EZ-HLRS |
| GenTek ASC-Schraube (3,5/4,5/5,7 mm (D)) | ZFX09-ZB-TSV-HLRS |

## GenTek Scanbodies

Inklusive ASC-Schraube

| Implantatplattform | Artikelnr. |
|---|---|
| NP (2,9 mm (D)) | ZFX05Z-ZB-EZ-29 |
| 3,5 mm (D) | ZFX05Z-ZB-TSV-35 |
| 4,5 mm (D) | ZFX05Z-ZB-TSV-45 |

## Digitale Implantatanaloge*

Inklusive ASC-Schraube

| Implantatplattform | Artikelnr. |
|---|---|
| NP (2,9 mm (D)) | ZFX15Z-ZB-EZ-29 |
| 3,5 mm (D) | ZFX15Z-ZB-TSV-35 |
| 4,5 mm (D) | ZFX15Z-ZB-TSV-45 |

* Nicht in allen Märkten erhältlich

# Zementierte Restaurationen

## Farbcodierungstabelle: Emergenzprofil bei Hex-Lock Contour und Short Restaurationsabutments/-komponenten

Die Farben entsprechen dem Emergenzprofil des Abutments bei Hex-Lock® Contour und Short Abutments sowie den zugehörigen Contour und Short restaurativen Komponenten.

| Abutment-Emergenzprofil* | Farbcodierung |
|---|---|
| 4,5 mm (D) | Hellbraun |
| 5,5 mm (D) | Rosa |

*Für Hex-Lock Contour und Short restaurative Komponenten.

## Hex-Lock Contour Abutments, gerade

Einschließlich Halteschraube (CUAS).

| Implantatplattform | Emergenzprofil | Schulterhöhe | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1,5 mm | 3,0 mm | 4,5 mm |
| NP (2,9 mm (D)) | n. z. 3,7 mm (D)* | CANP31S | CANP33S | CANP34S |
| NP (2,9 mm (D)) | 4,5 mm (D)* | CANP41S | CANP43S | CANP44S |
| Ersatz-Halteschraube | | CUAS | CUAS | CUAS |

* Contour Komponenten mit Emergenzprofil 3,7 mm (D) sind nicht mit Contour restaurativen Komponenten mit 3,5 mm (D) kompatibel.

Einschließlich Halteschraube (MHLAS).

| Implantatplattform | Emergenzprofil | Schulterhöhe | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1,0 mm | 2,0 mm | 3,0 mm |
| 3,5 mm (D) | 4,5 mm (D) | ZOA341S | ZOA342S | ZOA343S |
| 4,5 mm (D) | 4,5 mm (D) | ZOA441S | ZOA442S | ZOA443S |
| 4,5 mm (D) | 5,5 mm (D) | ZOA451S | ZOA452S | ZOA453S |
| Ersatz-Halteschraube | | MHLAS | MHLAS | MHLAS |

## Hex-Lock Contour Abutments, abgewinkelt, 17°

Einschließlich Halteschraube (CUASA oder CUAS).

| Implantatplattform | Emergenzprofil | Schulterhöhe | |
|---|---|---|---|
| | | 1,5 mm | 3,0 mm |
| NP (2,9 mm (D)) | 3,7 mm (D)* | CANP31A | CANP33A |
| NP (2,9 mm (D)) | 4,5 mm (D)** | CANP41A | CANP43A |
| Ersatz-Halteschraube | | CUASA | CUAS |

Einschließlich Halteschraube (AH20S).

| Implantatplattform | Emergenzprofil | Schulterhöhe | |
|---|---|---|---|
| | | 1,0 mm | 2,0 mm |
| 3,5 mm (D) | 4,5 mm (D) | ZOA341A | ZOA342A |
| 4,5 mm (D) | 4,5 mm (D) | ZOA441A | ZOA442A |
| 4,5 mm (D) | 5,5 mm (D) | ZOA451A | ZOA452A |
| Ersatz-Halteschraube | | AH20S | AH20S |

## Contour Abutment-Einproben und Einprobe-Kit

| Implantatplattform | Emergenzprofil | Beschreibung | Artikelnr. |
|---|---|---|---|
| 3,5 mm (D) | 4,5 mm (D) | Set mit 5 Stück: verschiedene Winkel, Schulterhöhen | ZOAT34 |
| 4,5 mm (D) | 5,5 mm (D) | Set mit 5 Stück: verschiedene Winkel, Schulterhöhen | ZOAT45 |
| Alle | Alle | 3 Sets mit 5 Stück: Alle Größen | ZOATKIT |

## Contour Provisoriumskappen

| Emergenzprofil | Gerade | 17° |
|---|---|---|
| 4,5 mm (D) | ZCPROV4S | ZCPROV4A |
| 5,5 mm (D) | ZCPROV5S | ZCPROV5A |

## Contour Abdruckkappen

| Emergenzprofil | Gerade | 17° |
|---|---|---|
| 4,5 mm (D) | ZOCIMP4S | ZOCIMP4A |
| 5,5 mm (D) | ZOCIMP5S | ZOCIMP5A |

## Contour Abutmentanaloga, Titan

| Emergenzprofil | Gerade | 17° |
|---|---|---|
| 4,5 mm (D) | TCANA4S | TCANA4A |
| 5,5 mm (D) | TCANA5S | TCANA5A |

## Contour Aufwachskappen

| Emergenzprofil | Gerade | 17° |
|---|---|---|
| 4,5 mm (D) | ZOCWAX4S | ZOCWAX4A |
| 5,5 mm (D) | ZOCWAX5S | ZOCWAX5A |

## Hex-Lock Short Abutments

Einschließlich Halteschraube (MHLAS).

| Implantatplattform | Emergenzprofil | Schulterhöhe | |
|---|---|---|---|
| | | 1,0 mm | 2,0 mm |
| 3,5 mm (D) | 4,5 mm (D) | SA341 | SA342 |
| 4,5 mm (D) | 5,5 mm (D) | SA451 | SA452 |
| Ersatz-Halteschraube | | MHLAS | MHLAS |

## Short Provisoriumskappen

| Emergenzprofil | Artikelnr. |
|---|---|
| 4,5 mm (D) | SAPROVP4 |
| 5,5 mm (D) | SAPROVP5 |

## Short Abdruckkappen

| Emergenzprofil | Artikelnr. |
|---|---|
| 4,5 mm (D) | SAIMP4 |
| 5,5 mm (D) | SAIMP5 |

## Short Abutmentanaloga, Titan

| Emergenzprofil | Artikelnr. |
|---|---|
| 4,5 mm (D) | SAANA4 |
| 5,5 mm (D) | SAANA5 |

## Short Aufwachskappen

| Emergenzprofil | Artikelnr. |
|---|---|
| 4,5 mm (D) | SAWAX4 |
| 5,5 mm (D) | SAWAX5 |

## Hex-Lock Abutments

Einschließlich Halteschraube (MHLAS).

| Implantatplattform | Emergenzprofil | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3,5 mm (D) | 4,5 mm (D) | 5,5 mm (D) | 6,5 mm (D) |
| 3,5 mm (D) | HLA3/3 | HLA3/4 | HLA3/5 | — |
| 4,5 mm (D) | — | HLA4/4 | HLA4/5 | HLA4/6 |
| Ersatz-Halteschraube, kurz | MHLAS | MHLAS | MHLAS | MHLAS |
| Ersatz-Halteschraube, lang | HLTS2 | HLTS2 | HLTS2 | HLTS2 |

## Abgewinkelte Abutments, 20°

Einschließlich Halteschraube (CUAS).

| Implantatplattform | Emergenzprofil | Artikelnr. |
|---|---|---|
| NP (2,9 mm (D)) | 3,5 mm (D) | C20A3 |
| Ersatz-Halteschraube | | CUAS |

Einschließlich Halteschraube (AH2OS).

| Implantatplattform | Emergenzprofil | Artikelnr. |
|---|---|---|
| 3,5 mm (D) | 4,5 mm (D) | AH20/4 |
| 4,5 mm (D) | 5,5 mm (D) | AH20W/5 |
| Ersatz-Halteschraube | — | AH20S |

# Angussfähige Goldrestaurationen

## Angussfähige Gold-Abutments, rotationsgesichert

Einschließlich Halteschraube (CUAS).

| Implantatplattform | Emergenzprofil | Artikelnr. |
|---|---|---|
| NP (2,9 mm (D)) | 3,5 mm (D) | CEANP31 |
| Ersatz-Halteschraube | | CUAS |
| Lange Verarbeitungsschraube | | CASLC |

Einschließlich Halteschraube (MHLAS).

| Implantatplattform | Artikelnr. |
|---|---|
| 3,5 mm (D) | HLA3G |
| 4,5 mm (D) | HLA4G |
| Ersatz-Halteschraube | MHLAS |
| Aufwachsschraube für angussfähige Abutments | MTWSD |

## Angussfähige Gold-Abutments, nicht rotationsgesichert

Einschließlich Halteschraube (MHLAS).

| Implantatplattform | Artikelnr. |
|---|---|
| 3,5 mm (D) | NEA3G |
| 4,5 mm (D) | NEA4G |
| Ersatz-Halteschraube | MHLAS |

# Verschraubte Restaurationen

## Gerade Universal Multi-Unit Abutments

Ohne Rotationsschutz; das Abutment greift nicht in die Innensechskantverbindung. Nicht für Einzelzahnrestaurationen geeignet.
Einheilkappe (UMUA-HCS) separat erhältlich.

| Implantatplattform | Schulterhöhe | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1,0 mm | 2,0 mm | 3,0 mm | 4,0 mm | 5,0 mm |
| NP (2,9 mm (D)) | UMUA-NP291S | UMUA-NP292S | UMUA-NP293S | UMUA-NP294S | UMUA-NP295S |
| 3,5 mm (D) | UMUA-TSV351S | UMUA-TSV352S | UMUA-TSV353S | UMUA-TSV354S | UMUA-TSV355S |
| 4,5 mm (D) | UMUA-TSV451S | UMUA-TSV452S | UMUA-TSV453S | UMUA-TSV454S | UMUA-TSV455S |

## Abgewinkelte Universal Multi-Unit Abutments, 17°

Die Abutments greifen in die Innensechskantverbindung. Nicht für Einzelzahnrestaurationen geeignet (mit vormontierter Halteschraube).

| Implantatplattform | Schulterhöhe | |
|---|---|---|
| | 2,5 mm | 3,5 mm |
| NP (2,9 mm (D)) | UMUA-NP2925-17S | UMUA-NP2935-17S |
| 3,5 mm (D) | UMUA-TSV3525-17S | UMUA-TSV3535-17S |
| 4,5 mm (D) | UMUA-TSV4525-17S | UMUA-TSV4535-17S |

## Abgewinkelte Universal Multi-Unit Abutments, 30°

Die Abutments greifen in die Innensechskantverbindung. Nicht für Einzelzahnrestaurationen geeignet (mit vormontierter Halteschraube).

| Implantatplattform | Schulterhöhe | |
|---|---|---|
| | 3,5 mm | 4,5 mm |
| NP (2,9 mm (D)) | UMUA-NP2935-30S | UMUA-NP2945-30S |
| 3,5 mm (D) | UMUA-TSV3535-30S | UMUA-TSV3545-30S |
| 4,5 mm (D) | UMUA-TSV4535-30S | UMUA-TSV4545-30S |

## Einheilkappe für Universal-Abutment

Die Einheilkappe wird auf das Universal Multi-Unit Abutment und das abgewinkelte Multi-Unit Abutment geschraubt.

| Beschreibung | Artikelnr. |
|---|---|
| Einheilkappe für Universal-Abutment | UMUA-HCS |

## Abformpfosten für Universal-Abutment

Der Abformpfosten wird für die Abformung auf das Universal Multi-Unit Abutment und das abgewinkelte Multi-Unit Abutment geschraubt. Mit dieser Methode wird die Abutmentposition übertragen.

| Beschreibung | Höhe | Artikelnr. |
|---|---|---|
| Universal-Abutment-Abformpfosten, offener Löffel<br>Enthält Transferschrauben | 12 mm | UMUA-OTIC |
| Universal-Abutment-Abformpfosten, geschlossener Löffel | 5 mm | UMUA-CTICS |
| Universal-Abutment-Abformpfosten, geschlossener Löffel (Menge: 4) | 5 mm | UMUA-CTICS4 |
| Universal-Abutment-Abformpfosten, geschlossener Löffel | 8 mm | UMUA-CTICL |
| Universal-Abutment-Abformpfosten, geschlossener Löffel (Menge: 4) | 8 mm | UMUA-CTICL4 |

## Universal-Abutment-Scanbodies

Der Scanbody wird auf das Universal Multi-Unit Abutment und das abgewinkelte Multi-Unit Abutment geschraubt.

| Beschreibung | Artikelnr. |
|---|---|
| Universal-Abutment-Scanbody, intraoral | UMUA-SBIO |
| Universal-Abutment-Scanbody, Ti-Basis (Menge: 5) | UMUA-SBTB5 |
| Universal-Abutment-Scanbody, Desktop<br>Enthält Multi-Unit-Schraube (UMUA-S) | UMUA-SBDT |

## Universal-Abutment-Ti-Basis

Die Ti-Basis wird auf das Universal Multi-Unit Abutment und das abgewinkelte Multi-Unit Abutment geschraubt.

| Beschreibung | Höhe | Artikelnr. |
|---|---|---|
| Universal-Abutment-Ti-Basis<br>Enthält Multi-Unit-Schraube (UMUA-S) | 6 mm | UMUA-TTS |
| Universal-Abutment-Ti-Basis<br>Enthält Multi-Unit-Schraube (UMUA-S) | 8 mm | UMUA-TTL |

## Universal-Abutment-Ti-Basis mit abgewinkeltem Schraubenkanal

| Beschreibung | Artikelnr. |
|---|---|
| Universal-Abutment-Ti-Basis mit abgewinkeltem Schraubenkanal<br>Enthält Schraube für abgewinkelten Schraubenkanal (UMUA-ASCTS) | UMUA-ASCT |

## Universal-Abutment-Analog für Gipsmodelle

| Beschreibung | Artikelnr. |
|---|---|
| Universal-Abutment-Analog | UMUA-A |

## Digitales Universal-Abutment-Analog

| Beschreibung | Artikelnr. |
|---|---|
| Digitales Universal-Abutment-Analog<br>Enthält Multi-Unit-Schraube (UMUA-S) | UMUA-DA |

## Ersatzschrauben für Universal Multi-Unit-Komponenten

| Beschreibung | Artikelnr. |
|---|---|
| Universal Multi-Unit-Schraube | UMUA-S |
| Universal Schraube für abgewinkelten Schraubenkanal | UMUA-ASCTS |

## Zylinderprovisorium für Universal-Abutment

Das Zylinderprovisorium wird auf das Universal Multi-Unit Abutment und das abgewinkelte Multi-Unit Abutment geschraubt.

| Beschreibung | Artikelnr. |
|---|---|
| Zylinderprovisorium für Universal-Abutment<br>Enthält Multi-Unit-Schraube (UMUA-S) | UMUA-TCS |

## Universal-Abutment OverdenSURE Attachment

| Beschreibung | Artikelnr. |
|---|---|
| OverdenSURE Attachment für Universal-Abutment | UMUA-ODS |

# OverdenSURE herausnehmbares Attachment-System

## OverdenSURE Abutments

### Alle Märkte außerhalb der USA

Retentionsset ODS-RIKIT2001 enthalten. In allen aktiven Regionen außer den USA erhältlich.

| Implantatplattform | Schulterhöhe | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1,0 mm | 2,0 mm | 3,0 mm | 4,0 mm | 5,0 mm | 6,0 mm |
| NP (2,9 mm (D)) | ODS-NP201 | ODS-NP202 | ODS-NP203 | ODS-NP204 | ODS-NP205 | ODS-NP206 |
| 3,5 mm (D) | ODS-TSV301 | ODS-TSV302 | ODS-TSV303 | ODS-TSV304 | ODS-TSV305 | ODS-TSV306 |
| 4,5 mm (D) | ODS-TSV401 | ODS-TSV402 | ODS-TSV403 | ODS-TSV404 | ODS-TSV405 | ODS-TSV406 |

## OverdenSURE Retentionseinsätze
## Alle Märkte außerhalb der USA

| Beschreibung | Artikelnr. |
|---|---|
| Retentionsset, 20° (Menge: 1 Set) | ODS-RIKIT2001 |
| Retentionsset, 20° (Menge: 2 Sets) | ODS-RIKIT2002 |
| Retentionsset, 40° (Menge: 1 Set) | ODS-RIKIT4001 |
| Retentionsset, 40° (Menge: 2 Sets) | ODS-RIKIT4002 |
| Blauer Retentionseinsatz, 20° (Menge: 4) | ODS-RIB2004 |
| Rosafarbener Retentionseinsatz, 20° (Menge: 4) | ODS-RIP2004 |
| Transparenter Retentionseinsatz, 20° (Menge: 4) | ODS-RIC2004 |
| Roter Retentionseinsatz, 40° (Menge: 4) | ODS-RIR4004 |
| Gelber Retentionseinsatz, 40° (Menge: 4) | ODS-RIY4004 |
| Grüner Retentionseinsatz, 40° (Menge: 4) | ODS-RIG4004 |

## OverdenSURE Instrumente und Zubehör

| Beschreibung | Artikelnr. |
|---|---|
| Abutment-Steg-Attachment (Menge: 1) | ODS-BARATT01 |
| Abutment-Steg-Attachment (Menge: 2) | ODS-BARATT02 |
| Abutment-Steg-Attachment (Menge: 4) | ODS-BARATT04 |
| Abutment-Schraubendreher | ODS-DRVR |
| Analog (Menge: 1) | ODS-AA01 |
| Analog (Menge: 4) | ODS-AA04 |
| Analog (Menge: 10) | ODS-AA010 |
| Abstandsring zum Ausblocken (Menge: 20) | ODS-BS020 |
| Abformpfosten (Menge: 1) | ODS-IC01 |
| Abformpfosten (Menge: 4) | ODS-IC04 |
| Abformpfosten (Menge: 10) | ODS-IC010 |
| Retentionsgehäusekappe (Menge: 1) | ODS-RH01 |
| Retentionsgehäusekappe (Menge: 4) | ODS-RH04 |
| Retentionsgehäusekappe (Menge: 10) | ODS-RH010 |
| Abzieh- und Einsetzinstrument | ODS-IRTOOL |
| Scanbody (Menge: 10) | ODS-SB010 |

## Kugelkopf-Abutments

Die Abutments greifen nicht in die Innensechskantverbindung. Inklusive Kappengeschiebe-Hülse und Nylon-Retentionshülse.
Kugelkopf-Abutments für die NP-Plattform enthalten keine Kappengeschiebe-Hülse und keine Nylon-Retentionshülse.

| Implantatplattform | Schulterhöhe | | |
|---|---|---|---|
| | 2,0 mm | 4,0 mm | 6,0 mm |
| NP (2,9 mm (D)) | CBANP2 | CBANP4 | CBANP6 |
| 3,5 mm (D) | BAC2 | BAC4 | BAC6 |
| 4,5 mm (D) | BACW2 | BACW4 | BACW6 |

## Transferkomponenten für Kugelkopf-Abutments

| Beschreibung | Artikelnr. |
|---|---|
| Kugelkopf-Abutment-Transfer (Menge: 2) | BAT |
| Kugelkopf-Abutment-Laboranalog | BAR |

## Prothetische Komponenten

| Beschreibung | Artikelnr. |
|---|---|
| Kappengeschiebe-Hülse (CAH)/Kappengeschiebe-Nylon-Retentionshülse (CAN) | CA |
| Kappengeschiebe-Hülse | CAH |
| Kappengeschiebe-Nylon-Retentionshülse, transparent | CAN |
| Kappengeschiebe-Nylon-Retentionshülse, grau – starre Retention | CAN-G |
| Transfer für Kappengeschiebe | CAT |
| Ausbrennbares Kugelkopfmuster, 2 Kugeln pro Muster | CAB |
| Nylon-Retentionshülse mit Mikrokappengeschiebe | CANM |

# Prothetische Instrumente

## Drehmomentschlüssel und -ratschen

| Beschreibung | Artikelnr. |
|---|---|
| Drehmomentratsche für Restaurationen<br>Einstellbarer Drehmomentbereich 10 Ncm – 35 Ncm | TWR |
| Ratsche mit Drehmomentanzeige für niedrigen Drehmomentbereich (einschließlich C9980 Latchlock Adapter) | L-TIRW |
| Standard-ISO-1797-Latchlock-Adapter für Ratsche mit Drehmomentanzeige für niedrigen Drehmomentbereich | C9980 |
| GemLock Vierkant-Ratsche mit Haltefunktion zur restaurativen Verwendung mit HX1.25, HXL1.25 und SRT | RSR |

Hinweis: Ziehen Sie chirurgische und prothetische Schrauben nicht über das im technischen Handbuch und/oder in der Gebrauchsanweisung angegebene empfohlene Drehmoment hinaus an.

## Sechskantschraubendreher, 1,25 mm (D), für chirurgische und prothetische Schrauben

| Beschreibung | Verwendungsart | Artikelnr. |
|---|---|---|
| Sechskantschlüssel mit GemLock Haltefunktion, kurz, 1,25 mm (D), 22 mm (L) | Manuell | HXGR1.25 |
| Sechskantschlüssel, lang, mit GemLock Haltefunktion, 1,25 mm (D), 30 mm (L) | Manuell | HXLGR1.25 |
| Sechskant-Winkelstückeinsatz für chirurgische und prothetische Schrauben, kurz, 1,25 mm (D), 23 mm (L)<br>Erfordert möglicherweise ein Reduzierhandstück | Handstück, L-TIRW | HX1.25D |
| Sechskant-Winkelstückeinsatz für chirurgische und prothetische Schrauben, lang, 1,25 mm (D), 26 mm (L)<br>Erfordert möglicherweise ein Reduzierhandstück | Handstück, L-TIRW | HXL1.25D |
| Sechskanteinsatz für Drehmomentratsche, kurz, 1,25 mm (D), 17 mm (L) | TWR | TW1.25 |
| Sechskanteinsatz für Drehmomentratsche, lang, 1,25 mm (D), 22 mm (L) | TWR | TW1.25L |
| Sechskantschraubendreher, kurz, Standard, 1,25 mm (D), 17 mm (L) | RSR | HX1.25 |
| Sechskantschraubendreher, lang, Standard, 1,25 mm (D), 22 mm (L) | RSR | HXL1.25 |

## Prothetische Instrumente für Universal Multi-Unit Abutments

| Beschreibung | Artikelnr. |
|---|---|
| Multi-Unit-Schraubendreher für Universal-Abutments | UMUA-D |
| ISO-Verriegelung, 4x4-Schraubendreher | ISO4X4A |
| Schraubendreher für abgewinkelte Schraubenkanäle, 24 mm (L) | ASC-SD24 |
| Schraubendreher für abgewinkelte Schraubenkanäle, 30 mm (L) | ASC-SD30 |

## Instrumente für abgewinkelte Schraubenkanäle für GenTek Abutments

| Beschreibung | Verwendungsart | Artikelnr. |
|---|---|---|
| Schraubendreher für abgewinkelten Schraubenkanal, 24 mm (L) | TWR | TASCD24 |
| Schraubendreher für abgewinkelten Schraubenkanal, 30 mm (L) | TWR | TASCD30 |
| Spitze für Schraubendreher für abgewinkelten Schraubenkanal, 21 mm (L) | L-TIRW | ZFX02HLD21 |
| Spitze für Schraubendreher für abgewinkelten Schraubenkanal, 28 mm (L) | L-TIRW | ZFX02HLD28 |
| Spitze für Schraubendreher für abgewinkelten Schraubenkanal, 36 mm (L) | L-TIRW | ZFX02HLD36 |

## Abziehinstrumente

| Beschreibung | Verwendungsart | Artikelnr. |
|---|---|---|
| Abziehinstrument für NP-Abutments (2,9 mm (D)) | Manuell oder RSR | CLRT2 |
| Abziehinstrument für Innensechskant-Implantat-Abutments<br>In den TSV Chirurgie-Kits TSVKIT und STRKIT enthalten | Manuell oder RSR | TLRT2 |
| Abziehinstrument für Abutment- oder Halte-schrauben mit 1,25 mm (D) Sechskant, Hartmetall<br>Hinweis: Nicht autoklavieren | RSR | SRT |

## Zusätzliche prothetische Instrumente und Zubehör

| Beschreibung | Artikelnr. |
|---|---|
| Prothetik-Tray, autoklavierbar, leer | 2320 |
| Abutmenthalter<br>Erfordert ein Implantatanalog zur Befestigung von Abutments | ABTH |

# Übersicht über das modulare TSX® Chirurgie-Kit-System

1
**1203G**
2,0 mm (D)
Rosenbohrer

2
**0201G**
2,1/1,6 mm (D)
Konischer Pilotbohrer,
8,0 mm – 11,5 mm (L)

3
**DEG**
Bohrerverlängerung

4
**CLRT2**
Abziehinstrument für
NP-Abutments

5
**TLRT2**
Abziehinstrument
für Innensechskant-
Abutments

6
**PPAR**
Parallelisierungspfosten
(Menge: 4)

7
**EZT28D24G**
2,8/2,4 mm (D)
Stufenbohrer,
22 mm (L)

8
**EZT24G**
22 mm (L)
Bohrer,
2,4 mm (D)

9
**TSV23SG**
2,3 mm (D)
Bohrer,
16 mm (L)

10
**TSV28SG**
2,8 mm (D)
Bohrer,
16 mm (L)

11
**TSV34D28SG**
3,4/2,8 mm (D)
Stufenbohrer,
16 mm (L)

12
**TSV34SG**
3,4 mm (D)
Bohrer,
16 mm (L)

13
**TSV38D34SG**
3,8/3,4 mm (D)
Stufenbohrer,
16 mm (L)

## Bohrmodul (in TSXKIT enthalten)

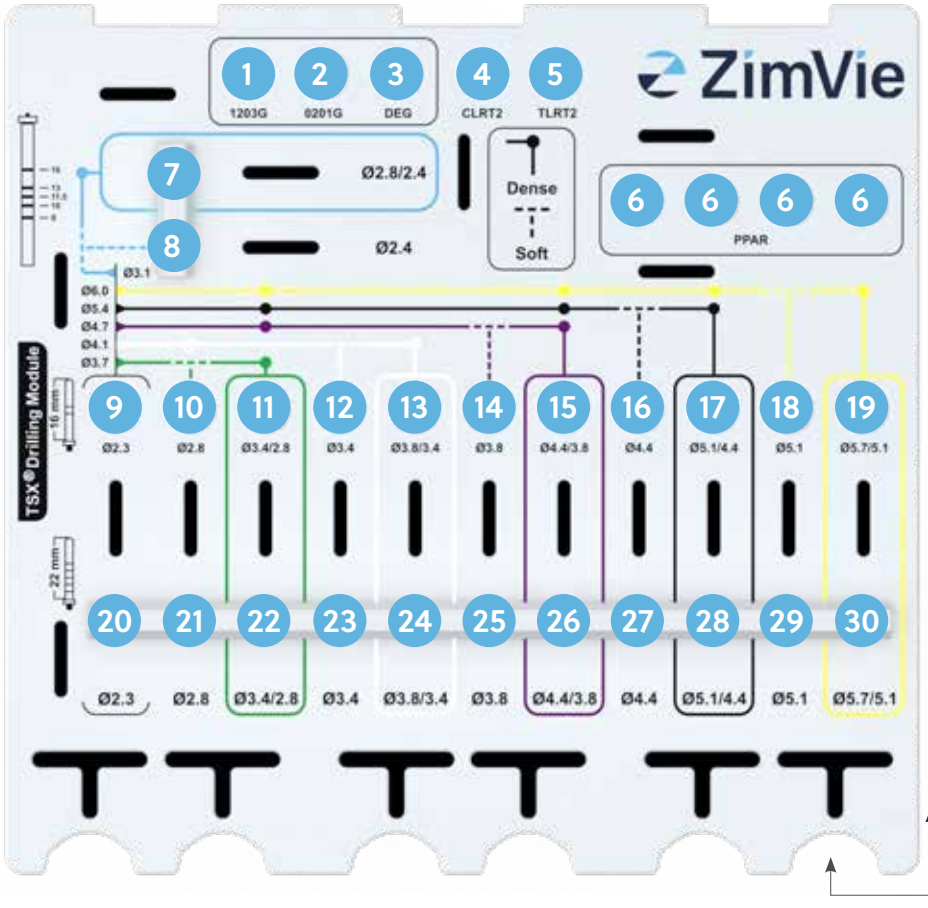

17
**TSV51D44SG**
5,1/4,4 mm (D)
Stufenbohrer,
16 mm (L)

18
**TSV51SG**
5,1 mm (D)
Bohrer,
16 mm (L)

22
**TSV34D28G**
3,4/2,8 mm (D)
Stufenbohrer,
22 mm (L)

23
**TSV34G**
3,4 mm (D)
Bohrer,
22 mm (L)

27
**TSV44G**
22 mm (L)
Bohrer,
4,4 mm (D)

28
**TSV51D44G**
5,1/4,4 mm (D)
Stufenbohrer,
22 mm (L)

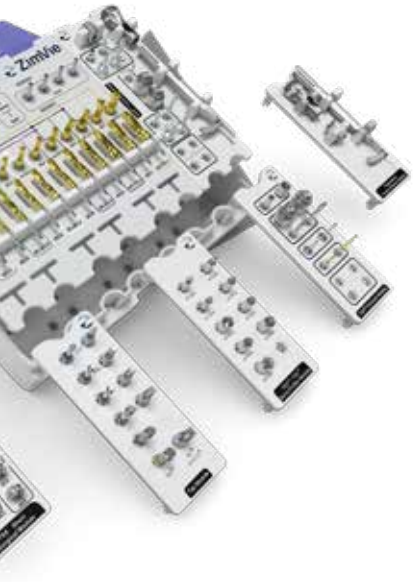

14
**TSV38SG**
3,8 mm (D)
Bohrer,
16 mm (L)

15
**TSV44D38SG**
4,4/3,8 mm (D)
Stufenbohrer,
16 mm (L)

16
**TSV44SG**
4,4 mm (D)
Bohrer,
16 mm (L)

19
**TSV57D51SG**
5,7/5,1 mm (D)
Stufenbohrer,
16 mm (L)

20
**TSV23G**
2,3 mm (D)
Bohrer,
22 mm (L)

21
**TSV28G**
2,8 mm (D)
Bohrer,
22 mm (L)

24
**TSV38D34G**
3,8/3,4 mm (D)
Stufenbohrer,
22 mm (L)

25
**TSV38G**
3,8 mm (D)
Bohrer,
22 mm (L)

26
**TSV44D38G**
4,4/3,8 mm (D)
Stufenbohrer,
22 mm (L)

29
**TSV51G**
5,1 mm (D)
Bohrer,
22 mm (L)

30
**TSV57D51G**
5,7/5,1 mm (D)
Stufenbohrer,
22 mm (L),

## Instrumenten-Modul
(in TSXKIT enthalten)

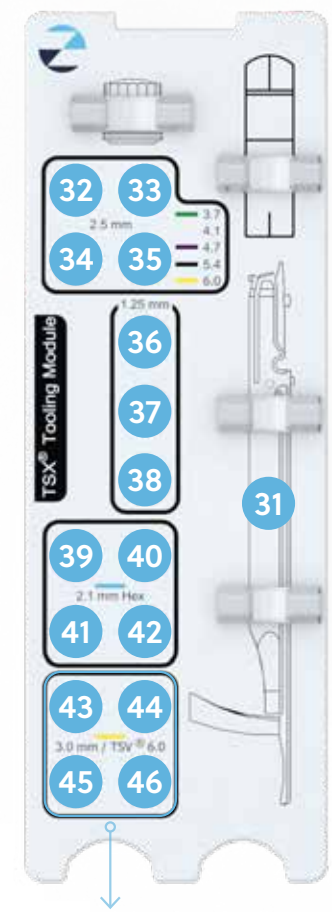


3,0 mm
Sechskantschraubendreher
zur Verwendung mit dem TSV
Implantat mit 6,0 mm (D) bei
abgenommener Einbringhilfe
(separat erhältlich)

31
**ZTIRW**
Drehmomentratsche
für hohen
Drehmomentbereich
(0–90 Ncm)



32
**GHX2.5D**
2,5 mm (D) GemLock®
Sechskant-
Winkelstückeinsatz,
kurz

33
**GHX2.5DL**
2,5 mm (D) GemLock
Sechskant-
Winkelstückeinsatz,
lang

34
**GHX2.5**
2,5 mm (D) GemLock
Sechskantschraubendreher,
kurz

35
**GHX2.5L**
2,5 mm (D) GemLock
Sechskantschraubendreher,
lang

36
**HX1.25D**
1,25 mm
Sechskantschraubendreher
für Winkelstück, kurz

37
**HXLGR1.25**
1,25 mm (D) GemLock,
Sechskantschraubendreher,
lang

38
**HXGR1.25**
1,25 mm (D) GemLock,
Sechskantschraubendreher,
kurz

39
**CHD2.1**
2,1 mm (D) GemLock,
Sechskantschraubendreher für
Winkelstück, kurz

40
**CHDL2.1**
2,1 mm (D) GemLock,
Sechskantschraubendreher
für Winkelstück, lang

41
**CHR2.1**
GemLock, 2,1 mm
Sechskant-
Instrument, kurz

42
**CHRL2.1**
2,1 mm GemLock,
Sechskant-
Instrument, lang

43
**RHX3.0DS**
Sechskantschraubendreher
für Winkelstück,
3,0 mm (D), 21 mm (L)
(separat erhältlich)

44
**RHX3.0DL**
Sechskantschraubendreher
für Winkelstück,
3,0 mm (D), 25 mm (L)
(separat erhältlich)

45
**RHX3.0RS**
Sechskantschraubendreher,
Ratsche,
3,0 mm (D), 17 mm (L)
(separat erhältlich)

46
**RHX3.0RM**
Sechskantschraubendreher,
Ratsche,
3,0 mm (D), 22 mm (L)
(separat erhältlich)

## Gewindeschneidermodul (TAPMOD)

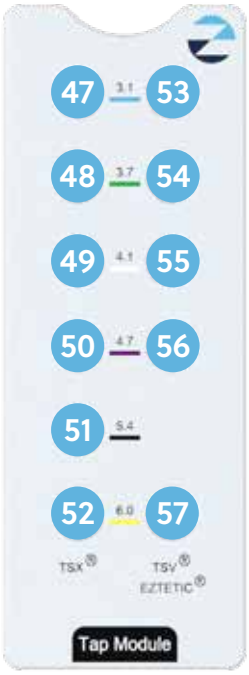

47
**TSXTAP31**
3,1 mm (D)
TSX-Gewindeschneider

48
**TSXTAP37**
3,7 mm (D)
TSX-Gewindeschneider

49
**TSXTAP41**
4,1 mm (D)
TSX-Gewindeschneider

50
**TSXTAP47**
4,7 mm (D)
TSX-Gewindeschneider

51
**TSXTAP54**
5,4 mm (D)
TSX-Gewindeschneider

52
**TSXTAP60**
6,0 mm (D)
TSX-Gewindeschneider

53
**ZOPTT30**
3,0 mm (D)
Eztetic-Gewindeschneider

54
**TT3.7**
3,7 mm (D)
TSV-Gewindeschneider

55
**TT4.1**
4,1 mm (D)
TSV-Gewindeschneider

56
**TT4.7**
4,7 mm (D)
TSV-Gewindeschneider

57
**TT6.0**
6,0 mm (D)
TSV-Gewindeschneider

## Knochenkonturierungsmodul (TSXBPRO)

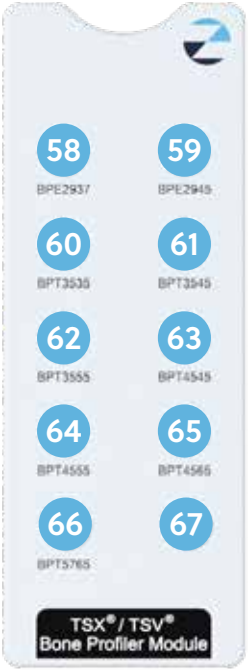

58
**BPE2937**
2,9 mm (D)
x 3,7 mm (P)
NP-Knochenkonturierer

59
**BPE2945**
2,9 mm (D) x
4,5 mm (P)
NP-Knochenkonturierer

60
**BPT3535**
3,5 mm (D) x
3,5 mm (P)
Knochenkonturierer

61
**BPT3545**
3,5 mm (D) x
4,5 mm (P)
Knochenkonturierer

62
**BPT3555**
3,5 mm (D) x
5,5 mm (P)
Knochenkonturierer

63
**BPT4545**
4,5 mm (D) x
4,5 mm (P)
Knochenkonturierer

64
**BPT4555**
4,5 mm (D) x
5,5 mm (P)
Knochenkonturierer

65
**BPT4565**
4,5 mm (D) x
6,5 mm (P)
Knochenkonturierer

66
**BPT5765**
5,7 mm (D) x
6,5 mm (P)
Knochenkonturierer

67
Leerer Gummieinsatz

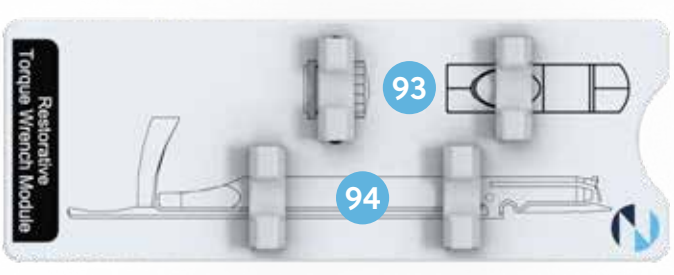

93
**TWR***
Drehmomentratsche für Restaurationen

94
**L-TIRW**
Ratsche mit Drehmomentanzeige für niedrigen Drehmomentbereich (einschließlich C9980 Latch-lock Adapter)

***HINWEIS:** TWR ist im bestückten TSXRESTORTW-Modul enthalten und kann optional in den beiden linken Silikonhaltern mit der Nummer 80 aufbewahrt werden. Die Sterilisationsanweisungen des Herstellers für den TWR befolgen.

## Modul für die Restauration des gesamten Zahnbogens (TSXRESTOR)

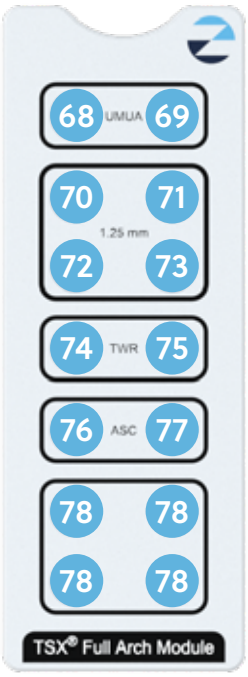

68
**UMUA-D**
Universal Multi-Unit-Schraubendreher

69
**ISO4X4A**
4x4-Schraubendreher für Winkelstück

70
**HXGR1.25**
1,25 mm (D) GemLock Sechskantschrau-bendreher, kurz

71
**HXLGR1.25**
1,25 mm (D) GemLock Sechskantschrau-bendreher, lang

72
**HX1.25D**
1,25 mm Sechskantschrau-bendreher für Winkelstück, kurz

73
**HXL1.25D**
1,25 mm Sechskantschrau-bendreher für Winkelstück, lang

74
**TW1.25**
1,25 mm Sechskanteinsatz für Drehmomen-tratsche, kurz

75
**TW1.25L**
1,25 mm Sechskanteinsatz für Drehmomen-tratsche, lang

76
**ASC-SD24**
24 mm (L) Schraubendreher für abgewinkelte Schraubenkanäle

77
**ASC-SD30**
30 mm (L) Schraubendreher für abgewinkelte Schraubenkanäle

78
Leerer Gummieinsatz

## Chirurgie-Modul für TSX Short (TSXSMOD)

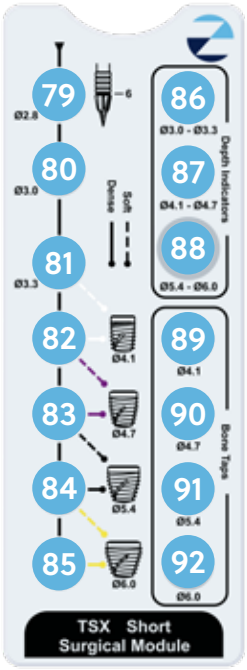

79
**IMDR28L**
Ankörnbohrer 2,8 mm (D), lang

80
**TSX3D6**
Konisch zulaufender Bohrer 3,0 mm (D), 6 mm (L)

81
**TSX33D6**
Formbohrer 3,3 mm (D), 6 mm (L)

82
**TSX41D6**
Formbohrer 4,1 mm (D), 6 mm (L)

83
**TSX47D6**
Formbohrer 4,7 mm (D), 6 mm (L)

84
**IMDR56**
Formbohrer 5,4 mm (D), 6 mm (L)

85
**IMDR66**
Formbohrer 6 mm (D), 6 mm (L)

86
**TSXDI3D33D**
Doppelseitiger Tiefenindikator, 3,0 mm (D), 3,3 mm (D)

87
**TSXDI41D47D**
Doppelseitiger Tiefenindikator, 4,1 mm (D), 4,7 mm (D)

88
**TSXDI54D6D**
Doppelseitiger Tiefenindikator, 5,4 mm (D), 6,0 mm (D)

89
**TSXTAP41D6**
Gewindeschneider, 4,1 mm (D), 6 mm (L)

90
**TSXTAP47D6**
Gewindeschneider, 4,7 mm (D), 6 mm (L)

91
**TSXTAP54D6**
Gewindeschneider, 5,4 mm (D), 6 mm (L)

92
**TSXTAP60D6**
Gewindeschneider, 6,0 mm (D), 6 mm (L)

95
**UNPMODTRAY**
Modul-Tray, leer, sicherer Halt für Latch-Lock-Instrumente
(separat erhältlich)

# Modulares TSX Chirurgie-Kit-System für TSX Implantate

## Bestellinformationen

| Beschreibung | Artikelnr. | TSXSTRKIT \| TSX Starter-Chirurgie-Kit | TSXKIT \| TSX Chirurgie-Kit |
|---|---|---|---|
| TSX Chirurgie-Tray für Bohr- und Instrumenten-Modul, mit Deckel und Basis (leer) | TSXTRAY | • | • |
| Rosenbohrer, 2,0 mm (D) | 1203G | | • |
| Konischer Pilotbohrer, 2,1/1,6 mm (D), 8,0 mm – 11,5 mm (L) | 0201G | • | • |
| Bohrerverlängerung | DEG | • | • |
| Abziehinstrument für NP-Abutments | CLRT2 | | • |
| Abziehinstrument für Innensechskant-Abutments | TLRT2 | • | • |
| Parallelisierungspfosten (Menge: 4) | PPAR | • | • |
| Stufenbohrer, 22 mm (L), 2,8/2,4 mm (D) | EZT28D24G | | • |
| Bohrer, 2,4 mm (D), 22 mm (L) | EZT24G | | • |
| Bohrer, 2,3 mm (D), 16 mm (L) | TSV23SG | • | • |
| Bohrer, 2,8 mm (D), 16 mm (L) | TSV28SG | • | • |
| Stufenbohrer, 16 mm (L), 3,4/2,8 mm (D) | TSV34D28SG | • | • |
| Bohrer, 3,4 mm (D), 16 mm (L) | TSV34SG | • | • |
| Stufenbohrer, 16 mm (L), 3,8/3,4 mm (D) | TSV38D34SG | • | • |
| Bohrer, 3,8 mm (D), 16 mm (L) | TSV38SG | • | • |
| Stufenbohrer, 16 mm (L), 4,4/3,8 mm (D) | TSV44D38SG | • | • |
| Bohrer, 4,4 mm (D), 16 mm (L) | TSV44SG | | • |
| Stufenbohrer, 16 mm (L), 5,1/4,4 mm (D) | TSV51D44SG | | • |
| Bohrer, 5,5 mm (D), 16 mm (L) | TSV51SG | | • |
| Stufenbohrer, 16 mm (L), 5,7/5,1 mm (D) | TSV57D51SG | | • |
| Bohrer, 2,3 mm (D), 22 mm (L) | TSV23G | • | • |
| Bohrer, 2,8 mm (D), 22 mm (L) | TSV28G | • | • |
| Stufenbohrer, 22 mm (L), 3,4/2,8 mm (D) | TSV34D28G | • | • |
| Bohrer, 3,4 mm (D), 22 mm (L) | TSV34G | • | • |
| Stufenbohrer, 22 mm (L), 3,8/3,4 mm (D) | TSV38D34G | • | • |
| Bohrer, 3,8 mm (D), 22 mm (L) | TSV38G | • | • |
| Stufenbohrer, 4,4/3,8 mm (D), 22 mm (L) | TSV44D38G | • | • |
| Bohrer, 4,4 mm (D), 22 mm (L) | TSV44G | | • |
| Stufenbohrer, 22 mm (L), 5,1/4,4 mm (D) | TSV51D44G | | • |
| Bohrer, 5,1 mm (D), 22 mm (L) | TSV51G | | • |
| Stufenbohrer, 22 mm (L), 5,7/5,1 mm (D) | TSV57D51G | | • |
| Drehmomentratsche für hohen Drehmomentbereich (0–90 Ncm) | ZTIRW | • | • |
| GemLock Sechskant-Winkelstückeinsatz, 2,5 mm (D), kurz | GHX2.5D | • | • |
| GemLock Sechskant-Winkelstückeinsatz, 2,5 mm (D), lang | GHX2.5DL | • | • |
| GemLock Sechskantschraubendreher, manuell, 2,5 mm (D), kurz | GHX2.5 | • | • |
| GemLock Sechskantschraubendreher, manuell, 2,5 mm (D), lang | GHX2.5L | • | • |
| Sechskantschraubendreher für Winkelstück, 1,25 mm (D), kurz | HX1.25D | • | • |
| GemLock Sechskantschraubendreher, 1,25 mm (D), lang | HXLGR1.25 | • | • |
| GemLock Sechskantschraubendreher, 1,25 mm (D), kurz | HXGR1.25 | • | • |
| GemLock Sechskantschraubendreher für Winkelstück, 2,1 mm (D), kurz | CHD2.1 | | • |
| GemLock Sechskantschraubendreher für Winkelstück, 2,1 mm (D), lang | CHDL2.1 | | • |
| GemLock Sechskant-Instrument, 2,1 mm (D), kurz | CHR2.1 | | • |
| GemLock Sechskant-Instrument, 2,1 mm (D), lang | CHRL2.1 | | • |

*Sechskantschraubendreher mit 3,0 mm (D) werden nicht mit dem TSX Implantat verwendet.
Ein Punkt zeigt an, dass das Element im angegebenen modularen Paket enthalten ist.

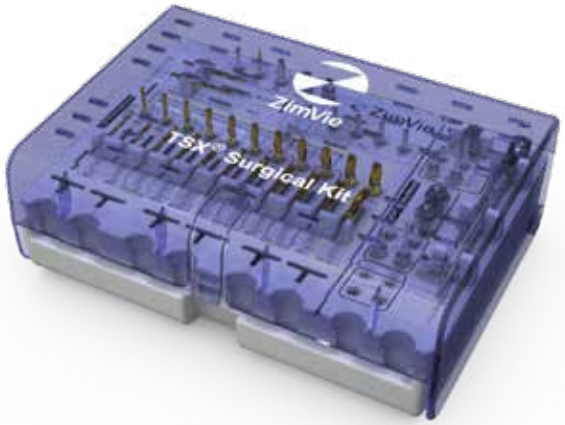

# TSX Kit, modulare Konfigurationen

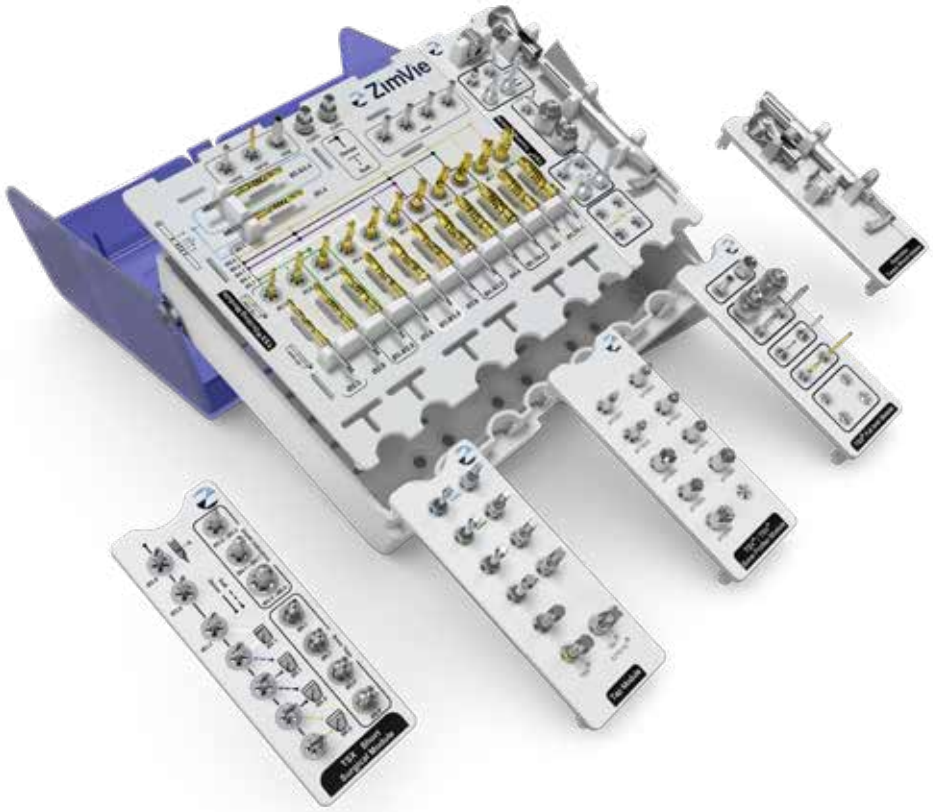

## Gewindeschneidermodul

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **TAPMOD** \| TSX Gewindeschneider-Modul |
| | | | **TSXTAPMOD** \| TSX Gewindeschneidermodul für TSX Implantate | |
| | | **TSVTAPMOD** \| TSX Gewindeschneidermodul für TSV und Eztetic Implantate | | |
| **Beschreibung** | **Artikelnr.** | | | |
| TSX Gewindeschneider-Modul-Tray (leer) | **TAPTRAY** | • | • | • |
| TSX Gewindeschneider, 3,1 mm (D) | **TSXTAP31** | | • | • |
| TSX Gewindeschneider, 3,7 mm (D) | **TSXTAP37** | | • | • |
| TSX Gewindeschneider, 4,1 mm (D) | **TSXTAP41** | | • | • |
| TSX Gewindeschneider, 4,7 mm (D) | **TSXTAP47** | | • | • |
| TSX Gewindeschneider, 5,4 mm (D) | **TSXTAP54** | | • | • |
| TSX Gewindeschneider, 6,0 mm (D) | **TSXTAP60** | | • | • |
| Eztetic Gewindeschneider, 3,0 mm (D) | **ZOPTT30** | • | | • |
| TSV Gewindeschneider, 3,7 mm (D) | **TT3.7** | • | | • |
| TSV Gewindeschneider, 4,1 mm (D) | **TT4.1** | • | | • |
| TSV Gewindeschneider, 4,7 mm (D) | **TT4.7** | • | | • |
| TSV Gewindeschneider, 6,0 mm (D) | **TT6.0** | • | | • |

## Chirurgie-Modul für TSX Short

| Artikelnummer | Modul/Werkzeuge | Beschreibung |
|---|---|---|
| **TSXSMOD** | **Chirurgie-Modul für TSX Short** | Enthält Chirurgie-Tray für TSX Short (leer), Bohrer, Gewindeschneider und doppelseitige Tiefenindikatoren |
| IMDR28L | **Ankörnbohrer** | Ankörnbohrer für Immediate Molar Implantate, 2,8 mm (D), lang (30 mm) |
| TSX3D6 | **Zwischenbohrer** | TSX® Bohrer, 3,0 mm (D), 6 mm (L) |
| TSX33D6 | **Formbohrer** | TSX® Bohrer, 3,3 mm (D), 6 mm (L) |
| TSX41D6 | **Formbohrer** | TSX® Bohrer, 4,1 mm (D), 6 mm (L) |
| TSX47D6 | **Formbohrer** | TSX® Bohrer, 4,7 mm (D), 6 mm (L) |
| IMDR56 | **Formbohrer** | Formbohrer, 5,4 mm (D), 6 mm (L) |
| IMDR66 | **Formbohrer** | Formbohrer, 6 mm (D), 6 mm (L) |
| TSXDI3D33D | **Doppelseitiger Tiefenindikator** | Doppelseitiger TSX® Tiefenindikator, 3,0 mm (D), 3,3 mm (D) |
| TSXDI41D47D | **Doppelseitiger Tiefenindikator** | Doppelseitiger TSX® Tiefenindikator, 4,1 mm (D), 4,7 mm (D) |
| TSXDI54D6D | **Doppelseitiger Tiefenindikator** | Doppelseitiger TSX® Tiefenindikator, 5,4 mm (D), 6,0 mm (D) |
| TSXTAP41D6 | **Gewindeschneider** | TSX® Gewindeschneider, 4,1 mm (D), 6 mm (L) |
| TSXTAP47D6 | **Gewindeschneider** | TSX® Gewindeschneider, 4,7 mm (D), 6 mm (L) |
| TSXTAP54D6 | **Gewindeschneider** | TSX® Gewindeschneider, 5,4 mm (D), 6 mm (L) |
| TSXTAP60D6 | **Gewindeschneider** | TSX® Gewindeschneider, 6,0 mm (D), 6 mm (L) |

## TSX Knochenkonturierungs-Modul

| Artikelnummer | Modul/Werkzeuge | Beschreibung |
|---|---|---|
| **TSXBPRO** | **TSX Knochenkonturierungs-Modul** *für TSX, TSV und Eztetic Implantate* | Umfasst Knochenkonturierungs-Tray [TSXBPROTRAY] und Knochenkonturierer für TSX, TSV und Eztetic Implantate |
| TSXBPROTRAY | **TSX Knochenkonturierungs-Modul** | Tray (leer) |
| BPE2937 | **NP-Knochenkonturierer** | 2,9 mm (D) x 3,7 mm (P) |
| BPE2945 | **NP-Knochenkonturierer** | 2,9 mm (D) x 4,5 mm (P) |
| BPT3535 | **Knochenkonturierer** | 3,5 mm (D) x 3,5 mm (P) |
| BPT3545 | **Knochenkonturierer** | 3,5 mm (D) x 4,5 mm (P) |
| BPT3555 | **Knochenkonturierer** | 3,5 mm (D) x 5,5 mm (P) |
| BPT4545 | **Knochenkonturierer** | 4,5 mm (D) x 4,5 mm (P) |
| BPT4555 | **Knochenkonturierer** | 4,5 mm (D) x 5,5 mm (P) |
| BPT4565 | **Knochenkonturierer** | 4,5 mm (D) x 6,5 mm (P) |
| BPT5765 | **Knochenkonturierer** | 5,7 mm (D) x 6,5 mm (P) |

## TSX Modul für den gesamten Zahnbogen

| Artikelnummer | Modul/Werkzeuge | Beschreibung |
|---|---|---|
| TSXRESTOR | **TSX Modul für den gesamten Zahnbogen** *mit Instrumenten* | Umfasst Tray für den gesamten Zahnbogen [TSXRESORTRAY] und Instrumente für die Chairside-Platzierung von Universal Multi-Unit-Abutments und Ti-Basen auf TSX, TSV und Eztetic Implantaten |
| TSXRESTORTRAY | **TSX Modul für den gesamten Zahnbogen** | Tray (leer) |
| UMUA-D | **Universal Multi-Unit-Schraubendreher** | Zur Verwendung mit der TWR Drehmomentratsche zum Festziehen gerader UMUA Abutments |
| ISO4X4A | **Adapter für ISO-konforme Winkelstück-Schraubendreher** | Zur Verwendung mit der L-TIRW Drehmomentratsche zum Festziehen von UMUA Abutments |
| HXGR1.25 | **GemLock Sechskantschraubendreher** | kurz, 1,25 mm (D) |
| HXLGR1.25 | **GemLock Sechskantschraubendreher** | lang, 1,25 mm (D) |
| HX1.25D | **Sechskantschraubendreher für Winkelstück** | kurz, 1,25 mm (D) |
| HXL1.25D | **Sechskantschraubendreher für Winkelstück** | lang, 1,25 mm (D) |
| TW1.25 | **Sechskanteinsatz für Drehmomentratsche** | kurz, 1,25 mm (D), zur Verwendung mit TWR Drehmomentratsche |
| TW1.25L | **Sechskanteinsatz für Drehmomentratsche** | lang, 1,25 mm (D), zur Verwendung mit der TWR Drehmomentratsche |
| ASC-SD24 | **Schraubendreher für abgewinkelte Schraubenkanäle** | 24 mm (L), zum Festziehen von Ti-Basen mit abgewinkeltem Schraubenkanal |
| ASC-SD30 | **Schraubendreher für abgewinkelte Schraubenkanäle** | 30 mm (L), zum Festziehen von Ti-Basen mit abgewinkeltem Schraubenkanal |

## TSX Prothetik-Drehmomentratschen-Modul

| Artikelnummer | Modul/Werkzeuge | Beschreibung |
|---|---|---|
| TSXRESTORTW | **TSX Prothetik-Drehmomentratschen-Modul** *mit Instrumenten* | Umfasst Prothetik-Drehmomentratschen-Tray [TSXRESOTRTWTRAY]; L-TIRW und TWR Prothetik-Drehmomentratsche |
| TSXRESTORTWTRAY | **TSX Prothetik-Drehmomentratschen-Modul** | Tray (leer) |
| L-TIRW | **Ratsche mit Drehmomentanzeige** | Umfasst C9980 Latchlock-Adapter zur Verwendung mit Schraubendrehern mit Latch-Lock-Verbindung |
| TWR | **Drehmomentratsche** | Zur Verwendung mit TW1.25 und TW1.25L Schraubendrehern |

# Persönliche modulare Präferenzen Bestellinformationen

## TSX Chirurgie-Kit und Module

| Artikelnummer | Chirurgie-Kit | Beschreibung |
|---|---|---|
| TSXKIT | **TSX Chirurgie-Kit** *für TSX, TSV und Eztetic Implantate* | Umfasst Chirurgie-Tray [TSXTRAY], Bohrmodul und Instrumenten-Modul, mit Instrumenten zur Platzierung von TSX Implantaten mit 3,1 mm (D), 3,7 mm (D), 4,1 mm (D), 4,7 mm (D), 5,4 mm (D) und 6,0 mm (D), von TSV Implantaten mit 3,7 mm (D), 4,1 mm (D), 4,7 mm (D) und 6,0 mm (D) sowie von Eztetic Implantaten mit 3,1 mm (D) |
| TSXSTRKIT | **TSX Starter-Chirurgie-Kit** *für TSX und TSV Implantate* | Umfasst Chirurgie-Tray [TSXTRAY], Bohrmodul und Instrumenten-Modul mit Instrumenten für TSX und TSV Implantate mit 3,7 mm (D), 4,1 mm (D) und 4,7 mm (D) |
| TAPMOD | **TSX Gewindeschneidermodul** *für TSV und Eztetic Implantate* | Umfasst Gewindeschneider-Tray [TAPTRAY] sowie TSX, TSV und Eztetic Gewindeschneider |
| TSXSMOD | **Chirurgie-Modul für TSX Short** | Enthält Chirurgie-Tray für TSX Short (LEER), TSX Short Bohrer, TSX Short Gewindeschneider und doppelseitige TSX Short Tiefenindikatoren |
| TSXTAPMOD | **TSX Gewindeschneidermodul** *für TSX Implantate* | Umfasst Gewindeschneider-Tray [TAPTRAY] sowie TSX Gewindeschneider |
| TSVTAPMOD | **TSX Gewindeschneidermodul** *für TSV und Eztetic Implantate* | Umfasst Gewindeschneider-Tray [TAPTRAY]; TSV und Eztetic Gewindeschneider |
| TSXBPRO | **TSX Knochenkonturierungs-Modul** *für TSX, TSV und Eztetic Implantate* | Umfasst Knochenkonturierungs-Tray [TSXBPROTRAY] und Knochenkonturierer für TSX, TSV und Eztetic Implantate |
| TSXRESTOR | **TSX Modul für den gesamten Zahnbogen** | Umfasst Tray für den gesamten Zahnbogen [TSXRESORTRAY] und Instrumente für die Chairside-Platzierung von Universal Multi-Unit-Abutments und Ti-Basen auf TSX, TSV und Eztetic Implantaten |
| TSXRESTORTW | **TSX Prothetik-Drehmomentratschen-Modul** | Umfasst Prothetik-Drehmomentratschen-Tray [TSXRESOTRTWTRAY]; L-TIRW und TWR Prothetik-Drehmomentratsche |
| TSXTRAY | **TSX Chirurgie-Tray** | Bohrer- und Instrumenten-Modul-Trays mit Deckel und Unterteil (leer) |
| TAPTRAY | **TSX Gewindeschneider-Modul** | Gewindeschneider-Modul-Tray (leer) |
| TSXBPROTRAY | **TSX Knochenkonturierungs-Modul** | Knochenkonturierungs-Tray (leer) |
| TSXRESTORTRAY | **TSX Modul für den gesamten Zahnbogen** | Gesamter Zahnbogen (leer) |
| TSXRESTORTWTRAY | **TSX Prothetik-Drehmomentratschen-Modul** | Prothetik-Drehmomentratsche (leer) |
| UNPMODTRAY | **Modulares Tray** | Tray (leer), sicherer Halt für ISO-konforme Winkelstück-Instrumente |

# Chirurgische Bohrer und Bohrerstopps der Dríva Gold Serie

## Chirurgische Pilotbohrer

| Durchmesser | 15 mm (L)* | 16 mm (L)* | 19 mm (L) | 22 mm (L)* | 25 mm (L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,1/1,6 mm (D) | 0201G | — | — | — | — |

## Chirurgische Dríva Bohrer

| Durchmesser | 16 mm (L)* | 19 mm (L) | 22 mm (L)* | 25 mm (L) |
|---|---|---|---|---|
| 2,3 mm (D) | TSV23SG | STR23D19 | TSV23G | STR23D25 |
| 2,4 mm (D) | — | — | EZT24G | — |
| 2,8 mm (D) | TSV28SG | STR28D19 | TSV28G | STR28D25 |
| 3,4 mm (D) | TSV34SG | STR34D19 | TSV34G | STR34D25 |
| 3,8 mm (D) | TSV38SG | STR38D19 | TSV38G | STR38D25 |
| 4,4 mm (D) | TSV44SG | — | TSV44G | — |
| 5,1 mm (D) | TSV51SG | — | TSV51G | — |

## Chirurgische Dríva Stufenbohrer

| Durchmesser | 16 mm (L)* | 19 mm (L) | 22 mm (L)* | 25 mm (L) | Farbcodierung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,8/2,4 mm (D) | — | — | EZT28D24G | — | Blau |
| 3,4/2,8 mm (D) | TSV34D28SG | STP34D19 | TSV34D28G | STP34D25 | Grün |
| 3,8/3,4 mm (D) | TSV38D34SG | STP38D19 | TSV38D34G | STP38D25 | Weiß |
| 4,4/3,8 mm (D) | TSV44D38SG | STP44D19 | TSV44D38G | STP44D25 | Violett |
| 5,1/4,4 mm (D) | TSV51D44SG** | — | TSV51D44G** | — | Schwarz |
| 5,7/5,1 mm (D) | TSV57D51SG | — | TSV57D51G | — | Gelb |

*Die Bohrer mit 15 mm (L), 16 mm (L) und 22 mm (L) weisen axiale Streifen auf, um die Verwendung mit dem Bohrerstopp-Kit zu erleichtern.
** TSV51D44SG und TSV51D44G sind die Finalbohrer für das TSX Implantat mit 5,4 mm (D) in dichtem Knochen, sind optionale Zwischenbohrer in der Bohrsequenz mit 6,0 mm (D) und werden separat und nicht in Chirurgie-Kits verkauft.

Die Tiefenmarkierungen sind maschinell bearbeitet und lasergeätzt, um die Sichtbarkeit zu verbessern. Die Bänder befinden sich etwa 1,25 mm weiter apikal als die Implantat-Abutment-Verbindung. (Beispiel: Das 13-mm-Band ist 14,25 mm von der Bohrerspitze entfernt positioniert.)

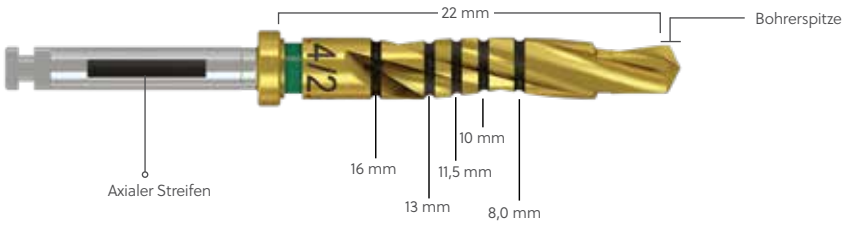

## Instrumente für TSX Short Implantate

| Beschreibung | Artikelnr. | |
|---|---|---|
| Ankörnbohrer für Immediate Molar Implantate, 2,8 mm (D), lang (30 mm) | IMDR28L | |
| TSX Bohrer, 3,0 mm (D), 6 mm (L) | TSX3D6 | |
| TSX Bohrer, 3,3 mm (D), 6 mm (L) | TSX33D6 | |
| TSX Bohrer, 4,1 mm (D), 6 mm (L) | TSX41D6 | |
| TSX Bohrer, 4,7 mm (D), 6 mm (L) | TSX47D6 | |
| Formbohrer, 5,4 mm (D), 6 mm (L) | IMDR56 | |
| Formbohrer, 6 mm (D), 6 mm (L) | IMDR66 | |
| Doppelseitiger TSX Tiefenindikator, 3,0 mm (D), 3,3 mm (D) | TSXDI3D33D | |
| Doppelseitiger TSX Tiefenindikator, 4,1 mm (D), 4,7 mm (D) | TSXDI41D47D | |
| Doppelseitiger TSX Tiefenindikator, 5,4 mm (D), 6,0 mm (D) | TSXDI54D6D | |
| TSX Gewindeschneider, 4,1 mm (D), 6 mm (L) | TSXTAP41D6 | |
| TSX Gewindeschneider, 4,7 mm (D), 6 mm (L) | TSXTAP47D6 | |
| TSX Gewindeschneider, 5,4 mm (D), 6 mm (L) | TSXTAP54D6 | |
| TSX Gewindeschneider, 6,0 mm (D), 6 mm (L) | TSXTAP60D6 | |

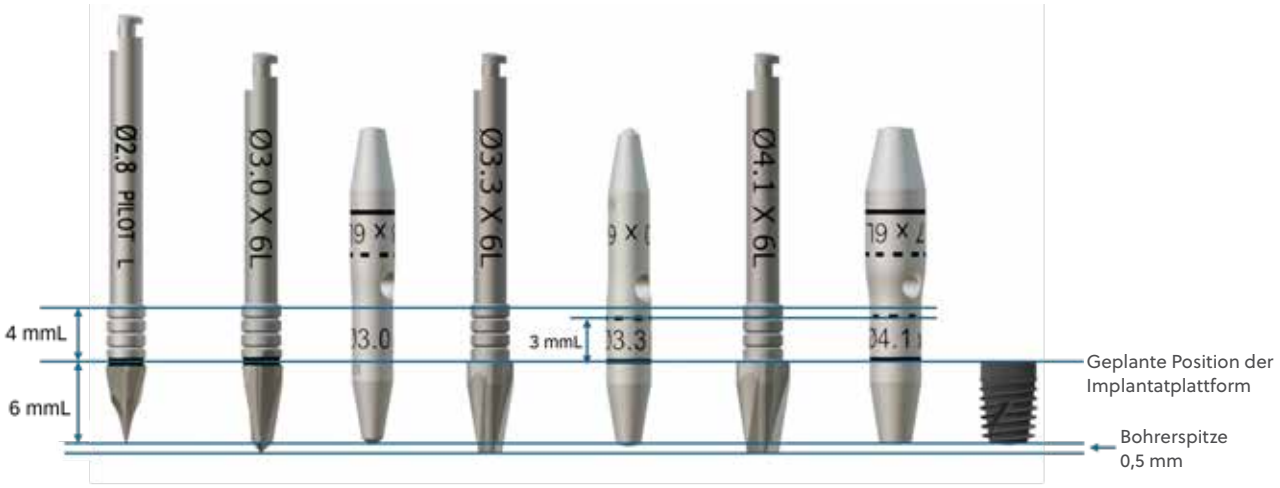


Tiefenmarkierungen auf Instrumenten, die zur Vorbereitung der Implantatstelle für das TSX Short Implantat mit 4,1 mm (D) x 6 mm (L) erforderlich sind

## Ein-Patienten-Bohrer

| Beschreibung | Inhalt | Artikelnr. |
|---|---|---|
| Bohrer-Kit, ein Patient, lang, Implantat 3,7 mm (D), 17 mm (L) | Rosenbohrer<br>Pilotbohrer, 2,3 mm (D)<br>Stufenbohrer, 3,4/2,8 mm (D) | DSTK3 |
| Bohrer-Kit, ein Patient, kurz, Implantat 3,7 mm (D), 11 mm (L) | Rosenbohrer<br>Pilotbohrer, 2,3 mm (D)<br>Stufenbohrer, 3,4/2,8 mm (D) | DSTK3S |
| Bohrer, ein Patient, lang, Implantat 4,7 mm (D), 17 mm (L) | Stufenbohrer, 4,4/3,8 mm (D) | DST4 |
| Bohrer, ein Patient, kurz, Implantat 4,7 mm (D), 11 mm (L) | Stufenbohrer, 4,4/3,8 mm (D) | DST4S |
| Bohrer, ein Patient, lang, Implantat 6,0 mm (D), 17 mm (L) | Stufenbohrer, 5,7/5,1 mm (D) | DST6 |
| Bohrer, ein Patient, kurz, Implantat 6,0 mm (D), 11 mm (L) | Stufenbohrer, 5,7/5,1 mm (D) | DST6S |

Hinweis: Keine interne Spülung. Sets mit langen Bohrern haben Tiefenmarkierungen für Implantate mit 8, 10, 11,5, 13 und 16 mm (L). Sets mit kurzen Bohrern haben Tiefenmarkierungen für Implantate mit 8 und 10 mm (L).

## Instrumente für die Implantatinsertion

| Beschreibung | Artikelnr. |
|---|---|
| Drehmomentratsche für hohen Drehmomentbereich | ZTIRW |
| GemLock Vierkant-Ratsche mit Haltefunktion | RSR |
| Schraubendrehergriff aus Edelstahl | SSHS |



## Sechskantschraubendreher, 1,25 mm (D)

| Beschreibung | Verwendungsart | Artikelnr. |
|---|---|---|
| Sechskantschlüssel mit GemLock Haltefunktion, kurz, 1,25 mm (D), 22 mm (L) | Manuell | HXGR1.25 |
| Sechskantschlüssel mit GemLock Haltefunktion, lang, 1,25 mm (D), 30 mm (L) | Manuell | HXLGR1.25 |
| Sechskant-Winkelstückeinsatz für chirurgische und prothetische Schrauben, kurz, 1,25 mm (D), 23 mm (L)<br>Erfordert möglicherweise ein Reduzierhandstück | Handstück, L-TIRW | HX1.25D |
| Sechskant-Winkelstückeinsatz für chirurgische und prothetische Schrauben, lang, 1,25 mm (D), 26 mm (L)<br>Erfordert möglicherweise ein Reduzierhandstück | Handstück, L-TIRW | HXL1.25D |
| Sechskantschraubendreher, kurz, Standard, 1,25 mm (D), 17 mm (L) | RSR | HX1.25 |
| Sechskantschraubendreher, lang, Standard, 1,25 mm (D), 22 mm (L) | RSR | HXL1.25 |

## Sechskantschraubendreher, 2,1 mm (D), für die Insertion von TSX Implantaten mit 3,1 mm (D)

| Beschreibung | Verwendungsart | Artikelnr. |
|---|---|---|
| GemLock Sechskant-Einbringinstrument, Ratsche, 2,1 mm (D) kurz | ZTIRW, RSR, SSHS | CHR2.1 |
| GemLock Sechskant-Einbringinstrument, Ratsche, 2,1 mm (D), lang | ZTIRW, RSR, SSHS | CHRL2.1 |
| GemLock Sechskant-Winkelstückeinsatz, 2,1 mm (D), kurz | Handstück | CHD2.1 |
| GemLock Sechskant-Winkelstückeinsatz, 2,1 mm (D), lang | Handstück | CHDL2.1 |

## Sechskantschraubendreher, 2,5 mm (D), für die Insertion von TSX Implantaten mit 3,7 bis 6,0 mm (D)

| Beschreibung | Verwendungsart | Artikelnr. |
|---|---|---|
| Sechskantschraubendreher mit GemLock Haltefunktion, kurz, 2,5 mm (D), 17 mm (L) | ZTIRW, RSR, SSHS | GHX2.5 |
| Sechskantschraubendreher mit GemLock Haltefunktion, lang, 2,5 mm (D), 28 mm (L) | ZTIRW, RSR, SSHS | GHX2.5L |
| Sechskant-Winkelstückeinsatz mit GemLock Haltefunktion, kurz, 2,5 mm (D), 21 mm (L) | Handstück | GHX2.5D |
| Sechskant-Winkelstückeinsatz mit GemLock Haltefunktion, lang, 2,5 mm (D), 30 mm (L) | Handstück | GHX2.5DL |

## Chirurgische Instrumente

| Beschreibung | Artikelnr. |
|---|---|
| Bohrerverlängerung | DEG |
| Parallelisierungspfosten | PPAR |
| Rosenbohrer | 1203G |
| Entfernungsinstrument für Schrauben-Implantate, Hartmetallstahl<br>Hinweis: Nicht autoklavieren | IRT |

# Instrumente für die geführte Chirurgie

TSX Implantate können unter Verwendung des RealGUIDE® Z3D™ Kits für geführte Chirurgie und der Instrumente, die auf Seite 36 gezeigt werden, vollständig geführt inseriert werden.

## RealGUIDE Z3D Kit für vollständig geführte Chirurgie*

| Produkt | Artikelnr. |
|---|---|
| **RealGUIDE Z3D Kit als Chirurgie-Kit**<br>(komplett bestückt) | 3DM0070ZUS |
| **RealGUIDE Z3D Box mit autoklavierbarem Kit** | 3DM00616ZUS |

* Nicht in allen Märkten zugelassen.

## Konfiguration

| Produkt | Artikelnr. |
|---|---|
| **Bohrer für Fixationsstift**<br>max. 1.000 U/min, Edelstahl, gehärtet, Güte AISI 420B, mit DLC-Beschichtung | 3DM00610ZUS |
| **Fixationsstift**<br>TiAl6V4 ASTM F136 | 3DM00609ZUS |
| **Verlängerung für Drehmomentratsche**<br>max. 50 Ncm, Edelstahl, gehärtet, Güte AISI 420F MOD | 3DM00623ZUS |
| **4 x 4 Vierkant-Konnektor für Winkelstück**<br>max. 50 Ncm, Edelstahl, gehärtet, Güte AISI 420F MOD | 3DM00612ZUS |
| **Mundöffnungslehre/Bisslehre**<br>Edelstahl, gehärtet, Güte AISI 303 | 3DM00622ZUS |
| **Mukotom/Gewebestanze**<br>Innendurchmesser: 4,2 mm, max. 100 U/min, Edelstahl, gehärtet, Güte AISI 420F MOD mit DLC-Beschichtung | 3DM00607ZUS |
| **Knochenkamm-Nivellierer**<br>max. 600 U/min, Edelstahl, gehärtet, Güte AISI 420B, mit DLC-Beschichtung | 3DM00614ZUS |
| **Pilotbohrer**<br>Bohrer zur Vorbereitung der Implantatstelle, max. 600 U/min, Edelstahl, gehärtet, Güte AISI 420B, mit DLC-Beschichtung | 3DM00621ZUS |
| **Bohrer, 2,4 x 6 mm (D)**<br>max. 800 U/min, Edelstahl, gehärtet, Güte AISI 420B, mit DLC-Beschichtung | 3DM00619ZUS |

## Komponenten des vollständig geführten RealGUIDE Z3D Sets

### RealGUIDE Z3D Implantat-Einbringpfosten (Edelstahl, gehärtet, Güte AISI 420F MOD)

| Produkt | Artikelnr. |
|---|---|
| **ZimVie TSX/Eztetic 3,1 mm (D)**<br>inkl. Schraube, max. 20 U/min, 50 Ncm | 3DM00606ZIM31US |
| **ZimVie TSX 3,7/4,1/4,7 mm (D), ZimVie TSV 3,7/4,1 mm (D)**<br>inkl. Schraube, max. 20 U/min, 50 Ncm | 3DM00606ZIM35US |
| **ZimVie TSV 4,7 mm (D)**<br>inkl. Schraube, max. 20 U/min, 50 Ncm | 3DM00606ZIM47US |

### RealGUIDE Z3D Bohrer (Edelstahl, gehärtet, Güte AISI 420B, mit DLC-Beschichtung)

| Länge | Bohrer, 2,4 mm (D) | Bohrer, zweistufig, 2,8/2,4 mm (D) | Bohrer, zweistufig, 3,4/2,8 mm (D) | Bohrer, zweistufig, 3,8/3,4 mm (D) | Bohrer, zweistufig, 4,4/3,8 mm (D) |
|---|---|---|---|---|---|
| | max. 800 U/min | | | | |
| | | | | | |
| 8 mm | 3DM00613.24.080ZUS | 3DM00613.28.080ZUS | 3DM00613.34.080ZUS | 3DM00613.38.080ZUS | 3DM00613.44.080ZUS |
| 10 mm | 3DM00613.24.100ZUS | 3DM00613.28.100ZUS | 3DM00613.34.100ZUS | 3DM00613.38.100ZUS | 3DM00613.44.100ZUS |
| 11,5 mm | 3DM00613.24.115ZUS | 3DM00613.28.115ZUS | 3DM00613.34.115ZUS | 3DM00613.38.115ZUS | 3DM00613.44.115ZUS |
| 13 mm | 3DM00613.24.130ZUS | 3DM00613.28.130ZUS | 3DM00613.34.130ZUS | 3DM00613.38.130ZUS | 3DM00613.44.130ZUS |
| 16 mm | 3DM00613.24.160ZUS | 3DM00613.28.160ZUS | 3DM00613.34.160ZUS | 3DM00613.38.160ZUS | 3DM00613.44.160ZUS |

### RealGUIDE Z3D Zubehör für chirurgische Schablonen

| Produkt | Artikelnr. |
|---|---|
| **Hülse für chirurgische Schablonen**<br>RealGUIDE CAD-Verfahren 5,05 mm, kompatibel mit 3DM RealGUIDE, ZimVie Z3D, Nobel RP Kit (10 Stück) | 3DM00670 |
| **Fixierhülse für chirurgischen Schablonenstift**<br>RealGUIDE CAD-Verfahren (10 Stück) | 3DM00671 |

# Knochenkonturierer

## Knochenkonturierer für Encode Gingivaformer

| Restaurative Plattform | Emergenzprofil | TSV Encode-Gingivaformer | TSV Verbindung |
|---|---|---|---|
| 3,5 mm | 3,8 mm | TEHA3383/TEEHA333 | BPT3545 |
| | | TEHA3385/TEEHA335 | |
| | | TEHA3387/TEEHA337 | |
| | 5,0 mm | TEHA3503/TEEHA353 | BPT3555 |
| | | TEHA3505/TEEHA355 | |
| 4,5 mm | 5,0 mm | TEHA4503 | BPT4555 |
| | | TEHA4505 | |
| | 5,6 mm | TEHA4563/TEEHA453 | BPT4565 |
| | | TEHA4565/TEEHA455 | |
| | | TEHA4567/TEEHA457 | |
| | 6,0 mm | TEHA4603/TEEHA463 | BPT4565 |
| | | TEHA4605/TEEHA465 | |

## Knochenkonturierer für TSX Implantate

| Restaurative Plattform | Emergenz-profil | Eztetic-Verbindung |
|---|---|---|
| 2,9 mm | 3,7 mm | BPE2937 |
| | 4,5 mm | BPE2945 |

## Knochenkonturierer für TSX Implantate

| Restaurative Plattform | Emergenz-profil | TSV/ TM-Verbindung |
|---|---|---|
| 3,5 mm | 3,5 mm | BPT3535 |
| | 4,5 mm | BPT3545 |
| | 5,5 mm | BPT3555 |
| 4,5 mm | 4,5 mm | BPT4545 |
| | 5,5 mm | BPT4555 |
| | 6,5 mm | BPT4565 |

**Hinweis:** Kann für Tapered Abutments verwendet werden.

# Notizen

## Weitere Informationen finden Sie unter ZimVie.com


**ZimVie US Corp LLC**
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410, USA
Telefon: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272
dentalCS@ZimVie.com

**ZimVie Germany GmbH**
Kopernikusstraße 15
DE-85221 Dachau
Tel: +49-(0)800-101-64-20
Fax: +49-(0)800-313-11-11
ZV.bestellung@ZimVie.com

**ZimVie Austria GmbH**
Wienerbergstraße 11/12a
A-1100 Wien
Tel: +43-(0)8000-700-17
Fax: +43-(0)8000-700-18
ZV.bestellung@ZimVie.com

**ZimVie Switzerland GmbH**
Grüzefeldstrasse 41
CH-8404 Winterthur
Tel: +41-(0)800-24-66-38
Fax: +41-(0)800-24-66-39
ZV.bestellung@ZimVie.com


ZimVie
Digital Innovation Meets Implant Excellence


Soweit nicht anders angegeben, sind sämtliche der hier erwähnten Marken und geistigen Eigentumsrechte Eigentum von ZimVie Inc. und seinen verbundenen Unternehmen; alle Produkte werden von einer oder mehreren der Dental-Tochtergesellschaften von ZimVie US Corp LLC (Biomet 3i, LLC usw.) hergestellt und von ZimVie US Corp LLC und seinen autorisierten Handelspartnern vertrieben. OverdenSURE und Universal Multi-Unit Abutments werden von Terrats Medical S.L. hergestellt. RealGUIDE Z3D Implantat-Einbringpfosten/RealGUIDE Bohrer werden von 3DIEMME S.r.l und Biomec S.r.l hergestellt. In bestimmten Rechtsordnungen, einschließlich der Vereinigten Staaten und der Europäischen Union, ist RealGUIDE eine eingetragene Marke von 3Diemme S.r.l. Alle Verweise auf das Symbol ® sind auf die entsprechenden Rechtsordnungen beschränkt, in denen die Marke eingetragen ist. TWR wird von Josef Ganter GmbH hergestellt. EU-MDR-Klassifizierung: Zahnimplantate (IIb), RealGUIDE Software (IIa), restaurative Komponenten (IIb), Dentalinstrumente (IIa; I). Weitere Informationen zur Zweckbestimmung des Produkts bzw. der Produkte finden Sie unter: https://labeling.ZimVie.com. Die in diesem Material dargestellten Produkte sind in Frankreich nicht erstattungsfähig. Für andere Länder beachten Sie bitte die lokalen Gesetze und Vorschriften. Weitere Produktinformationen sind den jeweiligen Produktetiketten oder der Gebrauchsanweisung zu entnehmen. Produktzulassung und -verfügbarkeit können auf bestimmte Länder/Regionen beschränkt sein. Diese Unterlagen sind ausschließlich für Zahnärzte bestimmt und beinhalten keine medizinischen Ratschläge oder Empfehlungen. Die Weitergabe an andere Empfänger ist untersagt. Dieses Material darf ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung von ZimVie nicht vervielfältigt oder nachgedruckt werden. ZVINST0037-EMEA-DE REV 7 09/26 ©2026 ZimVie.
Alle Rechte vorbehalten.


Die für jedes Produkt zutreffende BS-Nummer ist ggf. auf dem Produktetikett angegeben.

CE 2797 CE 0051 CE