Catálogo de productos

TSX®

Sistema de implantes

ZimVie



Índice

Implantología **3**
Implantes TSX® 3

Componentes de cicatrización **4**
Pautas de selección del pilar de cicatrización 4
Pilares de cicatrización Encode® Emergence 4
Pilares de cicatrización Encode 4
Pilares de cicatrización 5

Prótesis **6**
Coping de impresión 6
Restauraciones provisionales 7
Restauraciones digitales 8
Restauraciones cementadas 9
Restauraciones de oro para sobrecolado 12
Restauraciones atornilladas 13
Restauraciones para sobredentadura 16
Herramientas protésicas 18

Sistema de kit quirúrgico modular TSX **20**
Tabla de distribución 20
Sistema de kit quirúrgico modular TSX para implantes TSX 24
Kit TSX, configuración modular 25
Preferencias modulares personales - Información para pedidos 27

Instrumental y kit quirúrgico **28**
Fresas quirúrgicas de la serie Dríva™ Gold 28
Instrumental para cirugía guiada 31
Componentes del kit RealGUIDE® Z3D™ totalmente guiado 32
Perfiladores óseos 34

Implantes TSX

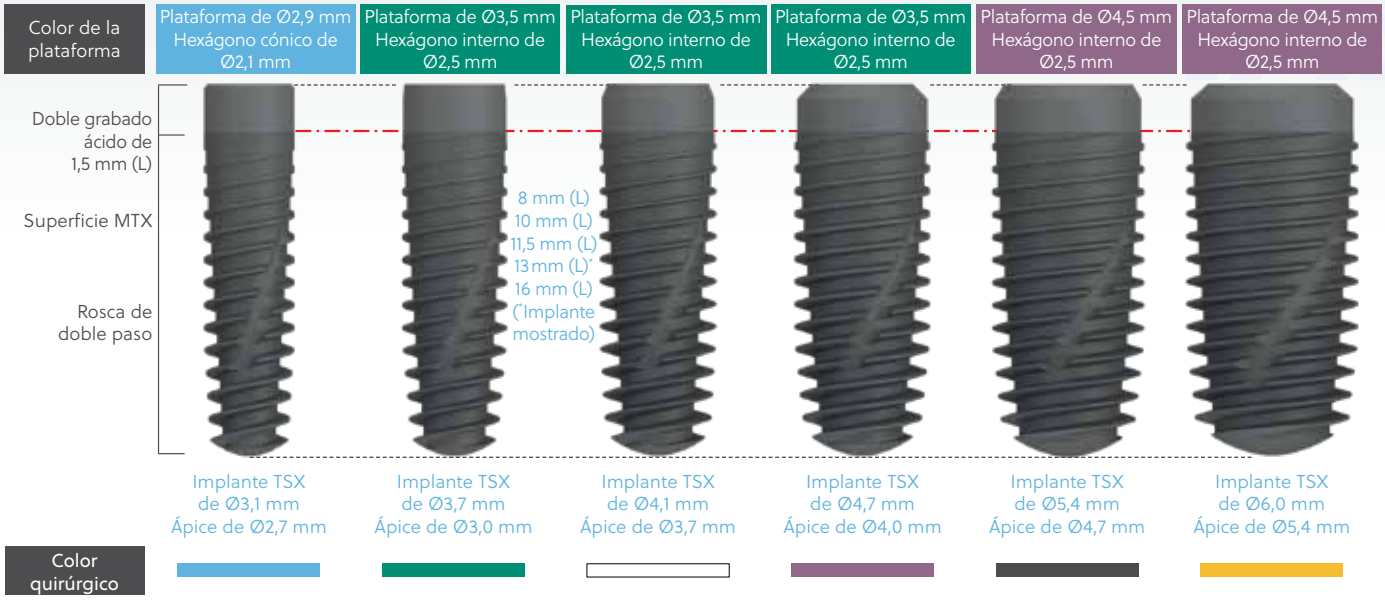

Tornillos de cierre

Incluidos con el implante.

Plataforma del implante		
NP (Ø 2,9 mm)	Ø3,5 mm	Ø4,5 mm
CCSNP	TSC	TSCW

Implantes TSX

Incluyen un tornillo de cierre y un pin de alineación opcional para ayudar a guiar la paralelización durante la colocación de varios implantes.

Diámetro del implante	Plataforma del implante	Conexión hexagonal interna	Longitud del implante				
			8 mm (L)	10 mm (L)	11,5 mm (L)	13 mm (L)	16 mm (L)
Ø3,1 mm	Ø2,9 mm	Ø2,1 mm	TSX31B8	TSX31B10	TSX31B11	TSX31B13	TSX31B16
Ø3,7 mm	Ø3,5 mm	Ø2,5 mm	TSX37B8	TSX37B10	TSX37B11	TSX37B13	TSX37B16
Ø4,1 mm	Ø3,5 mm	Ø2,5 mm	TSX41B8	TSX41B10	TSX41B11	TSX41B13	TSX41B16
Ø4,7 mm*	Ø3,5 mm	Ø2,5 mm	TSX47B8	TSX47B10	TSX47B11	TSX47B13	TSX47B16
Ø5,4 mm	Ø4,5 mm	Ø2,5 mm	TSX54B8	TSX54B10	TSX54B11	TSX54B13	TSX54B16
Ø6,0 mm*	Ø4,5 mm	Ø2,5 mm	TSX6B8	TSX6B10	TSX6B11	TSX6B13	TSX6B16

*Nota: El implante de Ø4,7 mm tiene una plataforma de Ø3,5 mm con código de color verde y el implante de Ø6,0 mm una plataforma de Ø4,5 mm con código de color morado, a diferencia de los implantes TSV®.

Componentes de cicatrización

Pautas de selección del pilar de cicatrización

Selección de un pilar de cicatrización

- Determine el tamaño de la plataforma del implante.
- Seleccione el perfil de emergencia que mejor se adapte a la zona que se va a restaurar. El perfil debe ser adecuado para el coping y el pilar que se vayan a usar.
- Seleccione la altura transepitelial de manera que la parte superior del componente sobresalga ligeramente por encima del tejido circundante.



HC3/TEHA3/TEEHA3 = pilar de cicatrización de Ø3,5 mm (plataforma del implante)
HC4/TEHA4/TEEHA4 = pilar de cicatrización de Ø4,5 mm (plataforma del implante).

Ejemplo:
TEEHA333 = pilar de cicatrización de Ø3,5 mm (plataforma del implante), perfil de emergencia de Ø3,8 mm, altura transepitelial de 3 mm (los dos dígitos centrales se refieren al perfil y el último dígito a la altura)
TEHA3383 = pilar de cicatrización de Ø3,5 mm (plataforma del implante), perfil de emergencia de Ø3,8 mm, altura transepitelial de 3 mm (los dos dígitos centrales se refieren al perfil y el último dígito a la altura)
HC343 = pilar de cicatrización de Ø3,5 mm (plataforma del implante), perfil de emergencia de Ø4,5 mm, altura transepitelial de 3 mm (el segundo dígito se refiere al perfil y el tercer dígito a la altura)

Pilares de cicatrización Encode Emergence*

El pilar de cicatrización Encode es un pilar de cicatrización de dos piezas/cofia de impresión/cuerpo de escaneado 3 en 1.

Pilares de cicatrización Encode Emergence para implantes TSX Ø3.1 mm

Plataforma del implante	Perfil de emergencia	Altura transepitelial		
		3,0 mm	5,0 mm	7,0 mm
Ø2.9 mm	Ø3,7 mm	CEEHA333	CEEHA335	CEEHA337
	Ø4,5 mm	CEEHA343	CEEHA345	CEEHA347

Pilares de cicatrización Encode Emergence para implantes TSX

Plataforma del implante	Perfil de emergencia	Altura transepitelial		
		3,0 mm	5,0 mm	7,0 mm
Ø3,5 mm	Ø3,8 mm	TEEHA333	TEEHA335	TEEHA337
Ø3,5 mm	Ø5,0 mm	TEEHA353	TEEHA355	TEEHA357
Ø3,5 mm	Ø6,5 mm	TEEHA363	TEEHA365	TEEHA367
Ø4,5 mm	Ø4,5 mm	TEEHA443	TEEHA445	TEEHA447
Ø4,5 mm	Ø5,5 mm	TEEHA453	TEEHA455	TEEHA457
Ø4,5 mm	Ø6,5 mm	TEEHA463	TEEHA465	TEEHA467
Ø4,5 mm	Ø7,5 mm	TEEHA473	TEEHA475	TEEHA477

*No disponible en todos los mercados.

Pilares de cicatrización

Plataforma del implante	Perfil de emergencia	Altura transepitelial		
		1,5 mm	3,0 mm	4,5 mm
NP (Ø2,9 mm)	Ø3,7 mm	CHCNP31	CHCNP33	CHCNP34
NP (Ø2,9 mm)	Ø4,5 mm	CHCNP41	CHCNP43	CHCNP44

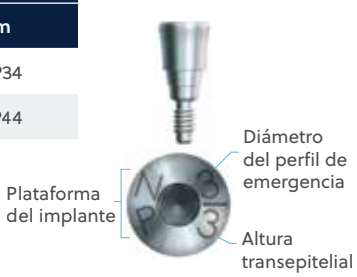

Plataforma del implante	Perfil de emergencia	Altura transepitelial		
		3,0 mm	5,0 mm	7,0 mm
Ø3,5 mm	Ø3,5 mm (sin ensanchamiento)	HC333	HC335	—
Ø3,5 mm	Ø4,5 mm	HC343	HC345	HC347
Ø3,5 mm	Ø5,5 mm	HC353	HC355	—
Ø4,5 mm	Ø4,5 mm (sin ensanchamiento)	HC443	HC445	—
Ø4,5 mm	Ø5,5 mm	HC453	HC455	HC457
Ø4,5 mm	Ø6,5 mm	HC463	HC465	—

Protésis

Coping de impresión

Transportador multifuncional/Coping

No se incluye con el implante TSX. Incluye un tornillo de retención (URS2). Se puede usar como pilar provisional preparable.

Plataforma del implante	Perfil de emergencia	Referencia
Ø3,5 mm	Ø4,5 mm	FMT3
Ø4,5 mm	Ø5,5 mm	FMT4
Tornillo de retención de repuesto	—	URS2

Coping indirecto (procedimiento de cubeta cerrada)

Con códigos de colores según la plataforma del implante. Incluye un tornillo de retención (CASLT).

Plataforma del implante	Perfil de emergencia	Altura transepitelial		
		1,5 mm	3,0 mm	4,5 mm
NP (Ø2,9 mm)	Ø3,7 mm	CITNP31	CITNP33	CITNP34
NP (Ø2,9 mm)	Ø4,5 mm	CITNP41	CITNP43	CITNP44
Tornillo de retención de repuesto		CASLT	CASLT	CASLT

Con códigos de colores según la plataforma del implante. Incluye un tornillo de retención (HLTS2).

Plataforma del implante	Perfil de emergencia			
	Ø3,5 mm	Ø4,5 mm	Ø5,5 mm	Ø6,5 mm
Ø3,5 mm	HLT3/3	HLT3/4	HLT3/5	—
Ø4,5 mm	—	HLT4/4	HLT4/5	HLT4/6
Tornillo de extensión de 3 mm para coping indirecto	HLTE	HLTE	HLTE	HLTE
Tornillo de retención de repuesto	HLTS2	HLTS2	HLTS2	HLTS2

Copings directos (procedimiento de cubeta abierta)

Con códigos de colores según la plataforma del implante. Incluye un tornillo de retención (CASLC).

Plataforma del implante	Perfil de emergencia	Altura transepitelial		
		1,5 mm	3,0 mm	4,5 mm
NP (Ø2,9 mm)	Ø3,7 mm	CDTNP31	CDTNP33	CDTNP34
NP (Ø2,9 mm)	Ø4,5 mm	CDTNP41	CDTNP43	CDTNP44
Tornillo de retención de repuesto		CASLC	CASLC	CASLC

Con códigos de colores según la plataforma del implante. Incluye un tornillo de retención (DHTS).

Plataforma del implante	Perfil de emergencia			
	Ø3,5 mm	Ø4,5 mm	Ø5,5 mm	Ø6,5 mm
Ø3,5 mm	DHT3/3	DHT3/4	DHT3/5	—
Ø4,5 mm	—	DHT4/4	DHT4/5	DHT4/6
Tornillo de retención de repuesto	DHTS	DHTS	DHTS	DHTS

Análogos de implante de titanio para modelos de escayola

Con códigos de colores según la plataforma del implante.

Plataforma del implante	Referencia
NP (Ø2,9 mm)	CIANP
Ø3,5 mm	IA3
Ø4,5 mm	IA4

Restauraciones provisionales

Pilar provisional de titanio

Incluye un tornillo de retención (CUAS) y un tornillo de procesado largo (CASLC)

Plataforma del implante	Perfil de emergencia	Referencia
NP (Ø2,9 mm)	Ø3,5 mm	CTANP31
Tornillo de retención de repuesto		CUAS
Tornillo de procesamiento largo de recambio		CASLC

Pilares provisionales de plástico, rectos

Incluye tornillo de retención y tornillo de procesado (DHTS2).

Plataforma del implante	Perfil de emergencia	Altura transepitelial	
		1,0 mm	4,0 mm
Ø3,5 mm	Ø4,5 mm	PT341S	PT344S
Ø4,5 mm	Ø5,5 mm	PT451S	PT454S
Tornillo de retención de recambio, largo		DHTS2	DHTS2

Pilares provisionales de plástico, angulados 17°

Incluye tornillo de retención y tornillo de procesado (DHTS2).

Plataforma del implante	Perfil de emergencia	Altura transepitelial	
		1,0 mm	4,0 mm
Ø3,5 mm	Ø4,5 mm	PT341A	PT344A
Ø4,5 mm	Ø5,5 mm	PT451A	PT454A
Tornillo de retención de recambio, largo		DHTS2	DHTS2

Restauraciones digitales

Pilares específicos para el paciente

Disponible en titanio.

Diseño por ordenador y precisión CAD/CAM de fresado personalizado.
Póngase en contacto con un representante de ZimVie para obtener más información.

NOTA: Los pilares específicos para pacientes solo están disponibles en determinados mercados.

Herramientas y accesorios

Descripción	Referencia	
Llave dinamométrica protésica Rango de torque ajustable entre 10 y 35 Ncm	TWR	
Llave de carraca indicadora de torque bajo (incluye adaptador Latchlock C9980)	L-TIRW	
Llave de carraca indicadora de torque bajo, adaptador Latchlock estándar ISO 1797	C9980	
Llave de carraca cuadrada de retención GemLock® para restauración con HX1.25, HXL1.25 y SRT	RSR	

Restauraciones cementadas

Tabla de códigos de color: Perfil de emergencia en Hex-Lock®
Componentes/pilares de restauración cortos y Contour

Los colores corresponden al perfil de emergencia del pilar en los pilares de contorno de Hex-Lock y en pilares cortos, así como en los componentes de contorno y de restauración cortos relacionados.

Perfil de emergencia del pilar*	Código de color
Ø4,5 mm	Marrón
Ø5,5 mm	Rosa

*Para los componentes Contour de Hex-Lock y de restauración cortos.

Pilares Contour de Hex-Lock, rectos

Incluye un tornillo de retención (CUAS).

Plataforma del implante	Perfil de emergencia	Altura transepitelial		
		1,5 mm	3,0 mm	4,5 mm
NP (Ø2,9 mm)	Ø3,7 mm*	CANP31S	CANP33S	CANP34S
NP (Ø2,9 mm)	Ø4,5 mm*	CANP41S	CANP43S	CANP44S
Tornillo de retención de repuesto		CUAS	CUAS	CUAS

*Los componentes Contour de Ø3,7 mm con perfil de emergencia son incompatibles con los componentes de restauración Contour de Ø3,5 mm.

Incluye un tornillo de retención (MHLAS).

Plataforma del implante	Perfil de emergencia	Altura transepitelial		
		1,0 mm	2,0 mm	3,0 mm
Ø3,5 mm	Ø4,5 mm	ZOA341S	ZOA342S	ZOA343S
Ø4,5 mm	Ø4,5 mm	ZOA441S	ZOA442S	ZOA443S
Ø4,5 mm	Ø5,5 mm	ZOA451S	ZOA452S	ZOA453S
Tornillo de retención de repuesto		MHLAS	MHLAS	MHLAS

Pilares Contour de Hex-Lock, angulados, 17°

Incluye un tornillo de retención (CUASA o CUAS)

Plataforma del implante	Perfil de emergencia	Altura transepitelial	
		1,5 mm	3,0 mm
NP (Ø2,9 mm)	Ø3,7 mm*	CANP31A	CANP33A
NP (Ø2,9 mm)	Ø4,5 mm**	CANP41A	CANP43A
Tornillo de retención de repuesto		CUASA	CUAS

Incluye un tornillo de retención (AH20S).

Plataforma del implante	Perfil de emergencia	Altura transepitelial	
		1,0 mm	2,0 mm
Ø3,5 mm	Ø4,5 mm	ZOA341A	ZOA342A
Ø4,5 mm	Ø4,5 mm	ZOA441A	ZOA442A
Ø4,5 mm	Ø5,5 mm	ZOA451A	ZOA452A
Tornillo de retención de repuesto		AH20S	AH20S

Kits de prueba de pilares Contour

Plataforma del implante	Perfil de emergencia	Descripción	Referencia
Ø3,5 mm	Ø4,5 mm	Juego de 5: varios ángulos, alturas transepiteliales	ZOAT34
Ø4,5 mm	Ø5,5 mm	Juego de 5: varios ángulos, alturas transepiteliales	ZOAT45
Todos	Todos	3 juegos de 5: todos los tamaños	ZOATKIT

Cofias provisionales Contour

Perfil de emergencia	recto	17°
Ø4,5 mm	ZCPROV4S	ZCPROV4A
Ø5,5 mm	ZCPROV5S	ZCPROV5A

Capuchones de impresión Contour

Perfil de emergencia	Recto	17°
Ø4,5 mm	ZOCIMP4S	ZOCIMP4A
Ø5,5 mm	ZOCIMP5S	ZOCIMP5A

Análogos de pilar Contour, de titanio

Perfil de emergencia	Recto	Angulado
Ø4,5 mm	TCANA4S	TCANA4A
Ø5,5 mm	TCANA5S	TCANA5A

Cofias de encerado de pilar Contour

Perfil de emergencia	Recto	17°
Ø4,5 mm	ZOCWAX4S	ZOCWAX4A
Ø5,5 mm	ZOCWAX5S	ZOCWAX5A

Pilares cortos de Hex-Lock

Incluye un tornillo de retención (MHLAS).

Plataforma del implante	Perfil de emergencia	Altura transepitelial	
		1,0 mm	2,0 mm
Ø3,5 mm	Ø4,5 mm	SA341	SA342
Ø4,5 mm	Ø5,5 mm	SA451	SA452
Tornillo de retención de repuesto		MHLAS	MHLAS

Cofias provisionales cortas

Perfil de emergencia	Referencia
Ø4,5 mm	SAPROVP4
Ø5,5 mm	SAPROVP5

Capuchones de impresión cortos

Perfil de emergencia	Referencia
Ø4,5 mm	SAIMP4
Ø5,5 mm	SAIMP5

Análogos de pilar cortos, de titanio

Perfil de emergencia	Referencia
Ø4,5 mm	SAANA4
Ø5,5 mm	SAANA5

Cofias de encerado cortas

Perfil de emergencia	Referencia
Ø4,5 mm	SAWAX4
Ø5,5 mm	SAWAX5

Pilares de Hex-Lock

Incluye un tornillo de retención (MHLAS).

Plataforma del implante	Perfil de emergencia			
	Ø3,5 mm	Ø4,5 mm	Ø5,5 mm	Ø6,5 mm
Ø3,5 mm	HLA3/3	HLA3/4	HLA3/5	—
Ø4,5 mm	—	HLA4/4	HLA4/5	HLA4/6
Tornillo de retención de recambio, corto	MHLAS	MHLAS	MHLAS	MHLAS
Tornillo de retención de recambio, largo	HLTS2	HLTS2	HLTS2	HLTS2

Pilares angulados de 20°

Incluye un tornillo de retención (CUAS).

Plataforma del implante	Perfil de emergencia	Referencia
NP (Ø2,9 mm)	Ø3,5 mm	C20A3
Tornillo de retención de repuesto		CUAS

Incluye un tornillo de retención (AH2OS).

Plataforma del implante	Perfil de emergencia	Referencia
Ø3,5 mm	Ø4,5 mm	AH20/4
Ø4,5 mm	Ø5,5 mm	AH20W/5
Tornillo de retención de repuesto	—	AH20S

Restauraciones de oro para sobrecolado

Pilares de oro para "sobrecolado", no rotatorio

Incluye un tornillo de retención (CUAS).

Plataforma del implante	Perfil de emergencia	Referencia
NP (Ø2,9 mm)	Ø3,5 mm	CEANP31
Tornillo de retención de repuesto		CUAS
Tornillo de procesado largo		CASLC

Incluye un tornillo de retención (MHLAS).

Plataforma del implante	Referencia
Ø3,5 mm	HLA3G
Ø4,5 mm	HLA4G
Tornillo de retención de repuesto	MHLAS
Tornillo de encerado para pilares "para sobrecolado"	MTWSD

Pilares "para sobrecolado" de oro, rotatorios

Incluye un tornillo de retención (MHLAS).

Plataforma del implante	Referencia
Ø3,5 mm	NEA3G
Ø4,5 mm	NEA4G
Tornillo de retención de repuesto	MHLAS

Restauraciones atornilladas

Pilares Multi-Unit universales rectos

Pilar rotatorio, no encaja en la conexión hexagonal interna. No puede usarse en restauraciones unitarias.
La tapa de cicatrización (UMUA-HCS) se vende por separado.

Plataforma del implante	Altura del cuello				
	1,0 mm	2,0 mm	3,0 mm	4,0 mm	5,0 mm
NP (Ø2,9 mm)	UMUA-NP291S	UMUA-NP292S	UMUA-NP293S	UMUA-NP294S	UMUA-NP295S
Ø3,5 mm	UMUA-TSV351S	UMUA-TSV352S	UMUA-TSV353S	UMUA-TSV354S	UMUA-TSV355S
Ø4,5 mm	UMUA-TSV451S	UMUA-TSV452S	UMUA-TSV453S	UMUA-TSV454S	UMUA-TSV455S

Pilares Multi-Unit universales angulados, 17°

Los pilares encajan en la conexión hexagonal interna. No pueden usarse en restauraciones unitarias (incluye un tornillo de retención premontado).

Plataforma del implante	Altura del cuello	
	2,5 mm	3,5 mm
NP (Ø2,9 mm)	UMUA-NP2925-17S	UMUA-NP2935-17S
Ø3,5 mm	UMUA-TSV3525-17S	UMUA-TSV3535-17S
Ø4,5 mm	UMUA-TSV4525-17S	UMUA-TSV4535-17S

Pilares Multi-Unit universales angulados, 30°

Los pilares encajan en la conexión hexagonal interna. No pueden usarse en restauraciones unitarias (incluye un tornillo de retención premontado).

Plataforma del implante	Altura del cuello	
	3,5 mm	4,5 mm
NP (Ø2,9 mm)	UMUA-NP2935-30S	UMUA-NP2945-30S
Ø3,5 mm	UMUA-TSV3535-30S	UMUA-TSV3545-30S
Ø4,5 mm	UMUA-TSV4535-30S	UMUA-TSV4545-30S

Tapa de cicatrización para pilar universal

La tapa de cicatrización se enrosca en el pilar Multi-Unit universal y en el pilar Multi-Unit angulado.

Descripción	Referencia
Tapa de cicatrización para pilar universal	UMUA-HCS

Cofia de impresión para pilar universal

La cofia de impresión se enrosca en el pilar Multi-Unit universal y en el pilar Multi-Unit angulado para la obtención de impresiones. Este método sirve para transferir la posición del pilar.

Descripción	Altura	Referencia
Cofia de impresión para pilar universal, cubeta abierta Incluye tornillos de transferencia	12 mm	UMUA-OTIC
Cofia de impresión para pilar universal, cubeta cerrada	5 mm	UMUA-CTICS
Cofia de impresión para pilar universal, cubeta cerrada, (4 uds.)	5 mm	UMUA-CTICS4
Cofia de impresión para pilar universal, cubeta cerrada	8 mm	UMUA-CTICL
Cofia de impresión para pilar universal, cubeta cerrada, (4 uds.)	8 mm	UMUA-CTICL4

Cuerpos de escaneo para pilar universal

El cuerpo de escaneo se enrosca en el pilar Multi-Unit universal y en el pilar Multi-Unit angulado.

Descripción	Referencia
Cuerpo de escaneo para pilar universal, intraoral	UMUA-SBIO
Cuerpo de escaneo para pilar universal, base de titanio, (5 uds.)	UMUA-SBTB5
Cuerpo de escaneo para pilar universal, escritorio Incluye tornillo Multi-Unit (UMUA-S)	UMUA-SBDT

Base de titanio para pilar universal

La base de titanio se enrosca en el pilar Multi-Unit universal y en el pilar Multi-Unit angulado.

Descripción	Altura	Referencia
Base de titanio para pilar universal Incluye tornillo Multi-Unit (UMUA-S)	6 mm	UMUA-TTS
Base de titanio para pilar universal Incluye tornillo Multi-Unit (UMUA-S)	8 mm	UMUA-TTL

Base de titanio para pilar universal con canal de tornillo angulado

Descripción	Referencia
Base de titanio para pilar universal con canal de tornillo angulado Incluye tornillo con canal de tornillo angulado (UMUA-ASCTS)	UMUA-ASCT

Análogo para pilar universal para modelos de escayola

Descripción	Referencia
Análogo para pilar universal	UMUA-A

Análogo digital para pilar universal

Descripción	Referencia
Análogo digital para pilar universal Incluye tornillo Multi-Unit (UMUA-S)	UMUA-DA

Tornillos de repuesta para componentes Multi-Unit universales

Descripción	Referencia
Tornillo Multi-Unit universal	UMUA-S
Tornillo con canal angulado universal	UMUA-ASCTS

Cilindro provisional para pilar universal

El cilindro provisional se enrosca en el pilar Multi-Unit universal y en el pilar Multi-Unit angulado.

Descripción	Referencia
Cilindro provisional para pilar universal Incluye tornillo Multi-Unit (UMUA-S)	UMUA-TCS

Fijación para pilar universal OverdenSURE®

Descripción	Referencia
Fijación para pilar universal OverdenSURE	UMUA-ODS

Restauraciones para sobredentadura

Sistema de fijación extraíble OverdenSURE

Altura del cuello	Plataforma del implante		
	NP(Ø2,9 mm)	Ø3,5 mm	Ø4,5 mm
1,0 mm	ODS-NP201	ODS-TSV301	ODS-TSV401
2,0 mm	ODS-NP202	ODS-TSV302	ODS-TSV402
3,0 mm	ODS-NP203	ODS-TSV303	ODS-TSV403
4,0 mm	ODS-NP204	ODS-TSV304	ODS-TSV404
5,0 mm	ODS-NP205	ODS-TSV305	ODS-TSV405
6,0 mm	ODS-NP206	ODS-TSV306	ODS-TSV406

Kit de retención ODS-RIKIT2001 incluido. Disponible en todas las geografías activas excepto EE. UU.

Herramientas y accesorios OverdenSURE

1 cofia de impresión	ODS-IC01
4 cofias de impresión	ODS-IC04
10 cofias de impresión	ODS-IC010
1 análogo	ODS-AA01
4 análogo	ODS-AA04
10 análogo	ODS-AA010
1 kit de retención, 20°	ODS-RIKIT2001
2 kits de retención, 20°	ODS-RIKIT2002
1 kit de retención, 40°	ODS-RIKIT4001
2 kits de retención, 40°	ODS-RIKIT4002
4 conectores de retención azules, 20°	ODS-RIB2004
4 conectores de retención rosas, 20°	ODS-RIP2004
4 conectores de retención transparentes, 20°	ODS-RIC2004

4 conectores de retención rojos, 40°	ODS-RIR4004
4 conectores de retención amarillos, 40°	ODS-RIY4004
4 conectores de retención verdes, 40°	ODS-RIG4004
1 tapa del capuchón de retención	ODS-RH01
4 tapa del capuchón de retención	ODS-RH04
10 tapa del capuchón de retención	ODS-RH010
20 espaciadores de bloqueo	ODS-BS020
Transportador para pilares	ODS-DRVR
Herramienta de extracción e inserción	ODS-IRTOOL
1 fijación de barra de pilar	ODS-BARATT01
2 fijaciones de barra de pilar	ODS-BARATT02
4 fijaciones de barra de pilar	ODS-BARATT04
Cuerpos de escaneo, 10 uds.	ODS-SB010

Pilares de bola

Los pilares no encajan en la conexión hexagonal interna. Incluye pilar de fijación del capuchón y retención de nailon.

Plataforma del implante	Altura transepitelial		
	2,0 mm	4,0 mm	6,0 mm
NP (Ø2,9 mm)	CBANP2	CBANP4	CBANP6
Ø3,5 mm	BAC2	BAC4	BAC6
Ø4,5 mm	BACW2	BACW4	BACW6

Copings de impresión de pilares de bola

Descripción	Referencia
Coping de impresión de pilar de bola (2 uds.)	BAT
Réplica de pilar de bola	BAR

Componentes protésicos

Descripción	Referencia
Pilar de fijación del capuchón (CAH)/Retención de nailon (CAN)	CA
Pilar de fijación del capuchón	CAH
Retención de nailon (transparente)	CAN
Retención de nailon (gris; retención rígida)	CAN-G
Transferencia de fijación de tapa	CAT
Patrón esférico calcinable, 2 esferas por patrón	CAB
Retención de nailon micro	CANM

Herramientas protésicas

Carracas y llaves dinamométricas

Descripción	Referencia	
Llave dinamométrica protésica Rango de torque ajustable entre 10 y 35 Ncm	TWR	
Llave de carraca indicadora de torque bajo (incluye adaptador Latchlock C9980)	L-TIRW	
Llave de carraca indicadora de torque bajo, adaptador Latchlock estándar ISO 1797	C9980	
Llave de carraca cuadrada de retención GemLock para restauración con HX1.25, HXL1.25 y SRT	RSR	

NOTA: No apriete los tornillos protésicos y quirúrgicos más allá del torque recomendado indicado en el manual técnico o en las instrucciones de uso.

Destornilladores hexagonales de Ø1,25 mm para tornillos quirúrgicos y protésicos

Descripción	Modo de uso	Referencia	
Destornillador hexagonal corto con retención GemLock, Ø1,25 mm y 22 mm (L)	A mano	HXGR1.25	
Destornillador hexagonal largo con retención GemLock, Ø1,25 mm y 30 mm (L)	A mano	HXLGR1.25	
Punta de contraángulo hexagonal para tornillos quirúrgicos y protésicos, corto, Ø1,25 mm, 23 mm (L); puede requerir pieza de mano de reducción	Contra ángulo, L-TIRW	HX1.25D	
Punta de contraángulo hexagonal para tornillos quirúrgicos y protésicos, largo, Ø1,2 mm, 26 mm (L); puede requerir pieza de mano de reducción	Contra ángulo, L-TIRW	HXL1.25D	
Destornillador hexagonal para llave dinamométrica, corto, Ø1,25 mm y 17 mm (L)	TWR	TW1.25	
Destornillador hexagonal para llave dinamométrica, largo, Ø1,25 mm y 22 mm (L)	TWR	TW1.25L	
Destornillador hexagonal corto estándar, Ø1,25 mm y 17 mm (L)	RSR	HX1.25	
Destornillador hexagonal largo estándar, Ø1,25 mm y 22 mm (L)	RSR	HXL1.25	

Instrumentos de extracción

Descripción	Modo de uso	Referencia	
Herramienta de extracción para pilares NP (Ø2,9 mm)	A mano o RSR	CLRT2	
Herramienta de extracción para pilares de implantes con conexión hexagonal interna Incluido en los kits quirúrgicos TSV TSVKIT y STRKIT	A mano o RSR	TLRT2	
Herramienta de extracción para tornillos de pilar o fijación Tornillos con hexágono de Ø1,25 mm, acero de carburo Nota: No esterilizar en autoclave	RSR	SRT	

Herramientas y accesorios protésicos adicionales

Descripción	Referencia	
Bandeja de kit protésico, apta para autoclave, vacía	2320	
Portapilares Requiere análogo de implante para conectar los pilares	ABTH	

Tabla de distribución del sistema de kit quirúrgico modular TSX

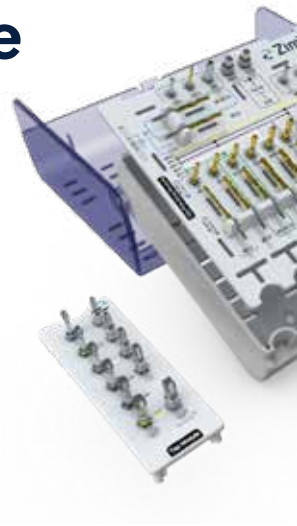

1

1203G
Fresa redonda Ø2,0 mm

2

0201G
Fresa piloto cónica Ø2,1/1,6 mm 8,0 mm - 11,5 mm (L)

3

DEG
Extensor de fresas

4

CLRT2
Herramienta de extracción para pilares NP

5

TLRT2
Herramienta de extracción para pilares con conexión hexagonal interna

6

PPAR
Instrumento de paralelización (4 uds.)

7

EZT28D24G
Fresa escalonada de Ø2,8/2,4 mm, 22 mm (L)

8

EZT24G
Fresa de Ø2,4 mm, 22 mm (L)

9

TSV23SG
Fresa de Ø2,3 mm, 16 mm (L)

10

TSV28SG
Fresa de Ø2,8 mm, 16 mm (L)

11

TSV34D28SG
Fresa escalonada de Ø3,4/2,8 mm, 16 mm (L)

12

TSV34SG
Fresa de Ø3,4 mm, 16 mm (L)

13

TSV38D34SG
Fresa escalonada de Ø3,8/3,4 mm, 16 mm (L)

14

TSV38SG
Fresa de Ø3,8 mm, 16 mm (L)

15

TSV44D38SG
Fresa escalonada de Ø4,4/3,8 mm, 16 mm (L)

16

TSV44SG
Fresa de Ø4,4 mm, 16 mm (L)

Módulo de fresa (incluido en TSXKIT)

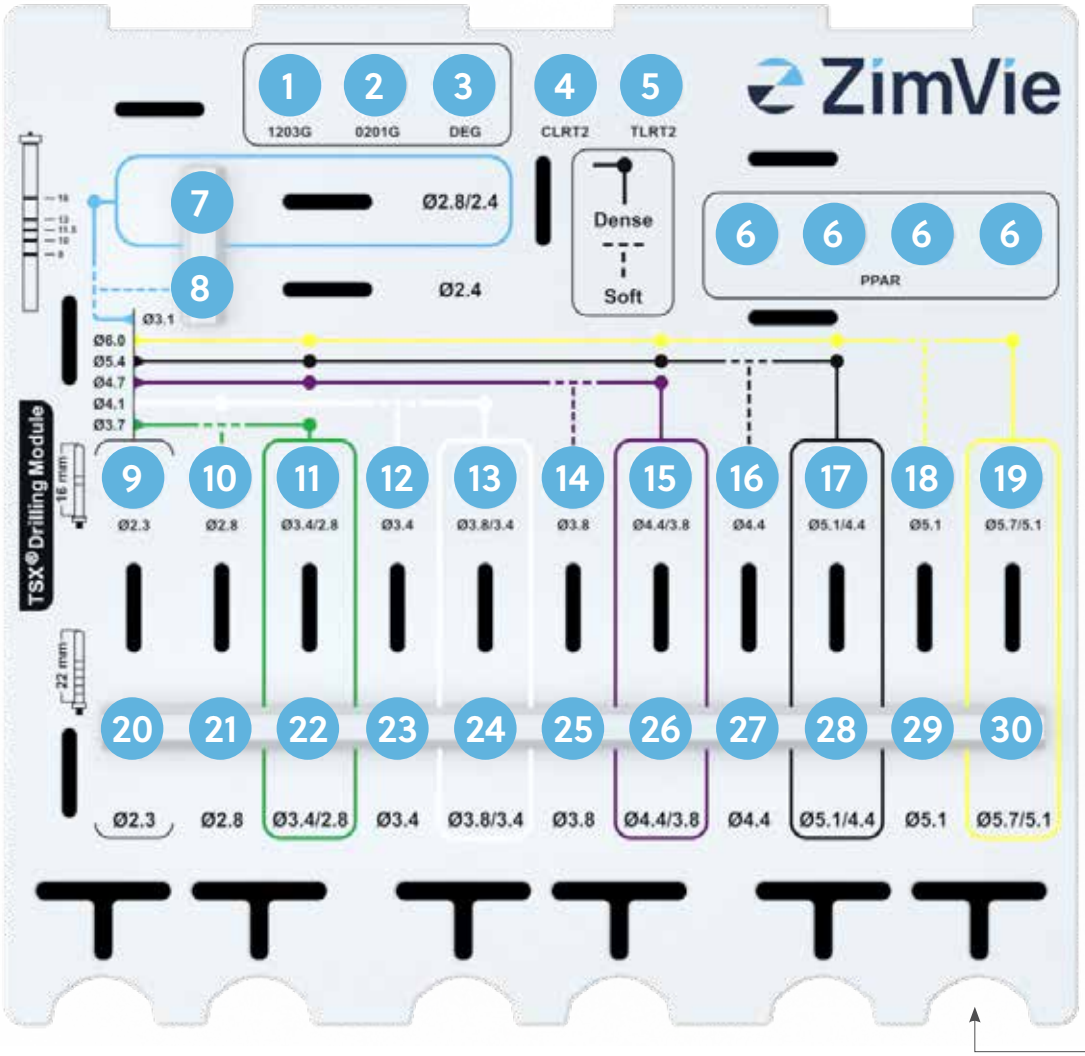

Ranuras de fases del implante

20

TSV23G
Fresa de Ø2,3 mm, 22 mm (L)

24

TSV38D34G
Fresa escalonada de Ø3,8/3,4 mm, 22 mm (L)

28

TSV51D44G
Fresa escalonada de Ø5,1/4,4 mm, 22 mm (L)

17

TSV51D44SG
TSV51D44SG Fresa escalonada de Ø5,1/4,4 mm, 16 mm (L)

18

TSV51SG
Fresa de Ø5,1 mm, 16 mm (L)

19

TSV57D51SG
Fresa escalonada de Ø5,7/5,1 mm, 16 mm (L)

21

TSV28G
Fresa de Ø2,8 mm, 22 mm (L)

22

TSV34D28G
Fresa escalonada de Ø3,4/2,8 mm, 22 mm (L)

23

TSV34G
Fresa de Ø3,4 mm, 22 mm (L)

25

TSV38G
Fresa de Ø3,8 mm, 22 mm (L)

26

TSV44D38G
Fresa escalonada de Ø4,4/3,8 mm, 22 mm (L)

27

TSV44G
Fresa de Ø4,4 mm, 22 mm (L)

29

TSV51G
Fresa de Ø5,1 mm, 22 mm (L)

30

TSV57D51G
Fresa escalonada de Ø5,7/5,1 mm, 22 mm (L)

Módulo de herramientas
(incluido en TSXKIT)

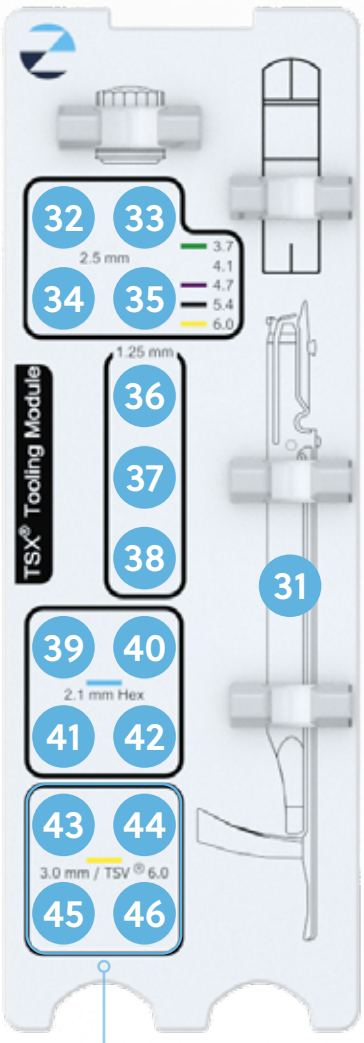

Destornilladores hexagonales de 3,0 mm utilizados con el implante TSV de Ø6,0 mm cuando se retira el transportador
(se adquieren por separado)

31

ZTIRW
Llave de carraca indicadora de alto torque de (0-90 Ncm)

32

GHX2.5D
Punta destornilladora hexagonal GemLock® de 2,5 mm, corta

33

GHX2.5DL
Punta destornilladora hexagonal GemLock de 2,5 mm, larga

34

GHX2.5
Destornillador hexagonal de 2,5 mm GemLock, corto

35

GHX2.5L
Destornillador hexagonal GemLock de 2,5 mm, larga

36

HX1.25D
Punta destornilladora hexagonal de 1,25 mm, corta

37

HXLGR1.25
Destornillador hexagonal de 1,25 mm GemLock, largo

38

HXGR1.25
Destornillador hexagonal de 1,25 mm GemLock, corto

39

CHD2.1
Punta destornilladora hexagonal GemLock de 2,1 mm, corta

40

CHDL2.1
Punta destornilladora hexagonal GemLock de 2,1 mm, larga

41

CHR2.1
Extensor hexagonal GemLock, 2,1 mm, corto

42

CHRL2.1
Extensor hexagonal GemLock, 2,1 mm, largo

43

RHX3.0DS
Punta destornilladora hexagonal, 3,0 mm (D), 21 mm (L)
(se adquieren por separado)

44

RHX3.0DL
Punta destornilladora hexagonal, 3,0 mm (D), 25 mm (L)
(se adquieren por separado)

45

RHX3.0RS
Destornillador hexagonal, carraca, 3,0 mm (D), 17 mm (L)
(se adquieren por separado)

46

RHX3.0RM
Destornillador hexagonal, carraca, 3,0 mm (D), 22 mm (L)
(se adquieren por separado)

Módulo de terrajas **(TAPMOD)**

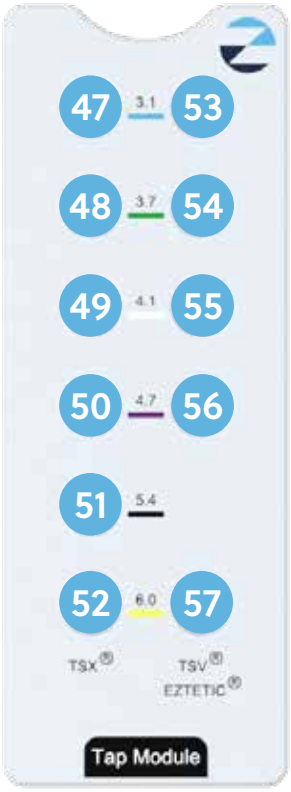

47
TSXTAP31
Ø3,1 mm
Terraja ósea TSX

48
TSXTAP37
Ø3,7 mm
Terraja ósea TSX

49
TSXTAP41
Ø4,1 mm
Terraja ósea TSX

50
TSXTAP47
Ø4,7 mm
Terraja ósea TSX

51
TSXTAP54
Ø5,4 mm
Terraja ósea TSX

52
TSXTAP60
Ø6,0 mm
Terraja ósea TSX

53
ZOPTT30
Ø3,0 mm
Terraja ósea Eztetic

54
TT3.7
Ø3,7 mm
Terraja ósea TSV

55
TT4.1
Ø4,1 mm
Terraja ósea TSV

56
TT4.7
Ø4,7 mm
Terraja ósea TSV

57
TT6.0
Ø6,0 mm
Terraja ósea TSV

Módulo de restauración de arcada completa **(TSXRESTOR)**

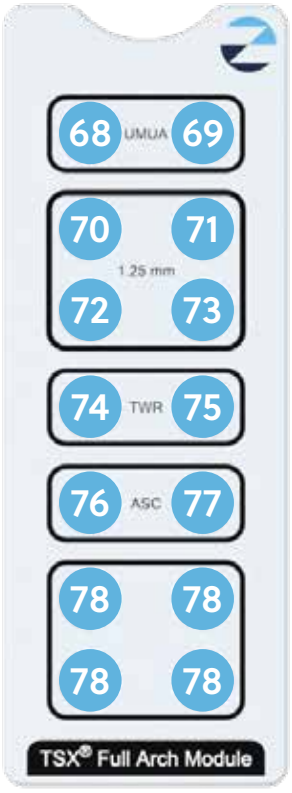

68
UMUA-D
Destornillador Multi-Unit universal

69
ISO4X4A
Punta transportadora Latchlock 4x4

70
HXGR1.25
Destornillador hexagonal de 1,25 mm GemLock, corto

71
HXLGR1.25
Destornillador hexagonal de 1,25 mm GemLock, largo

72
HX1.25D
1,25 mm
Punta destornilladora hexagonal, corta

73
HXL1.25D
1,25 mm
Punta destornilladora hexagonal, larga

74
TW1.25
1,25 mm
Destornillador hexagonal para llave dinamométrica, corto

75
TW1.25L
1,25 mm
Destornillador hexagonal para llave dinamométrica, largo

76
ASC-SD24
Destornillador para canal de tornillo angulado, 24 mm (L)

77
ASC-SD30
Destornillador para canal de tornillo angulado, 30 mm (L)

78
Arandela vacía

Módulo de perfilador óseo **(TSXBPRO)**

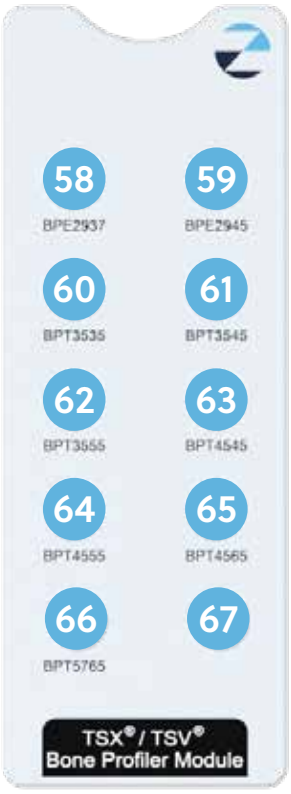

58

BPE2937
Perfilador óseo NP Ø2,9 mm X 3,7 mm (P)

59

BPE2945
Perfilador óseo NP Ø2,9 mm X 4,5 mm (P)

60

BPT3535
Perfilador óseo NP Ø3,5 mm X 3,5 mm (P)

61

BPT3545
Perfilador óseo NP Ø3,5 mm X 4,5 mm (P)

62

BPT3555
Perfilador óseo NP Ø3,5 mm X 5,5 mm (P)

63

BPT4545
Perfilador óseo NP Ø4,5 mm X 4,5 mm (P)

64

BPT4555
Perfilador óseo NP Ø4,5 mm X 5,5 mm (P)

65

BPT4565
Perfilador óseo NP Ø4,5 mm X 6,5 mm (P)

66

BPT5765
Perfilador óseo NP Ø5,7 mm X 6,5 mm (P)

67

Arandela vacía

81

UNPMODTRAY
Bandeja modular, vacía, sujeta de forma segura los instrumentos de cierre Latchlock (se adquieren por separado)

Módulo de llave dinamométrica protésica **(TSXRESTORTW)**

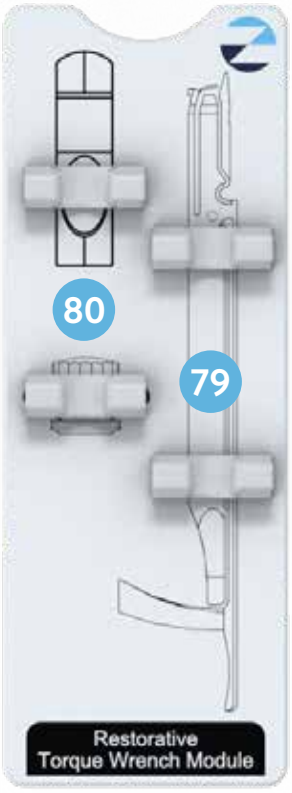

79

L-TIRW
Llave de carraca indicadora de bajo torque (incluye adaptador Latchlock C9980)

80

TWR*
Llave dinamométrica protésica

***NOTA:** La TWR se incluye en el módulo lleno TSXRESTORTW y puede almacenarse opcionalmente en los dos soportes de silicona izquierdos, numerados como 80. Siga las instrucciones de esterilización del fabricante para la TWR.

Sistema de kit quirúrgico modular TSX para implantes TSX

Información para pedidos

Descripción	Referencia	TSXKIT | Kit quirúrgico TSX	TSXSTRKIT | Kit quirúrgico TSX de iniciación
Bandeja quirúrgica TSX para módulo de fresado y herramientas, con tapa y base (vacía)	TSXTRAY	•	•
Fresa redonda de Ø2,0 mm	1203G		•
Fresa piloto cónica de Ø2,1/1,6 mm, 8,0 mm - 11,5 mm (L)	0201G	•	•
Extensor de fresas	DEG	•	•
Herramienta de extracción para pilares NP	CLRT2		•
Herramienta de extracción para pilares con conexión hexagonal interna	TLRT2	•	•
Instrumento de paralelización (4 uds.)	PPAR	•	•
Fresa escalonada de Ø2,8/2,4 mm, 22 mm (L)	EZT28D24G		•
Fresa de Ø2,4 mm, 22 mm (L)	EZT24G		•
Fresa de Ø2,3 mm, 16 mm (L)	TSV23SG	•	•
Fresa de Ø2,8 mm, 16 mm (L)	TSV28SG	•	•
Fresa escalonada de Ø3,4/2,8 mm, 16 mm (L)	TSV34D28SG	•	•
Fresa de Ø3,4 mm, 16 mm (L)	TSV34SG	•	•
Fresa escalonada de Ø3,8/3,4 mm, 16 mm (L)	TSV38D34SG	•	•
Fresa de Ø3,8 mm, 16 mm (L)	TSV38SG	•	•
Fresa escalonada de Ø4,4/3,8 mm, 16 mm (L)	TSV44D38SG	•	•
Fresa de Ø4,4 mm, 16 mm (L)	TSV44SG		•
Fresa escalonada de Ø5,1/4,4 mm, 16 mm (L)	TSV51D44SG		•
Fresa de Ø5,5 mm, 16 mm (L)	TSV51SG		•
Fresa escalonada de Ø5,7/5,1 mm, 16 mm (L)	TSV57D51SG		•
Fresa de Ø2,3 mm, 22 mm (L)	TSV23G	•	•
Fresa de Ø2,8 mm, 22 mm (L)	TSV28G	•	•
FRESA ESCALONADA DE Ø3,4/2,8 mm, 22 mm (L)	TSV34D28G	•	•
FRESA DE Ø3,4 mm, 22 mm(L)	TSV34G	•	•
Fresa escalonada de Ø3,8/3,4 mm, 22 mm (L)	TSV38D34G	•	•
Fresa de Ø3,8 mm, 22 mm (L)	TSV38G	•	•
Fresa escalonada de Ø4,4/3,8 mm, 22 mm (L)	TSV44D38G	•	•
Fresa de Ø4,4 mm, 22 mm (L)	TSV44G		•
Fresa escalonada de Ø5,1/4,4 mm, 22 mm (L)	TSV51D44G		•
Fresa de Ø5,1 mm, 22 mm (L)	TSV51G		•
Fresa escalonada de Ø5,7/5,1 mm, 22 mm (L)	TSV57D51G		•
Llave de carraca indicadora de alto torque de (0-90 Ncm)	ZTIRW	•	•
Punta destornilladora hexagonal GemLock de Ø2,5 mm, corta	GHX2.5D	•	•
Punta destornilladora hexagonal GemLock de Ø2,5 mm, larga	GHX2.5DL	•	•
Destornillador hexagonal manual GemLock de Ø2,5 mm, corto	GHX2.5	•	•
Destornillador hexagonal manual GemLock de Ø2,5 mm, largo	GHX2.5L	•	•
Punta destornilladora hexagonal de Ø1,25 mm, corta	HX1.25D	•	•
Destornillador hexagonal GemLock de Ø1,25 mm, largo	HXLGR1.25	•	•
Destornillador hexagonal GemLock de Ø1,25 mm, corto	HXGR1.25	•	•
Punta destornilladora hexagonal GemLock de Ø2,1 mm, corta	CHD2.1		•
Punta destornilladora hexagonal GemLock de Ø2,1 mm, larga	CHDL2.1		•
Extensor hexagonal GemLock de Ø2,1 mm, corto	CHR2.1		•
Extensor hexagonal GemLock de Ø2,1 mm, largo	CHRL2.1		•

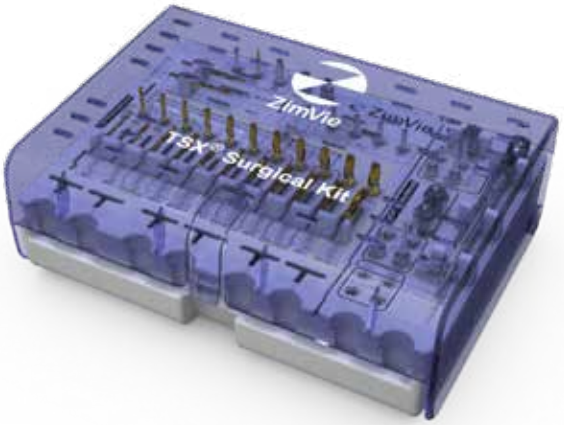

*Los destornilladores hexagonales de Ø3,0 mm no se utilizan con el implante TSX.
El punto indica que el artículo está incluido en el paquete modular lleno.

Kit TSX, configuraciones modulares

Módulo de terrajas

	TAPMOD | Módulo de terrajas TSX	TSXTAPMOD | Módulo de terrajas TSX para implantes TSX	TSVTAPMOD | Módulo de terrajas TSX para implantes TSV y Eztetic
Descripción	**Referencia**			
Bandeja del módulo de terrajas TSX (vacía)	**TAPTRAY**	•	•	•
Terraja ósea TSX de Ø3,1 mm	**TSXTAP31**		•	•
Terraja ósea TSX de Ø3,7 mm	**TSXTAP37**		•	•
Terraja ósea TSX de Ø4,1 mm	**TSXTAP41**		•	•
Terraja ósea TSX de Ø4,7 mm	**TSXTAP47**		•	•
Terraja ósea TSX de Ø5,4 mm	**TSXTAP54**		•	•
Terraja ósea TSX de Ø6,0 mm	**TSXTAP60**		•	•
Terraja ósea Eztetic, Ø3,0 mm	**ZOPTT30**	•		•
Terraja ósea TSV de Ø3,7 mm	**TT3.7**	•		•
Terraja ósea TSV de Ø4,1 mm	**TT4.1**	•		•
Terraja ósea TSV de Ø4,7 mm	**TT4.7**	•		•
Terraja ósea TSV de Ø6,0 mm	**TT6.0**	•		•

Módulo de perfiladores óseos TSX

Referencia	Módulo/herramientas	Descripción
TSXBPRO	**Módulo de perfiladores óseos TSX** para implantes TSX, TSV y Eztetic	Incluye la bandeja de perfiladores óseos [TSXBPROTRAY] y los perfiladores óseos para implantes TSX, TSV y Eztetic
TSXBPROTRAY	**Módulo de perfiladores óseos TSX**	Bandeja (vacía)
BPE2937	**Perfilador óseo NP**	Ø2,9 mm x 3,7 mm (P)
BPE2945	**Perfilador óseo NP**	Ø2,9 mm x 4,5 mm (P)
BPT3535	**Perfilador óseo**	Ø3,5 mm x 3,5 mm (P)
BPT3545	**Perfilador óseo**	Ø3,5 mm x 4,5 mm (P)
BPT3555	**Perfilador óseo**	Ø3,5 mm x 5,5 mm (P)
BPT4545	**Perfilador óseo**	Ø4,5 mm x 4,5 mm (P)
BPT4555	**Perfilador óseo**	Ø4,5 mm x 5,5 mm (P)
BPT4565	**Perfilador óseo**	Ø4,5 mm x 6,5 mm (P)
BPT5765	**Perfilador óseo**	Ø5,7 mm x 6,5 mm (P)

Módulo de arcada completa TSX

Referencia	Módulo/herramientas	Descripción
TSXRESTOR	**Módulo de arcada completa TSX** con instrumental	Incluye la bandeja de arcada completa [TSXRESORTRAY] e instrumental para el asentamiento en consulta de pilares y bases de titanio Multi-Unit universales en implantes TSX, TSV y Eztetic
TSXRESTORTRAY	**Módulo de arcada completa TSX**	Bandeja (vacía)
UMUA-D	**Destornillador Multi-Unit universal**	Se utiliza con la llave dinamométrica TWR para apretar pilares UMUA rectos
ISO4X4A	**Adaptador de destornillador con conexión ISO**	Se utiliza con la llave dinamométrica L-TIRW para apretar pilares UMUA
HXGR1.25	**Destornillador hexagonal GemLock**	Corto, Ø1,25 mm
HXLGR1.25	**Destornillador hexagonal GemLock**	Largo, Ø1,25 mm
HX1.25D	**Punta destornilladora hexagonal**	Corta, Ø1,25 mm
HXL1.25D	**Punta destornilladora hexagonal**	Larga, Ø1,25 mm
TW1.25	**Destornillador hexagonal para llave dinamométrica**	Corto, Ø1,25 mm, usado con la llave dinamométrica TWR
TW1.25L	**Destornillador hexagonal para llave dinamométrica**	Largo, Ø1,25 mm, usado con la llave dinamométrica TWR
ASC-SD24	**Destornillador para canal de tornillo angulado**	24 mm (L), aprieta la base de titanio con canal de tornillo angulado
ASC-SD30	**Destornillador para canal de tornillo angulado**	30 mm (L), aprieta la base de titanio con canal de tornillo angulado

Módulo de llave dinamométrica protésica TSX

Referencia	Módulo/herramientas	Descripción
TSXRESTORTW	**Módulo de llave dinamométrica protésica TSX** con instrumental	Incluye la bandeja de llave dinamométrica protésica [TSXRESOTRTWTRAY]; llaves dinamométricas protésicas L-TIRW y TWR
TSXRESTORTWTRAY	**Módulo de llave dinamométrica protésica TSX**	Bandeja (vacía)
L-TIRW	**Llave de carraca indicadora de torque bajo**	Incluye adaptador Latchlock C9980, utilizado con destornilladores de conexión Latchlock
TWR	**Llave dinamométrica**	Se utiliza con los destornilladores TW1.25 y TW1.25L

Preferencias modulares personales
Información para pedidos

Kit y módulos quirúrgicos TSX

Referencia	Kit quirúrgico	Descripción
TSXKIT	**Kit quirúrgico TSX** para implantes TSX, TSV y Eztetic	Incluye bandeja quirúrgica [TSXTRAY], módulo de fresas y módulo de herramientas, con instrumental para colocar implantes TSX de Ø3,1 mm, Ø3,7 mm, Ø4,1 mm, Ø4,7 mm, Ø5,4 mm y Ø6,0 mm, implantes TSV de Ø3,7 mm, Ø4,1 mm, Ø4,7 mm y Ø6,0 mm, e implantes Eztetic de Ø3,1 mm
TSXSTRKIT	**Kit quirúrgico TSX de iniciación** para implantes TSX y TSV	Incluye bandeja quirúrgica [TSXTRAY], módulo de fresado y módulo de herramientas con instrumental para implantes TSX y TSV de Ø3,7 mm, Ø4,1 mm y Ø4,7 mm
TAPMOD	**Módulo de terrajas TSX** para implantes TSX, TSV y Eztetic	Incluye bandeja de terrajas [TAPTRAY] y terrajas óseas TSX, TSV y Eztetic
TSXTAPMOD	**Módulo de terrajas TSX** para implantes TSX	Incluye bandeja de terrajas [TAPTRAY] y terrajas óseas TSX
TSVTAPMOD	**Módulo de terrajas TSX** para implantes TSV y Eztetic	Incluye bandeja de terrajas [TAPTRAY]; terrajas óseas TSV y Eztetic
TSXBPRO	**Módulo de perfiladores óseos TSX** para implantes TSX, TSV y Eztetic	Incluye la bandeja de perfiladores óseos [TSXBPROTRAY] y los perfiladores óseos para implantes TSX, TSV y Eztetic
TSXRESTOR	**Módulo de arcada completa TSX**	Incluye la bandeja de arcada completa [TSXRESORTRAY] e instrumental para el asentamiento en consulta de pilares y bases de titanio Multi-Unit universales en implantes TSX, TSV y Eztetic
TSXRESTORTW	**Módulo de llave dinamométrica protésica TSX**	Incluye la bandeja de llave dinamométrica protésica [TSXRESOTRTWTRAY]; llaves dinamométricas de restauración L-TIRW y TWR
TSXTRAY	**Bandeja quirúrgica TSX**	Bandejas de módulos de fresado y herramientas con tapa y base (vacías)
TAPTRAY	**Módulo de terrajas TSX**	Bandeja de módulo de terrajas (vacía)
TSXBPROTRAY	**Módulo de perfiladores óseos TSX**	Bandeja de perfiladores óseos (vacía)
TSXRESTORTRAY	**Módulo de arcada completa TSX**	Arcada completa (vacío)
TSXRESTORTWTRAY	**Módulo de llave dinamométrica protésica TSX**	Llave dinamométrica protésica TWR (vacío)
UNPMODTRAY	**Bandeja modular**	Bandeja (vacía), sujeta de forma segura los instrumentos de conexión ISO

Fresas quirúrgicas de la serie Dríva Gold

Fresas piloto quirúrgicas

Diámetro	15 mm (L)*	16 mm (L)*	19 mm (L)	22 mm (L)*	25 mm (L)
Ø2,1/1,6 mm	0201G	—	—	—	—

Fresas quirúrgicas Dríva

Diámetro	15 mm (L)*	16 mm (L)*	19 mm (L)	22 mm (L)*	25 mm (L)
Ø2,3 mm	—	TSV23SG	STR23D19	TSV23G	STR23D25
Ø2,4 mm	—	—	—	EZT24G	—
Ø2,8 mm	—	TSV28SG	STR28D19	TSV28G	STR28D25
Ø3,4 mm	—	TSV34SG	STR34D19	TSV34G	STR34D25
Ø3,8 mm	—	TSV38SG	STR38D19	TSV38G	STR38D25
Ø5,1 mm	—	TSV51SG	—	TSV51G	—

Fresas escalonadas quirúrgicas Dríva

Diámetro	16 mm (L)*	19 mm (L)	22 mm (L)*	25 mm (L)	Código de color
Ø2,8/2,4 mm	—	—	EZT28D24G	—	Azul
Ø3,4/2,8 mm	TSV34D28SG	STP34D19	TSV34D28G	STP34D25	Verde
Ø3,8/3,4 mm	TSV38D34SG	STP38D19	TSV38D34G	STP38D25	Blanco
Ø4,4/3,8 mm	TSV44D38SG	STP44D19	TSV44D38G	STP44D25	Morado
Ø5,1/4,4 mm	TSV51D44SG**	—	TSV51D44G**	—	—
Ø5,7/5,1 mm	TSV57D51SG	—	TSV57D51G	—	Amarillo

*Las fresas de 15 mm (L), 16 mm (L) y 22 mm (L) incorporan bandas axiales que ayudan a identificar el uso con el kit de topes de fresa.
**TSV51D44SG y TSV51D44G son fresas finales para el implante TSX de Ø5,4 mm en huso denso; son fresas intermedias opcionales en la secuencia de fresado de Ø6,0 mm y se venden por separado y no en los kits quirúrgicos.

Las marcas de profundidad están mecanizadas y grabadas con láser para una mayor visibilidad. Las bandas están situadas aproximadamente a 1 mm de distancia de la unión implante-pilar. (por ejemplo, la banda de 13 mm tiene unas dimensiones de 14,25 mm desde la punta de la fresa).

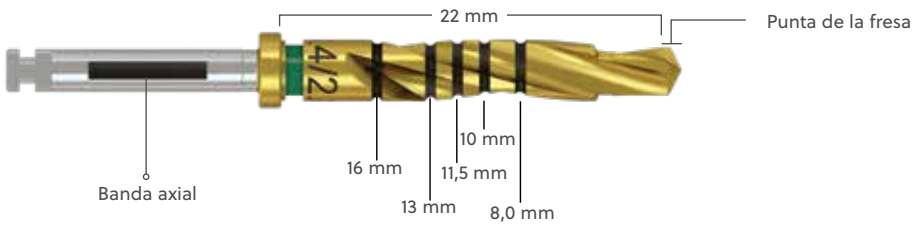

Fresas para uso en un único paciente

Descripción	Cant.	Referencia
Kit de fresas, para paciente único, implante largo de Ø3,7 mm, 17 mm (L)	Fresa redonda Fresa piloto de Ø2,3 mm Fresa escalonada de Ø3,4/2,8 mm	DSTK3
Kit de fresas, para paciente único, implante corto de Ø3,7 mm, 11 mm (L)	Fresa redonda Fresa piloto de Ø2,3 mm Fresa escalonada de Ø3,4/2,8 mm	DSTK3S
Fresa, para paciente único, implante largo de Ø4,7 mm, 17 mm (L)	Fresa escalonada de Ø4,4/3,8 mm	DST4
Fresa, para paciente único, implante corto de Ø4,7 mm, 11 mm (L)	Fresa escalonada de Ø4,4/3,8 mm	DST4S
Fresa, para paciente único, implante largo de Ø6,0 mm, 17 mm (L)	Fresa escalonada de Ø5,7/5,1 mm	DST6
Fresa, para paciente único, implante corto de Ø6,0 mm, 11 mm (L)	Fresa escalonada de Ø5,7/5,1 mm	DST6S

Nota: Sin irrigación interna. Los kits con fresas largas tienen marcas de profundidad para los implantes de 8, 10, 11,5, 13 y 16 mm (L).
Los kits con fresas cortas tienen marcas de profundidad para los implantes de 8 y 10 mm (L).

Instrumentos de colocación de los implantes

Descripción	Referencia	
Llave de carraca indicadora de alto torque	ZTIRW	
Llave de carraca cuadrada de fijación GemLock	RSR	
Mango de destornillador de acero inoxidable	SSHS	

Destornilladores hexagonales, Ø1,25 mm

Descripción	Modo de uso	Referencia	
Destornillador hexagonal corto para apretar tornillos quirúrgicos y protésicos, 17 mm (L)	A mano	HXGR1.25	
Destornillador hexagonal largo para apretar tornillos quirúrgicos y protésicos, 22 mm (L)	A mano	HXLGR1.25	
Punta de contraángulo hexagonal para tornillos quirúrgicos y protésicos, corto, Ø1,25 mm, 23 mm (L); puede requerir pieza de mano de reducción	Contra ángulo, L-TIRW	HX1.25D	
Punta de contraángulo hexagonal para tornillos quirúrgicos y protésicos, largo, Ø1,2 mm, 26 mm (L); puede requerir pieza de mano de reducción	Contra ángulo, L-TIRW	HXL1.25D	
Destornillador hexagonal, corto, de Ø1,25 mm y 17 mm (L)	RSR	HX1.25	
Destornillador hexagonal, largo, de Ø1,25 mm y 22 mm (L)	RSR	HXL1.25	

Destornilladores hexagonales de Ø2,1 mm para la colocación de implantes TSX de Ø3,1 mm

Descripción	Modo de uso	Referencia
Instrumento hexagonal GemLock de 2,1 mm, llave de carraca, corto	ZTIRW, RSR, SSHS	CHR2.1
Instrumento hexagonal GemLock de 2,1 mm, llave de carraca, largo	ZTIRW, RSR, SSHS	CHRL2.1
Fresa hexagonal GemLock de 2,1 mm, corta	Contra ángulo	CHD2.1
Fresa hexagonal GemLock de 2,1 mm, larga	Contra ángulo	CHDL2.1

Destornilladores hexagonales de Ø2,5 mm para la colocación de implantes TSX de Ø3,7 mm y Ø6,0 mm

Descripción	Modo de uso	Referencia
Instrumento hexagonal GemLock de 2,5 mm corto	ZTIRW, RSR, SSHS	RH2.5
Extensor de carraca hexagonal largo con retención GemLock de 2,5 mm y 21 mm (L)	ZTIRW, RSR, SSHS	RHL2.5
Fresa hexagonal GemLock de 2,5 mm, 28 mm (L)	Contra ángulo	RHD2.5

Instrumental quirúrgico

Descripción	Referencia
Extensor de fresas	DEG
Instrumento de paralelización	PPAR
Fresa redonda	1203G
Herramienta de extracción para implantes de tipo atornillado, acero de carburo Nota: No esterilizar en autoclave	IRT

Instrumental para cirugía guiada

Los implantes TSX se pueden colocar de forma totalmente guiada utilizando el kit para cirugía guiada RealGUIDE® Z3D™ y los instrumentos mostrados en las páginas 31 – 32. La información sobre el módulo para cirugía guiada parcialmente para TSVKITG se encuentran en la página 33.

Kit para cirugía totalmente guiada RealGUIDE Z3D*

Producto	Referencia
Kit quirúrgico RealGuide Z3D (cargado por completo)	3DM0070Z
Kit esterilizable en autoclave RealGUIDE Z3D Box	3DM0070ZUS

*No disponible en todos los mercados.

Configuración

Producto	Referencia	
Fresa para el pin de fijación máx. 1000 rpm, acero inoxidable endurecido AISI 420B con revestimiento DLC	3DM00610Z	
Pin de fijación TiAl6V4 ASTM F136	3DM00609Z	
Extensor del destornillador hexagonal máx. 50 Ncm, acero inoxidable endurecido AISI 420F MOD	3DM00623Z	
Conector cuadrado 4 × 4 para pieza de mano máx. 50 Ncm, acero inoxidable endurecido AISI 420F MOD	3DM00612Z	
Medidor de la apertura bucal/medidor de la mordida acero inoxidable endurecido AISI 303	3DM00622Z	
Bisturí para la mucosa bucal/bisturí circular Diámetro interno: 4,2 mm, máx. 100 rpm, acero inoxidable endurecido AISI 420F MOD con revestimiento DLC (carbono tipo diamante)	3DM00607Z	
Nivelador de la cresta ósea máx. 600 rpm, acero inoxidable endurecido AISI 420B con revestimiento DLC	3DM00614Z	
Fresa de inicio Fresa de preparación del lecho del implante, máx. 600 rpm, acero inoxidable endurecido AISI 420B con revestimiento DLC (carbono tipo diamante)	3DM00621Z	
Fresa de 2,4 × Ø6 mm máx. 800 rpm, acero inoxidable endurecido AISI 420B con revestimiento DLC	3DM00619Z	

Componentes del kit RealGUIDE Z3D totalmente guiado

Monturas de implantes RealGUIDE Z3D (acero inoxidable endurecido AISI 420F MOD)

Producto	Referencia	
ZimVie TSX/Eztetic RealGUIDE Z3D Ø3,1 mm que incluyen tornillo, máx. 20 rpm, 50 Ncm	3DM00606ZIM31	
ZimVie TSX Ø3,7/4,1/4,7 mm, ZimVie TSV Ø3,7/4,1 mm que incluyen tornillo, máx. 20 rpm, 50 Ncm	3DM00606ZIM35	
ZimVie TSV Ø4,7 mm que incluyen tornillo, máx. 20 rpm, 50 Ncm	3DM00606ZIM47	

Fresas RealGUIDE Z3D (acero inoxidable endurecido AISI 420B con revestimiento de DLC [carbono tipo diamante])

Longitud	Fresa Ø2,4 mm	Fresa escalonada de Ø2,8/2,4 mm	Fresa escalonada de Ø3,4/2,8 mm	Fresa escalonada de Ø3,8/3,4 mm	Fresa escalonada de Ø4,4/3,8 mm
			máx. 800 rpm		
8 mm	3DM00613.24.080Z	3DM00613.28.080Z	3DM00613.34.080Z	3DM00613.38.080Z	3DM00613.44.080Z
10 mm	3DM00613.24.100Z	3DM00613.28.100Z	3DM00613.34.100Z	3DM00613.38.100Z	3DM00613.44.100Z
11,5 mm	3DM00613.24.115Z	3DM00613.28.115Z	3DM00613.34.115Z	3DM00613.38.115Z	3DM00613.44.115Z
13 mm	3DM00613.24.130Z	3DM00613.28.130Z	3DM00613.34.130Z	3DM00613.38.130Z	3DM00613.44.130Z
16 mm	3DM00613.24.160Z	3DM00613.28.160Z	3DM00613.34.160Z	3DM00613.38.160Z	3DM00613.44.160Z

Accesorios RealGUIDE Z3D

Producto	Referencia
Protector de guía quirúrgica Método CAD RealGUIDE 5,05 mm, 3DM RealGUIDE compatible, kit ZimVie RealGUIDE Z3D, kit RP Nobel (10 uds.)	3DM00670
Protector de pin de fijación de guía quirúrgica Método CAD RealGUIDE (10 uds.)	3DM00671

Instrumental para cirugía guiada parcialmente

Descripción	Referencia
Módulo de fresado para cirugía guiada Se puede insertar en el TSVKITG para un kit integral de cirugía guiada	GSMOD
Fresa quirúrgica Dríva EG de Ø2,3 mm y 19 mm (L)	STR23D19
Fresa quirúrgica Dríva EG de Ø 2,3 mm y 25 mm (L)	STR23D25
Fresa escalonada quirúrgica Dríva EG de Ø2,8/2,4 mm y 19 mm (L)	STP28D19
Fresa escalonada quirúrgica Dríva EG de Ø2,8/2,4 mm y 25 mm (L)	STP28D25
Fresa quirúrgica Dríva EG de Ø2,8 mm y 19 mm (L)	STR28D19
Fresa quirúrgica Dríva EG de Ø2,8 mm y 25 mm (L)	STR28D25
Fresa escalonada quirúrgica Dríva EG de Ø3,4/2,8 mm y 19 mm (L)	STP34D19
Fresa escalonada quirúrgica Dríva EG de Ø3,4/2,8 mm y 25 mm (L)	STP34D25
Fresa quirúrgica Dríva EG de Ø3,4 mm y 19 mm (L)	STR34D19
Fresa quirúrgica Dríva EG de Ø 3,4 mm y 25 mm (L)	STR34D25
Fresa escalonada quirúrgica Dríva EG de Ø3,8/3,4 mm y 19 mm (L)	STP38D19
Fresa escalonada quirúrgica Dríva EG de Ø3,8/3,4 mm y 25 mm (L)	STP38D25
Fresa quirúrgica Dríva EG de Ø3,8 mm y 19 mm (L)	STR38D19
Fresa quirúrgica Dríva EG de Ø 3,8 mm y 25 mm (L)	STR38D25
Fresa escalonada quirúrgica Dríva EG de Ø4,4/3,8 mm y 19 mm (L)	STP44D19
Fresa escalonada quirúrgica Dríva EG de Ø4,4/3,8 mm y 25 mm (L)	STP44D25

Conector de módulo para cirugía guiada (vacío)	GSTRAY

Kit de adaptadores de tubos* Incluye uno 1 de cada adaptador de tubos indicado a continuación; Las fresas EG se utilizan con el kit de adaptadores de tubos;	TADKIT
Adaptador de tubos de Ø2,3 mm, A	TAD23A
Adaptador de tubos de Ø2,8 mm, A	TAD28A
Adaptador de tubos de Ø3,4 mm, A	TAD34A
Adaptador de tubos de Ø2,3 mm, B	TAD23B
Adaptador de tubos de Ø2,8 mm, B	TAD28B
Adaptador de tubos de Ø3,4 mm, B	TAD34B
Adaptador de tubos de Ø3,8 mm, B	TAD38B
Adaptador de tubos de Ø4,4 mm, B	TAD44B

*Para uso con las fresas Driva EG y las fresas Driva con banda axial.

Kit de tope de fresa*

Descripción	Referencia
Kit completo de topes de fresa (fresas no incluidas)	DSKIT
Conjunto de topes, implante de 8 mm (L), fresa Dríva de Ø2,3 - 4,4/3,8 mm x 17/22 mm (L) (5 uds.)	SS8D22
Conjunto de topes, implante de 10 mm (L), fresa Dríva de Ø2,3 - 4,4/3,8 mm x 17/22 mm (L) (5 uds.)	SS10D22
Conjunto de topes, implante de 11,5 mm (L), fresa Dríva de Ø2,3 - 4,4/3,8 mm x 17/22 mm (L) (5 uds.)	SS11D22
Conjunto de topes, implante de 13 mm (L), fresa Dríva de Ø2,3 - 4,4/3,8 mm x 17/22 mm (L) (5 uds.)	SS13D22
Conjunto de topes, implante de 8 mm (L), fresa Dríva de Ø2,3 - 4,4/3,8 mm x 11/16 mm (L) (5 uds.)	SS8D16
Conjunto de topes, implante de 10 mm (L) - fresa Dríva de 11/16 mm (L) e implante de 16 mm (L) - fresa Dríva de 17/22 mm (L), fresa Dríva de Ø 2,3 - 4,4/3,8 mm (5 uds.)	SS10D16
Conjunto de topes, implante de 11,5 mm (L), fresa Dríva de Ø2,3 - 4,4/3,8 mm x 11/16 mm (L) (5 uds.)	SS11D16
Conjunto de topes, implante de 8-16 mm (L), fresa Dríva de Ø5,1 mm x 11/16 mm y fresa Dríva de 17/22 mm (L) (7 uds.)	SS51D
Conjunto de topes, implante de 8-16 mm (L), fresa Dríva de Ø5,7/5,1 mm x 11/16 mm (L) y 17/22 mm (L) (7 uds.)	SS57D
Herramienta multiusos de topes de fresa	MTL

Perfiladores óseos

Perfiladores óseos para pilares de cicatrización Encode®

Plataforma de restauración	Perfil de emergencia	Pilar de cicatrización TSV Encode	Conexión TSV
3,5 mm	3,8 mm	TEHA3383/TEEHA333	BPT3545
		TEHA3385/TEEHA335	
		TEHA3387/TEEHA337	
	5,0 mm	TEHA3503/TEEHA353	BPT3555
		TEHA3505/TEEHA355	
4,5 mm	5,0 mm	TEHA4503	BPT4555
		TEHA4505	
	5,6 mm	TEHA4563/TEEHA453	BPT4565
		TEHA4565/TEEHA455	
		TEHA4567/TEEHA457	
	6,0 mm	TEHA4603/TEEHA463	BPT4565
		TEHA4605/TEEHA465	

Perfiladores óseos para implantes TSX

Plataforma de restauración	Perfil de emergencia	Conexión Eztetic
2,9 mm	3,7 mm	BPE2937
	4,5 mm	BPE2945

Perfiladores óseos para implantes TSX

Plataforma de restauración	Perfil de emergencia	Conexión TSV
3,5 mm	3,7 mm	BPT3535
	4,5 mm	BPT3545
	5,5 mm	BPT3555
4,5 mm	4,5 mm	BPT4545
	5,5 mm	BPT4555
	6,5 mm	BPT4565

Nota: Se puede utilizar para pilares cónicos

Notas

Para obtener más información, visita ZimVie.eu

ZimVie US Corp LLC
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Phone: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272
dentalCS@ZimVie.com

ZimVie Spain S.L.U.
WTC Almeda Park, Ed. 4, Pl. 2
C/Tirso de Molina, 40 (entrada Plaça de la Pau)
08940, Cornellà de Llobregat
Atención al cliente España: 900-800-303
Atención al cliente Portugal: 800-827-836
Fax para pedidos: 93-445-81-36
ZV.pedidos@ZimVie.com

Salvo que se indique lo contrario, tal y como se especifica en el presente documento, todas las marcas comerciales y los derechos de propiedad intelectual son propiedad de ZimVie Inc. o sus filiales, y todos los productos son fabricados por una o varias de las filiales dentales de ZimVie US Corp LLC (Biomet 3i, LLC, etc.), y distribuidos por ZimVie US Corp LLC y sus socios comerciales autorizados. Los análogos de implante digitales, los pilares Multi-Unit Universal y los pilares OverdenSURE están fabricados por Terrats Medical S.L. La llave de carraca indicadora de alto torque ZTIRW y la llave de carraca indicadora de bajo torque L-TIRW están fabricadas por Elos Medtech Pinol A/S. El instrumental RealGUIDE Z3D está fabricado por Biomec S.r.l., con excepción de los artículos 3DM0070ZUS, 3DM00670 y 3DM00671, que están fabricados por 3DIEMME S.r.l. Clasificación de dispositivos médicos de la UE: Pilares y cofias dentales (clase IIb), análogos dentales (clase I), herramientas dentales (clase IIa), cuerpo de escaneo dental (clase I), pilar de cicatrización dental (clase IIb). Implantes dentales (clase IIb), tapas de impresión (clase Is). La finalidad prevista de los pilares y las cofias dentales es restaurar implantes, la de los análogos dentales es reproducir implantes en modelos de laboratorio, la de las herramientas dentales es colocar componentes, la del cuerpo de escaneo dental es digitalizar casos de implantes y la del pilar de cicatrización dental es moldear el tejido blando durante la cicatrización de los implantes. La finalidad prevista de los implantes dentales es sustituir piezas dentales perdidas o arcadas dentales edéntulas proporcionando un medio de fijación protésica. Las tapas de impresión facilitan la referencia posicional de un pilar. Los productos aquí mostrados no cumplen los criterios para el reembolso en Francia. Para otros países, consulta las leyes y normativas locales. Si deseas más información sobre algún producto, consulta el etiquetado o las instrucciones de uso del producto en cuestión. La autorización y la disponibilidad del producto pueden estar limitadas a ciertos países o regiones. Este material está destinado exclusivamente a odontólogos y no incluye asesoramiento ni recomendaciones de carácter médico. Queda prohibida su distribución a ningún otro destinatario. Está prohibido copiar o reimprimir este material sin el consentimiento expreso por escrito de ZimVie. ZVINST0037-EMEA-ES REV F 05/26 ©2026 ZimVie. Todos los derechos reservados.

El número de NB aplicable a cada dispositivo se puede encontrar en la etiqueta del producto, si procede. CE 2797 CE 0051 CE