Catalogue produits

Système d'implant TSX®

ZimVie

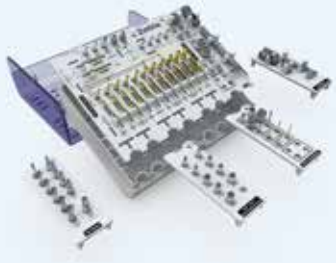

Table des matières

Implants dentaires **3**
Implants TSX® 3

Piliers de cicatrisation **4**
Guide de sélection d'un pilier de cicatrisation 4
Pilier de cicatrisation Encode® Emergence 4
Pilier de cicatrisation Encode 4
Piliers de cicatrisation 5

Prothèses **6**
Prise d'empreinte 6
Prothèses provisoires 7
Prothèses numériques 8
Prothèses scellées 9
Prothèses en or façonnable « à surcouler » 12
Prothèses transvissées 13
Stabilisation de prothèses amovibles 16
Instruments prothétiques 18

Système de trousse de chirurgie modulaire TSX **20**
Tableau du contenu 20
Système de trousse de chirurgie modulaire TSX pour implants TSX 24
Trousse TSX, configuration modulaire 25
Préférences modulaires personnelles
Références pour passer commande 27

Trousses et instruments chirurgicaux **28**
Forets chirurgicaux Dríva™ Gold Series 28
Instruments de chirurgie guidée 31
Instruments pour kit de chirurgie totalement guidée RealGUIDE® Z3D™ 32
Profileurs d'os 34

Implants TSX

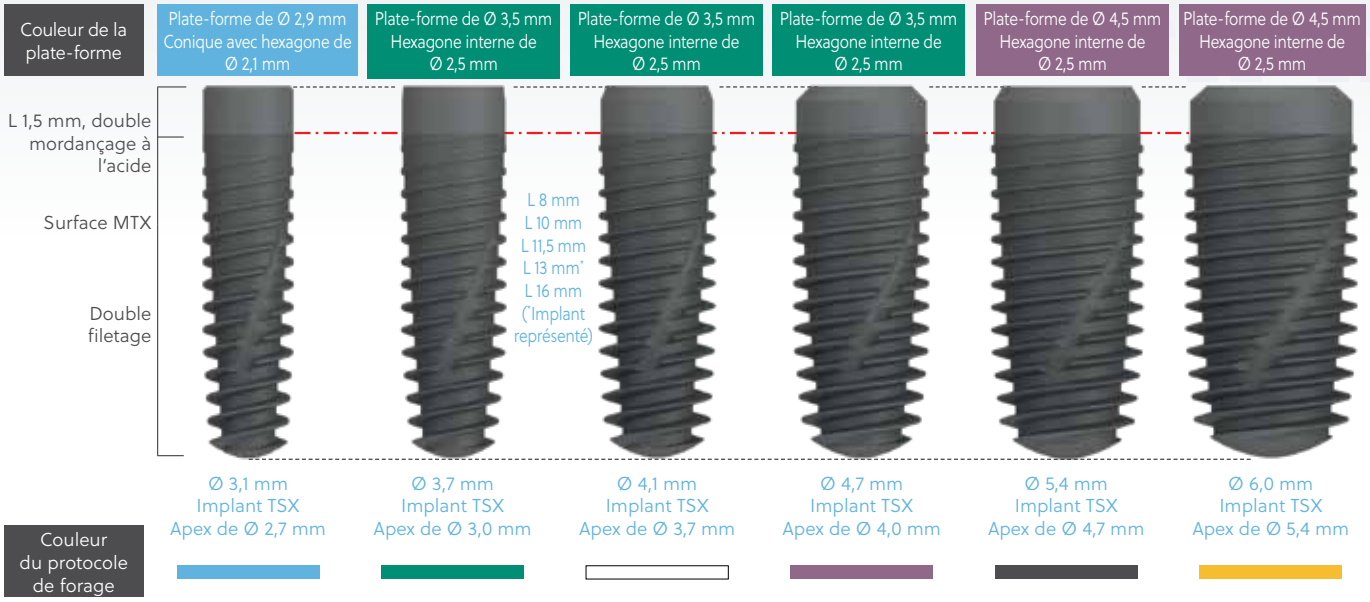

Vis de couverture chirurgicales

Fournies avec l'implant.

Plate-forme implantaire		
NP (Ø 2,9 mm)	Ø 3,5 mm	Ø 4,5 mm
CCSNP	TSC	TSCW

Implants TSX

Inclut une vis de couverture et un pins d'alignement en option pour faciliter le parallélisme lors de la pose de plusieurs implants.

Diamètre de l'implant	Plate-forme implantaire	Connexion hexagonale interne	Longueur de l'implant				
			L 8 mm	L 10 mm	L 11,5 mm	L 13 mm	L 16 mm
Ø 3,1 mm	Ø 2,9 mm	Ø 2,1 mm	TSX31B8	TSX31B10	TSX31B11	TSX31B13	TSX31B16
Ø 3,7 mm	Ø 3,5 mm	Ø 2,5 mm	TSX37B8	TSX37B10	TSX37B11	TSX37B13	TSX37B16
Ø 4,1 mm	Ø 3,5 mm	Ø 2,5 mm	TSX41B8	TSX41B10	TSX41B11	TSX41B13	TSX41B16
Ø 4,7 mm*	Ø 3,5 mm	Ø 2,5 mm	TSX47B8	TSX47B10	TSX47B11	TSX47B13	TSX47B16
Ø 5,4 mm	Ø 4,5 mm	Ø 2,5 mm	TSX54B8	TSX54B10	TSX54B11	TSX54B13	TSX54B16
Ø 6,0 mm*	Ø 4,5 mm	Ø 2,5 mm	TSX6B8	TSX6B10	TSX6B11	TSX6B13	TSX6B16

*Remarque : l'implant de Ø 4,7 mm est doté d'une plate-forme de Ø 3,5 mm à code couleur vert et l'implant de Ø 6,0 mm est doté d'une plate-forme de Ø 4,5 mm à code couleur violet, contrairement aux implants TSV®.

Piliers de cicatrisation

Guide de sélection d'un pilier de cicatrisation

Sélection d'un pilier de cicatrisation :

- Déterminer le diamètre de la plate-forme implantaire
- Sélectionner le profil d'émergence le plus adapté au site de restauration. Le profil doit correspondre au transfert d'empreinte et/ou au pilier à utiliser.
- Sélectionner la hauteur du pilier de cicatrisation adéquate afin que la partie supérieure du composant dépasse légèrement au-dessus du tissu.

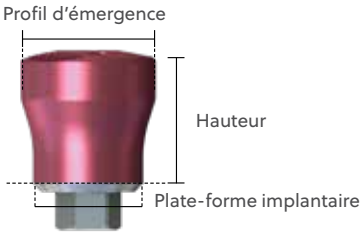

HC3/TEHA3/TEEHA3 = pilier de cicatrisation Ø 3,5 mm (plate-forme implantaire)
HC4/TEHA4/TEEHA4 = pilier de cicatrisation Ø 4,5 mm (plate-forme implantaire)

Exemple :

TEEHA333 = pilier de cicatrisation Ø 3,5 mm (plate-forme implantaire), profil d'émergence Ø 3,8 mm, hauteur transgingivale 3,0 mm (la valeur centrale correspond au profil, la troisième valeur correspond à la hauteur)
TEHA3383 = pilier de cicatrisation Ø 3,5 mm (plate-forme d'implant), profil d'émergence Ø 3,8 mm, hauteur transgingivale 3,0 mm (les deux valeurs centrales correspondent au profil, la troisième valeur correspond à la hauteur)
HC343 = pilier de cicatrisation Ø 3,5 mm (plate-forme d'implant), profil d'émergence Ø 4,5 mm, hauteur transgingivale 3,0 mm (la deuxième valeur correspond au profil, la troisième valeur correspond à la hauteur)

Piliers de cicatrisation Encode Emergence*

Le pilier de cicatrisation Encode Emergence 3 en 1 en deux parties est un pilier de cicatrisation / un transfert d'empreinte / un scanbody.

Piliers de cicatrisation Encode Emergence pour Implants TSX Ø 3,1 mm

Plate-forme implantaire	Profil d'émergence	Hauteur transgingivale		
		3,0 mm	5,0 mm	7,0 mm
Ø 2,9 mm	Ø 3,7 mm	CEEHA333	CEEHA335	CEEHA337
	Ø 4,5 mm	CEEHA343	CEEHA345	CEEHA347

Piliers de cicatrisation Encode Emergence pour Implants TSX

Plate-forme implantaire	Profil d'émergence	Hauteur transgingivale		
		3,0 mm	5,0 mm	7,0 mm
Ø 3,5 mm	Ø 3,8 mm	TEEHA333	TEEHA335	TEEHA337
Ø 3,5 mm	Ø 5,0 mm	TEEHA353	TEEHA355	TEEHA357
Ø 3,5 mm	Ø 6,5 mm	TEEHA363	TEEHA365	TEEHA367
Ø 4,5 mm	Ø 4,5 mm	TEEHA443	TEEHA445	TEEHA447
Ø 4,5 mm	Ø 5,5 mm	TEEHA453	TEEHA455	TEEHA457
Ø 4,5 mm	Ø 6,5 mm	TEEHA463	TEEHA465	TEEHA467
Ø 4,5 mm	Ø 7,5 mm	TEEHA473	TEEHA475	TEEHA477

*Ne sont pas disponibles sur tous les marchés.

Piliers de cicatrisation

Plate-forme implantaire	Profil d'émergence	Hauteur transgingivale		
		1,5 mm	3,0 mm	4,5 mm
NP (Ø 2,9 mm)	Ø 3,7 mm	CHCNP31	CHCNP33	CHCNP34
NP (Ø 2,9 mm)	Ø 4,5 mm	CHCNP41	CHCNP43	CHCNP44

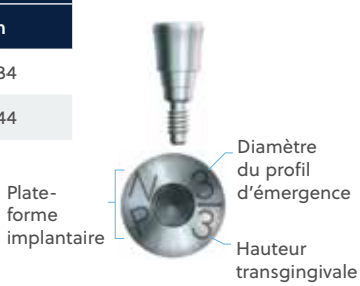

Plate-forme implantaire	Profil d'émergence	Hauteur transgingivale		
		3,0 mm	5,0 mm	7,0 mm
Ø 3,5 mm	Ø 3,5 mm (sans évasement)	HC333	HC335	—
Ø 3,5 mm	Ø 4,5 mm	HC343	HC345	HC347
Ø 3,5 mm	Ø 5,5 mm	HC353	HC355	—
Ø 4,5 mm	Ø 4,5 mm (sans évasement)	HC443	HC445	—
Ø 4,5 mm	Ø 5,5 mm	HC453	HC455	HC457
Ø 4,5 mm	Ø 6,5 mm	HC463	HC465	—

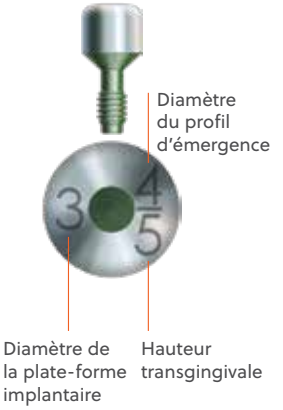

Prothèses

Prise d'empreinte

Porte-implant/transferts

Non inclus avec l'implant TSX. Avec vis de fixation (URS2). Peut être utilisé comme pilier provisoire modifiable.

Plate-forme implantaire	Profil d'émergence	Référence
Ø 3,5 mm	Ø 4,5 mm	FMT3
Ø 4,5 mm	Ø 5,5 mm	FMT4
Vis de fixation de remplacement	—	URS2

Prises d'empreinte indirectes « pop-in » (Procédure avec porte-empreinte fermé)

Code couleur par plate-forme d'implant. Avec vis de fixation (CASLT).

Plate-forme implantaire	Profil d'émergence	Hauteur transgingivale		
		1,5 mm	3,0 mm	4,5 mm
NP (Ø 2,9 mm)	Ø 3,7 mm	CITNP31	CITNP33	CITNP34
NP (Ø 2,9 mm)	Ø 4,5 mm	CITNP41	CITNP43	CITNP44
Vis de fixation de remplacement		CASLT	CASLT	CASLT

Code couleur par plate-forme d'implant. Avec vis de fixation (HLTS2).

Plate-forme implantaire	Profil d'émergence			
	Ø 3,5 mm	Ø 4,5 mm	Ø 5,5 mm	Ø 6,5 mm
Ø 3,5 mm	HLT3/3	HLT3/4	HLT3/5	—
Ø 4,5 mm	—	HLT4/4	HLT4/5	HLT4/6
Vis d'extension 3,0 mm pour prise d'empreinte indirecte « pop-in »	HLTE	HLTE	HLTE	HLTE
Vis de fixation de remplacement	HLTS2	HLTS2	HLTS2	HLTS2

Prises d'empreintes directes « pick-up » (Procédure avec porte-empreinte ouvert)

Code couleur par plate-forme d'implant. Avec vis de fixation (CASLC).

Plate-forme implaantaire	Profil d'émergence	Hauteur transgingivale		
		1,5 mm	3,0 mm	4,5 mm
NP (Ø 2,9 mm)	Ø 3,7 mm	CDTNP31	CDTNP33	CDTNP34
NP (Ø 2,9 mm)	Ø 4,5 mm	CDTNP41	CDTNP43	CDTNP44
Vis de fixation de remplacement		CASLC	CASLC	CASLC

Code couleur par plate-forme d'implant. Avec vis de fixation (DHTS).

Plate-forme implantaire	Profil d'émergence			
	Ø 3,5 mm	Ø 4,5 mm	Ø 5,5 mm	Ø 6,5 mm
Ø 3,5 mm	DHT3/3	DHT3/4	DHT3/5	—
Ø 4,5 mm	—	DHT4/4	DHT4/5	DHT4/6
Vis de fixation de remplacement	DHTS	DHTS	DHTS	DHTS

Analogues d'implant en titane pour modèle en plâtre

Code couleur par plate-forme d'implant.

Plate-forme implantaire	Référence
NP (Ø 2,9 mm)	CIANP
Ø 3,5 mm	IA3
Ø 4,5 mm	IA4

Prothèses provisoires

Piliers provisoires en titane

Avec vis de fixation (CUAS) et vis longue de façonnage (CASLC).

Plate-forme implantaire	Profil d'émergence	Référence
NP (Ø 2,9 mm)	Ø 3,5 mm	CTANP31
Vis de fixation de remplacement		CUAS
Vis longue de façonnage pour remplacement		CASLC

Piliers provisoires en PEEK, droits

Avec vis de fixation et vis longue de façonnage (DHTS2).

Plate-forme implantaire	Profil d'émergence	Hauteur transgingivale	
		1,0 mm	4,0 mm
Ø 3,5 mm	Ø 4,5 mm	PT341S	PT344S
Ø 4,5 mm	Ø 5,5 mm	PT451S	PT454S
Vis de fixation de remplacement, longue		DHTS2	DHTS2

Piliers provisoires en PEEK, angulés à 17°

Avec vis de fixation et vis longue de façonnage (DHTS2).

Plate-forme implantaire	Profil d'émergence	Hauteur transgingivale	
		1,0 mm	4,0 mm
Ø 3,5 mm	Ø 4,5 mm	PT341A	PT344A
Ø 4,5 mm	Ø 5,5 mm	PT451A	PT454A
Vis de fixation de remplacement, longue		DHTS2	DHTS2

Prothèses numériques

Piliers personnalisés

Disponibles en titane.

Conception assistée par ordinateur et précision CFAO avec usinage personnalisé.
Contacter un représentant de ZimVie pour obtenir des informations supplémentaires.

REMARQUE : les piliers personnalisés ne sont disponibles que sur certains marchés.

Instruments et accessoires

Description	Référence	
Clé dynamométrique prothétique Couple réglable de 10 Ncm à 35 Ncm	TWR	
Clé dynamométrique prothétique (inclut un adaptateur pour mandrins contre-angle C9980)	L-TIRW	
Adaptateur pour clé dynamométrique L-TIRW - Compatible avec les tournevis mandrins ISO 1797	C9980	
Clé à cliquet rétentive GemLock® pour une utilisation prothétique avec HX1.25, HXL1.25 et SRT	RSR	

Prothèses scellées

Code couleur : profil d'émergence sur piliers/composants prothétiques Hex-Lock®

Contour et courts

Les couleurs correspondent au profil d'émergence du pilier Hex-Lock Contour et courts et aux composants prothétiques Contour et courts correspondants.

Profil d'émergence de pilier*	Code couleur
Ø 4,5 mm	Beige
Ø 5,5 mm	Rose

*Pour composants prothétiques Hex-Lock Contour et courts.

Piliers Hex-Lock Contour, droits

Avec vis de fixation (CUAS).

Plate-forme implantaire	Profil d'émergence	Hauteur transgingivale		
		1,5 mm	3,0 mm	4,5 mm
NP (Ø 2,9 mm)	Ø 3,7 mm*	CANP31S	CANP33S	CANP34S
NP (Ø 2,9 mm)	Ø 4,5 mm*	CANP41S	CANP43S	CANP44S
Vis de fixation de remplacement		CUAS	CUAS	CUAS

*Les composants Contour avec profil d'émergence Ø 3,7 mm ne sont pas compatibles avec les composants de restauration Contour Ø 3,5 mm.

Avec vis de fixation (MHLAS).

Plate-forme implantaire	Profil d'émergence	Hauteur transgingivale		
		1,0 mm	2,0 mm	3,0 mm
Ø 3,5 mm	Ø 4,5 mm	ZOA341S	ZOA342S	ZOA343S
Ø 4,5 mm	Ø 4,5 mm	ZOA441S	ZOA442S	ZOA443S
Ø 4,5 mm	Ø 5,5 mm	ZOA451S	ZOA452S	ZOA453S
Vis de fixation de remplacement		MHLAS	MHLAS	MHLAS

Piliers Hex-Lock Contour angulés à 17°

Avec vis de fixation (CUASA ou CUAS).

Plate-forme implantaire	Profil d'émergence	Hauteur transgingivale	
		1,5 mm	3,0 mm
NP (Ø 2,9 mm)	Ø 3,7 mm*	CANP31A	CANP33A
NP (Ø 2,9 mm)	Ø 4,5 mm**	CANP41A	CANP43A
Vis de fixation de remplacement		CUASA	CUAS

Avec vis de fixation (AH20S).

Plate-forme implantaire	Profil d'émergence	Hauteur transgingivale	
		1,0 mm	2,0 mm
Ø 3,5 mm	Ø 4,5 mm	ZOA341A	ZOA342A
Ø 4,5 mm	Ø 4,5 mm	ZOA441A	ZOA442A
Ø 4,5 mm	Ø 5,5 mm	ZOA451A	ZOA452A
Vis de fixation de remplacement		AH20S	AH20S

Piliers d'essayage Contour et kit d'essayage complet

Plate-forme implantaire	Profil d'émergence	Description	Référence
Ø 3,5 mm	Ø 4,5 mm	Kit de 5 piliers : diverses angulations et hauteurs transgingivales	ZOAT34
Ø 4,5 mm	Ø 5,5 mm	Kit de 5 piliers : diverses angulations et hauteurs transgingivales	ZOAT45
Tous	Tous	3 kits de 5 piliers : toutes les tailles	ZOATKIT

Chapes provisoires Contour

Profil d'émergence	Droit	17°
Ø 4,5 mm	ZCPROV4S	ZCPROV4A
Ø 5,5 mm	ZCPROV5S	ZCPROV5A

Coiffes d'empreinte Contour

Profil d'émergence	Droit	17°
Ø 4,5 mm	ZOCIMP4S	ZOCIMP4A
Ø 5,5 mm	ZOCIMP5S	ZOCIMP5A

Analogues de pilier Contour, titane

Profil d'émergence	Droit	Angulé
Ø 4,5 mm	TCANA4S	TCANA4A
Ø 5,5 mm	TCANA5S	TCANA5A

Chape calcinable Contour

Profil d'émergence	Droit	17°
Ø 4,5 mm	ZOCWAX4S	ZOCWAX4A
Ø 5,5 mm	ZOCWAX5S	ZOCWAX5A

Piliers Hex-Lock Contour courts

Avec vis de fixation (MHLAS).

Plate-forme implantaire	Profil d'émergence	Hauteur transgingivale	
		1,0 mm	2,0 mm
Ø 3,5 mm	Ø 4,5 mm	SA341	SA342
Ø 4,5 mm	Ø 5,5 mm	SA451	SA452
Vis de fixation de remplacement		MHLAS	MHLAS

Chapes provisoires courtes

Profil d'émergence	Référence
Ø 4,5 mm	SAPROVP4
Ø 5,5 mm	SAPROVP5

Coiffes d'empreinte courtes

Profil d'émergence	Référence
Ø 4,5 mm	SAIMP4
Ø 5,5 mm	SAIMP5

Analogues de pilier courts, titane

Profil d'émergence	Référence
Ø 4,5 mm	SAANA4
Ø 5,5 mm	SAANA5

Chapes calcinables courtes

Profil d'émergence	Référence
Ø 4,5 mm	SAWAX4
Ø 5,5 mm	SAWAX5

Piliers Hex-Lock

Avec vis de fixation (MHLAS).

Plate-forme implantaire	Profil d'émergence			
	Ø 3,5 mm	Ø 4,5 mm	Ø 5,5 mm	Ø 6,5 mm
Ø 3,5 mm	HLA3/3	HLA3/4	HLA3/5	—
Ø 4,5 mm	—	HLA4/4	HLA4/5	HLA4/6
Vis de fixation de remplacement, courte	MHLAS	MHLAS	MHLAS	MHLAS
Vis de fixation de remplacement, longue	HLTS2	HLTS2	HLTS2	HLTS2

Piliers angulés à 20°

Avec vis de fixation (CUAS).

Plate-forme implantaire	Profil d'émergence	Référence
NP (Ø 2,9 mm)	Ø 3,5 mm	C20A3
Vis de fixation de remplacement		CUAS

Avec vis de fixation (AH2OS).

Plate-forme implantaire	Profil d'émergence	Référence
Ø 3,5 mm	Ø 4,5 mm	AH20/4
Ø 4,5 mm	Ø 5,5 mm	AH20W/5
Vis de fixation de remplacement	—	AH20S

Prothèses façonnable en or « à surcouler »

Piliers avec engagement en or « à surcouler »

Avec vis de fixation (CUAS).

Plate-forme implantaire	Profil d'émergence	Référence
NP (Ø 2,9 mm)	Ø 3,5 mm	CEANP31
Vis de fixation de remplacement		CUAS
Vis longue de façonnage		CASLC

Avec vis de fixation (MHLAS)

Plate-forme implantaire	Référence
Ø 3,5 mm	HLA3G
Ø 4,5 mm	HLA4G
Vis de fixation de remplacement	MHLAS
Vis de laboratoire pour piliers « à surcouler »	MTWSD

Piliers en or « à surcouler » sans engagement

Avec vis de fixation (MHLAS)

Plate-forme implantaire	Référence
Ø 3,5 mm	NEA3G
Ø 4,5 mm	NEA4G
Vis de fixation de remplacement	MHLAS

Prothèses vissées

Piliers Multi-Unit universels droits

Pilier sans engagement, ne s'engage pas dans la connexion hexagonale interne. Ne pas utiliser pour les prothèses unitaires. Coiffe de cicatrisation (UMUA-HCS) vendue séparément.

Plateforme implantaire	Hauteur du col				
	1,0 mm	2,0 mm	3,0 mm	4,0 mm	5,0 mm
NP (Ø 2,9 mm)	UMUA-NP291S	UMUA-NP292S	UMUA-NP293S	UMUA-NP294S	UMUA-NP295S
Ø 3,5 mm	UMUA-TSV351S	UMUA-TSV352S	UMUA-TSV353S	UMUA-TSV354S	UMUA-TSV355S
Ø 4,5 mm	UMUA-TSV451S	UMUA-TSV452S	UMUA-TSV453S	UMUA-TSV454S	UMUA-TSV455S

Piliers Multi-Unit universels angulés, 17°

Les piliers engagent la connexion hexagonale interne. Ne pas utiliser pour les prothèses unitaires (vis de fixation incluse).

Plateforme implantaire	Hauteur du col	
	2,5 mm	3,5 mm
NP (Ø 2,9 mm)	UMUA-NP2925-17S	UMUA-NP2935-17S
Ø 3,5 mm	UMUA-TSV3525-17S	UMUA-TSV3535-17S
Ø 4,5 mm	UMUA-TSV4525-17S	UMUA-TSV4535-17S

Piliers Multi-Unit universels angulés, 30°

Les piliers engagent la connexion hexagonale interne. Ne pas utiliser pour les prothèses unitaires (vis de fixation incluse).

Plateforme implantaire	Hauteur du col	
	3,5 mm	4,5 mm
NP (Ø 2,9 mm)	UMUA-NP2935-30S	UMUA-NP2945-30S
Ø 3,5 mm	UMUA-TSV3535-30S	UMUA-TSV3545-30S
Ø 4,5 mm	UMUA-TSV4535-30S	UMUA-TSV4545-30S

Coiffe de cicatrisation de pilier Multi-Unit universel

Spires pour coiffe de cicatrisation sur pilier Multi-Unit universel et pilier Multi-Unit angulé.

Désignation	Référence
Coiffe de cicatrisation de pilier Multi-Unit universel	UMUA-HCS

Transfert d'empreinte pour pilier Multi-Unit universel

Spires de transfert d'empreinte sur le pilier Multi-Unit universel et le pilier Multi-Unit angulé pour la prise d'empreinte. Cette méthode transfère la position du pilier.

Désignation	Hauteur	Référence
Transfert d'empreinte pour pilier Multi-Unit universel, porte-empreinte ouvert Vis de transfert incluses	12 mm	UMUA-OTIC
Transfert d'empreinte pour pilier Multi-Unit universel, porte-empreinte fermé	5 mm	UMUA-CTICS
Transfert d'empreinte pour pilier Multi-Unit universel, porte-empreinte fermé (Qté 4)	5 mm	UMUA-CTICS4
Transfert d'empreinte pour pilier Multi-Unit universel, porte-empreinte fermé	8 mm	UMUA-CTICL
Transfert d'empreinte pour pilier Multi-Unit universel, porte-empreinte fermé (Qté 4)	8 mm	UMUA-CTICL4

Scanbodies sur pilier Multi-Unit universel

Spires pour scanbody sur pilier Multi-Unit universel et pilier Multi-Unit angulé.

Désignation	Référence
Scanbody sur pilier Multi-Unit universel, intraoral	UMUA-SBIO
Scanbody sur pilier Multi-Unit universel, Ti-Base (Qté 5)	UMUA-SBTB5
Scanbody sur pilier Multi-Unit universel, de laboratoire Vis Multi-Unit incluses (UMUA-S)	UMUA-SBDT

Ti-Base sur pilier Multi-Unit universel

Spires pour Ti-Base sur pilier Multi-Unit universel et pilier Multi-Unit angulé.

Désignation	Hauteur	Référence
Ti-Base sur pilier Multi-Unit universel Vis Multi-Unit incluses (UMUA-S)	6 mm	UMUA-TTS
Ti-Base sur pilier Multi-Unit universel Vis Multi-Unit incluses (UMUA-S)	8 mm	UMUA-TTL

Ti-Base à canal de vis désaxé sur pilier Multi-Unit universel

Désignation	Référence
Ti-Base à canal de vis désaxé sur pilier Multi-Unit universel Inclut vis pour canal de vis désaxé (UMUA-ASCTS)	UMUA-ASCT

Analogue de pilier Multi-Unit universel pour modèle en plâtre

Désignation	Référence
Analogue de pilier Multi-Unit universel	UMUA-A

Analogue numérique de pilier Multi-Unit universel

Désignation	Référence
Analogue numérique de pilier Multi-Unit universel Vis Multi-Unit incluses (UMUA-S)	UMUA-DA

Vis de remplacement pour composants Multi-unit universels

Désignation	Référence
Vis pour Multi-Unit universel	UMUA-S
Vis pour canal de vis désaxé universel	UMUA-ASCTS

Cylindre provisoire de pilier Multi-Unit universel

Spires pour cylindre provisoire sur pilier Multi-Unit universel et pilier Multi-Unit angulé.

Désignation	Référence
Cylindre provisoire de pilier Multi-Unit universel Vis Multi-Unit incluses (UMUA-S)	UMUA-TCS

Attachement pour pilier Multi-unit universel OverdenSURE®

Désignation	Référence
Attachement pour pilier Multi-Unit universel OverdenSURE	UMUA-ODS

Stabilisation de prothèses amovibles

Système d'attachement amovible OverdenSURE

Hauteur transgingivale	Plate-forme implantaire		
	NP (Ø 2,9 mm)	Ø 3,5 mm	Ø 4,5 mm
1,0 mm	ODS-NP201	ODS-TSV301	ODS-TSV401
2,0 mm	ODS-NP202	ODS-TSV302	ODS-TSV402
3,0 mm	ODS-NP203	ODS-TSV303	ODS-TSV403
4,0 mm	ODS-NP204	ODS-TSV304	ODS-TSV404
5,0 mm	ODS-NP205	ODS-TSV305	ODS-TSV405
6,0 mm	ODS-NP206	ODS-TSV306	ODS-TSV406

Kit de rétention ODS-RIKIT2001 inclus. Disponible dans toutes les zones géographiques actives, à l'exception des États-Unis.

Instruments et accessoires OverdenSURE

Transfert d'empreinte, qté 1	ODS-IC01
Transfert d'empreinte, qté 4	ODS-IC04
Transfert d'empreinte, qté 10	ODS-IC010
Analogue, qté 1	ODS-AA01
Analogue, qté 4	ODS-AA04
Analogue, qté 10	ODS-AA010
Kit de rétention 20°, qté 1 jeu	ODS-RIKIT2001
Kit de rétention 20°, qté 2 jeux	ODS-RIKIT2002
Kit de rétention 40°, qté 1 jeu	ODS-RIKIT4001
Kit de rétention 40°, qté 2 jeux	ODS-RIKIT4002
Nylon de rétention bleu 20°, qté 4	ODS-RIB2004
Nylon de rétention rose 20°, qté 4	ODS-RIP2004
Nylon de rétention transparent 20°, qté 4	ODS-RIC2004

Nylon de rétention rouge 40°, qté 4	ODS-RIR4004
Nylon de rétention jaune 40°, qté 4	ODS-RIY4004
Nylon de rétention vert 40°, qté 4	ODS-RIG4004
Coiffe métallique de rétention, qté 1	ODS-RH01
Coiffe métallique de rétention, qté 4	ODS-RH04
Coiffe de rétention, qté 10	ODS-RH010
Anneau espaceur, qté 20	ODS-BS020
Insert de pose OverdenSURE pour clé dynamométrique réf. TWR	ODS-DRVR
Instrument multifonction pour nylons de rétention	ODS-IRTOOL
Pilier OverdenSURE pour barre, qté 1	ODS-BARATT01
Pilier OverdenSURE pour barre, qté 2	ODS-BARATT02
Pilier OverdenSURE pour barre, qté 4	ODS-BARATT04
Scanbody, qté 10	ODS-SB010

Attachements boule

Les piliers n'engagent pas la connexion interne hexagonale. Inclut un capuchon métallique et un nylon rétentif.

Plate-forme implantaire	Hauteur transgingivale		
	2,0 mm	4,0 mm	6,0 mm
NP (Ø 2,9 mm)	CBANP2	CBANP4	CBANP6
Ø 3,5 mm	BAC2	BAC4	BAC6
Ø 4,5 mm	BACW2	BACW4	BACW6

Composants pour empreinte sur attachements boule

Description	Référence
Transfert d'empreinte pour attachement boule (lot de 2)	BAT
Analogue d'attachement boule	BAR

Composants prothétiques pour attachement boule

Description	Référence
Capuchon métallique (CAH)/Nylon de rétention (CAN)	CA
Capuchon métallique	CAH
Nylon de rétention, transparent	CAN
Nylon de rétention, gris (rétention forte)	CAN-G
Transfert de coiffe pour attachement	CAT
Attachements boules calcinables (2 boules par maquette)	CAB
Nylon de rétention pour micro-boule	CANM

Instruments prothétiques

Clés dynamométriques et clés à cliquets

Description	Référence	
Clé dynamométrique prothétique Couple réglable de 10 Ncm à 35 Ncm	TWR	
Clé dynamométrique prothétique (inclut un adaptateur pour mandrins contre-angle C9980)	L-TIRW	
Adaptateur pour clé dynamométrique L-TIRW - Compatible avec les tournevis mandrins ISO 1797	C9980	
Clé à cliquet rétentive GemLock, pour une utilisation prothétique avec HX1.25, HXL1.25 et SRT	RSR	

REMARQUE : ne pas serrer les vis chirurgicales et prothétiques au-delà du couple recommandé indiqué dans le manuel technique et/ou la notice.

Tournevis hexagonaux Ø 1,25 mm pour vis chirurgicales et prothétiques

Description	Mode d'utilisation	Référence	
Tournevis manuel hexagonal court avec rétention GemLock, Ø 1,25 mm, L 22 mm	Manuel	HXGR1.25	
Tournevis manuel hexagonal long avec rétention GemLock, Ø 1,25 mm, L 30 mm	Manuel	HXLGR1.25	
Tournevis à tête hexagonale pour contre-angle compatible avec les vis chirurgicales et prothétiques, court, Ø 1,25 mm, L 23 mm (peut nécessiter un contre-angle réducteur)	Contre-angle, L-TIRW	HX1.25D	
Tournevis à tête hexagonale pour contre-angle compatible avec les vis chirurgicales et prothétiques, long, Ø 1,25 mm, L 26 mm (peut nécessiter un contre-angle réducteur)	Contre-angle, L-TIRW	HXL1.25D	
Insert hexagonal court pour clé dynamométrique, Ø 1,25 mm, L 17 mm	TWR	TW1.25	
Insert hexagonal long pour clé dynamométrique, Ø 1,25 mm, L 22 mm	TWR	TW1.25L	
Tournevis hexagonal court standard pour clé à cliquet, Ø 1,25 mm, L 17 mm	RSR	HX1.25	
Tournevis hexagonal long standard pour clé à cliquet, Ø 1,25 mm, L 22 mm	RSR	HXL1.25	

Extracteurs

Description	Mode d'utilisation	Référence	
Extracteur de piliers NP pour implants TSX 3,1 mm (plate-forme Ø 2,9 mm)	Manuel ou RSR	CLRT2	
Extracteur de pilier TSV-Trabecular Metal-TSX (excepté la plate-forme 2,9 mm) Inclus dans les trousses chirurgicales TSVKITG et STRKITG	Manuel ou RSR	TLRT2	
Extracteur de vis de pilier ou vis de fixation avec hexagone Ø 1,25 mm, acier carbure Remarque : ne pas stériliser à l'autoclave (stérilisation à froid uniquement)	RSR	SRT	

Instruments et accessoires prothétiques additionnels

Description	Référence	
Kit prothétique, autoclavable, vide	2320	
Porte-analogue / Porte-pilier Nécessite un analogue d'implant pour fixer les piliers	ABTH	

Tableau du contenu du système de trousse de chirurgie modulaire TSX

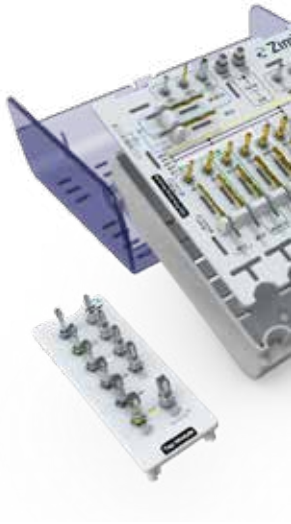

1

1203G
Ø 2,0 mm
Fraise boule

2

0201G
Ø 2,1/1,6 mm
Foret pilote conique,
L 8,0 mm - 11,5 mm

3

DEG
Prolongateur
de foret

4

CLRT2
Extracteur de
piliers NP

5

TLRT2
Extracteur de
piliers d'implants à
hexagone interne

6

PPAR
Jauge de
parallélisme
(4 pièces)

7

EZT28D24G
Foret étagé
Ø 2,8/2,4 mm,
L 22 mm

8

EZT24G
Foret Ø 2,4 mm,
L 22 mm

9

TSV23SG
Foret Ø 2,3 mm,
L 16 mm

10

TSV28SG
Foret Ø 2,8 mm,
L 16 mm

11

TSV34D28SG
Foret étagé
Ø 3,4/2,8 mm,
L 16 mm

12

TSV34SG
Foret Ø 3,4 mm,
L 16 mm

13

TSV38D34SG
Foret étagé
Ø 3,8/3,4 mm,
L 16 mm

14

TSV38SG
Foret Ø 3,8 mm,
L 16 mm

15

TSV44D38SG
Foret étagé
Ø 4,4/3,8 mm,
L 16 mm

16

TSV44SG
Foret Ø 4,4 mm,
L 16 mm

Module de foret (inclus dans le TSXKIT)

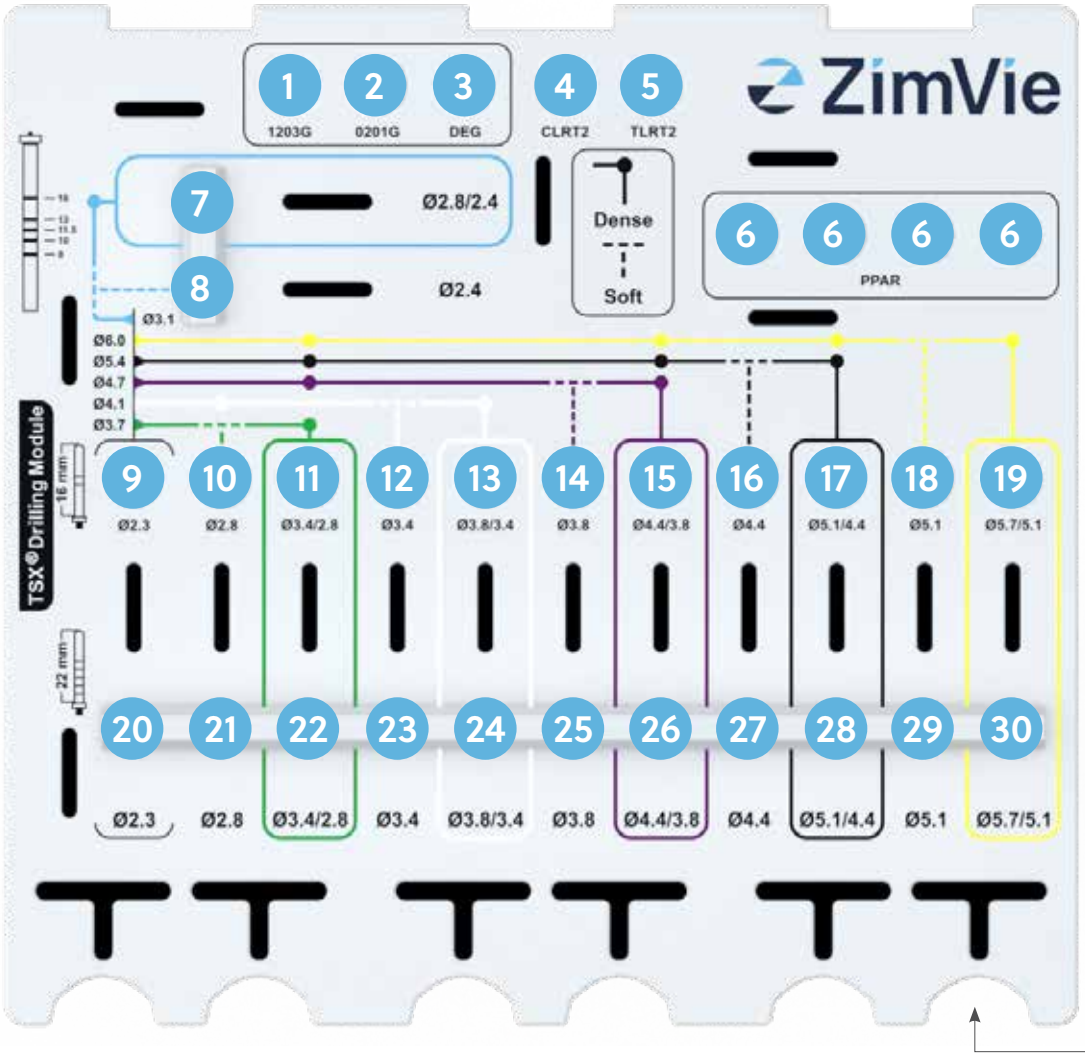

Fentes de préparation de l'implant

20

TSV23G
Foret Ø 2,3 mm,
L 22 mm

24

TSV38D34G
Foret étagé
Ø 3,8/3,4 mm,
L 22 mm

28

TSV51D44G
Foret étagé
Ø 5,1/4,4 mm,
L 22 mm

17

TSV51D44SG
TSV51D44SG Foret étagé Ø 5,1/4,4 mm, L 16 mm

18

TSV51SG
Foret Ø 5,1 mm, L 16 mm

19

TSV57D51SG
Foret étagé Ø 5,7/5,1 mm, L 16 mm

21

TSV28G
Foret Ø 2,8 mm, L 22 mm

22

TSV34D28G
Foret étagé Ø 3,4/2,8 mm, L 22 mm

23

TSV34G
Foret Ø 3,4 mm, L 22 mm

25

TSV38G
Foret Ø 3,8 mm, L 22 mm

26

TSV44D38G
Foret étagé Ø 4,4/3,8 mm, L 22 mm

27

TSV44G
Foret Ø 4,4 mm, L 22 mm

29

TSV51G
Foret Ø 5,1 mm, L 22 mm

30

TSV57D51G
Foret étagé Ø 5,7/5,1 mm, L 22 mm

Module d'instrumentation
(inclus dans le TSXKIT)

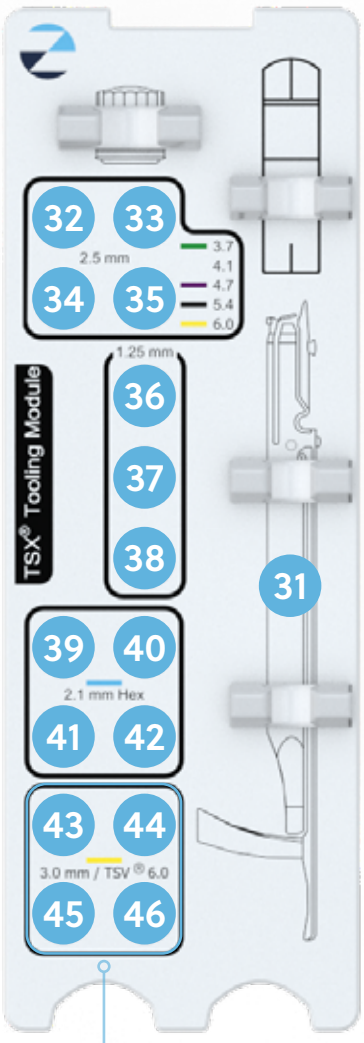

Tournevis hexagonaux de 3,0 mm utilisés avec l'implant TSV de 6,0 mm lorsque le porte-implant est retiré
(Achetés séparément)

31

ZTIRW
Clé dynamométrique chirurgicale à couple élevé (0-90 Ncm)

32

GHX2.5D
Tournevis hexagonal GemLock® de 2,5 mm pour contre-angle, court

33

GHX2.5DL
Tournevis hexagonal GemLock de 2,5 mm pour contre-angle, long

34

GHX2.5
Tournevis hexagonal GemLock de 2,5 mm, court

35

GHX2.5L
Tournevis hexagonal GemLock de 2,5 mm, long

36

HX1.25D
Tournevis hexagonal de 1,25 mm pour contre-angle, court

37

HXLGR1.25
Tournevis hexagonal GemLock de 1,25 mm, long

38

HXGR1.25
Tournevis hexagonal GemLock de 1,25 mm, court

39

CHD2.1
Tournevis hexagonal GemLock de 2,1 mm pour contre-angle, court

40

CHDL2.1
Tournevis hexagonal GemLock de 2,1 mm pour contre-angle, long

41

CHR2.1
Insert de pose hexagonal GemLock de 2,1 mm, court

42

CHRL2.1
Insert de pose hexagonal GemLock de 2,1 mm, long

43

RHX3.0DS
Tournevis hexagonal, pour contre-angle, Ø 3,0 mm, L 21 mm
(Achetés séparément)

44

RHX3.0DL
Tournevis hexagonal, pour contre-angle, Ø 3,0 mm, L 25 mm
(Achetés séparément)

45

RHX3.0RS
Tournevis hexagonal, clé à cliquet, Ø 3,0 mm, L 17 mm
(Achetés séparément)

46

RHX3.0RM
Tournevis hexagonal, clé à cliquet, Ø 3,0 mm, L 22 mm
(Achetés séparément)

Module de tarauds **(TAPMOD)**

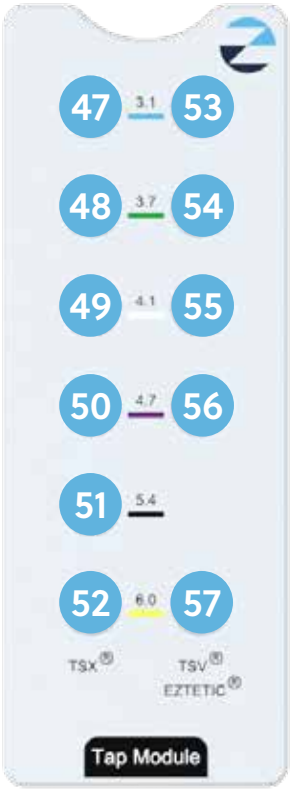

47

TSXTAP31
Ø 3,1 mm
Taraud
chirurgical TSX

48

TSXTAP37
Ø 3,7 mm
Taraud
chirurgical TSX

49

TSXTAP41
Ø 4,1 mm
Taraud
chirurgical TSX

50

TSXTAP47
Ø 4,7 mm
Taraud
chirurgical TSX

51

TSXTAP54
Ø 5,4 mm
Taraud
chirurgical TSX

52

TSXTAP60
Ø 6,0 mm
Taraud
chirurgical TSX

53

ZOPTT30
Ø 3,0 mm
Taraud
chirurgical
Eztetic

54

TT3.7
Ø 3,7 mm
Taraud
chirurgical TSV

55

TT4.1
Ø 4,1 mm
Taraud
chirurgical TSV

56

TT4.7
Ø 4,7 mm
Taraud
chirurgical TSV

57

TT6.0
Ø 6,0 mm
Taraud
chirurgical TSV

Module de restauration d'arcade complète **(TSXRESTOR)**

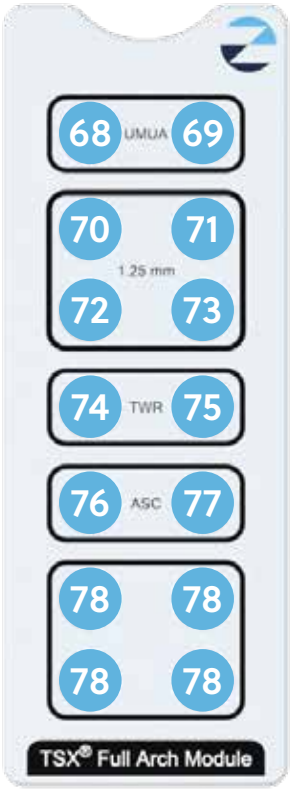

68

UMUA-D
Tournevis pour
Multi-Unit
Universel

69

ISO4X4A
Tournevis pour
contre-angle 4x4

70

HXGR1.25
Tournevis
hexagonal
GemLock de
1,25 mm, court

71

HXLGR1.25
Tournevis
hexagonal
GemLock de
1,25 mm, long

72

HX1.25D
1,25 mm
Tournevis
hexagonal, pour
contre-angle,
court

73

HXL1.25D
1,25 mm
Tournevis
hexagonal, pour
contre-angle,
long

74

TW1.25
1,25 mm
Tournevis
hexagonal
pour clé
dynamométrique,
court

75

TW1.25L
1,25 mm
Tournevis
hexagonal
pour clé
dynamométrique,
long

76

ASC-SD24
Tournevis
mandrin
pour canal
de vis désaxé
24 mm (L)

77

ASC-SD30
Tournevis
mandrin
pour canal
de vis désaxé
30 mm (L)

78

Rondelle vide

Module de profileurs d'os **(TSXBPRO)**

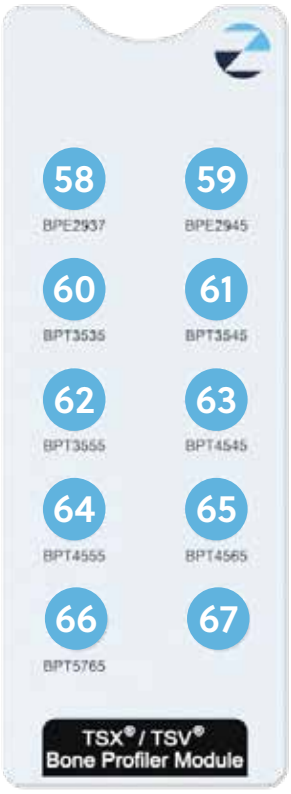

58

BPE2937
Profileur d'os
NP Ø 2,9 mm X
3,7 mm (P)

59

BPE2945
Profileur d'os
NP Ø 2,9 mm X
4,5 mm (P)

60

BPT3535
Profileur d'os
Ø 3,5 mm X
3,5 mm (P)

61

BPT3545
Profileur d'os
Ø 3,5 mm X
4,5 mm (P)

62

BPT3555
Profileur d'os
Ø 3,5 mm X
5,5 mm (P)

63

BPT4545
Profileur d'os
Ø 4,5 mm X
4,5 mm (P)

64

BPT4555
Profileur d'os
Ø 4,5 mm X
5,5 mm (P)

65

BPT4565
Profileur d'os
Ø 4,5 mm X
6,5 mm (P)

66

BPT5765
Profileur d'os
Ø 5,7 mm X
6,5 mm (P)

67

Rondelle vide

81

UNPMODTRAY
Plateau modulaire, vide, maintient solidement les instruments de verrouillage pour contre-angle
(Achetés séparément)

Module de clé dynamométrique prothétique **(TSXRESTORTW)**

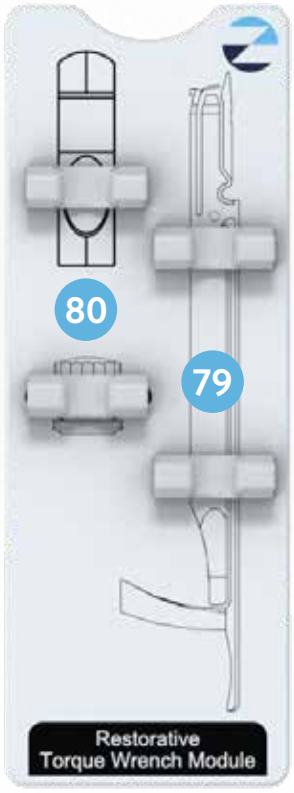

79

L-TIRW
Clé dynamométrique à faible couple (avec adaptateur à contre-angle C9980)

80

TWR*
Clé dynamométrique, prothétique

*** REMARQUE :** Le TWR est inclus dans le module rempli de TSXRESTORTW et peut être rangé en option dans deux supports en silicone de gauche numérotés 80. Suivre les instructions de stérilisation du fabricant pour le TWR.

Système de trousse de chirurgie modulaire TSX pour implants TSX

Références pour passer commande

		TSXKIT | Trousse chirurgicale TSX	
		TSXSTRKIT | Trousse chirurgicale de démarrage TSX	
Désignation	**Référence**		
Plateau chirurgical TSX pour module de forets et d'instruments, avec couvercle et base (vide)	TSXTRAY	•	•
Fraise boule Ø 2,0 mm	1203G		•
Foret pilote conique Ø 2,1/1,6 mm, L 8,0 mm - 11,5 mm	0201G	•	•
Prolongateur de foret	DEG	•	•
Extracteur de piliers NP	CLRT2		•
Extracteur de piliers d'implants à hexagone interne	TLRT2	•	•
Jauge de parallélisme (lot de 4)	PPAR	•	•
Foret étagé Ø 2,8/2,4 mm, L 22 mm	EZT28D24G		•
Foret Ø 2,4 mm, L 22 mm	EZT24G		•
Foret Ø 2,3 mm, L 16 mm	TSV23SG	•	•
Foret Ø 2,8 mm, L 16 mm	TSV28SG	•	•
Foret étagé Ø 3,4/2,8 mm, L 16 mm	TSV34D28SG	•	•
Foret Ø 3,4 mm, L 16 mm	TSV34SG	•	•
Foret étagé Ø 3,8/3,4 mm, L 16 mm	TSV38D34SG	•	•
Foret Ø 3,8 mm, L 16 mm	TSV38SG	•	•
Foret étagé Ø 4,4/3,8 mm, L 16 mm	TSV44D38SG	•	•
Foret Ø 4,4 mm, L 16 mm	TSV44SG		•
Foret étagé Ø 5,1/4,4 mm, L 16 mm	TSV51D44SG		•
Foret Ø 5,5 mm, L 16 mm	TSV51SG		•
Foret étagé Ø 5,7/5,1 mm, L 16 mm	TSV57D51SG		•
Foret Ø 2,3 mm, L 22 mm	TSV23G	•	•
Foret Ø 2,8 mm, L 22 mm	TSV28G	•	•
FORET ÉTAGÉ Ø 3,4/2,8 MM, L 22 MM	TSV34D28G	•	•
FORET Ø 3,4 mm, L 22 mm	TSV34G	•	•
Foret étagé Ø 3,8/3,4 mm, L 22 mm	TSV38D34G	•	•
Foret Ø 3,8 mm, L 22 mm	TSV38G	•	•
Foret étagé Ø 4,4/3,8 mm, L 22 mm	TSV44D38G	•	•
Foret Ø 4,4 mm, L 22 mm	TSV44G		•
Foret étagé Ø 5,1/4,4 mm, L 22 mm	TSV51D44G		•
Foret Ø 5,1 mm, L 22 mm	TSV51G		•
Foret étagé Ø 5,7/5,1 mm, L 22 mm	TSV57D51G		•
Clé dynamométrique chirurgicale à couple élevé (0-90 Ncm)	ZTIRW	•	•
Tournevis hexagonal GemLock Ø 2,5 mm pour contre-angle, court	GHX2.5D	•	•
Tournevis hexagonal GemLock Ø 2,5 mm pour contre-angle, long	GHX2.5DL	•	•
Tournevis hexagonal manuel GemLock Ø 2,5 mm, court	GHX2.5	•	•
Tournevis hexagonal manuel GemLock Ø 2,5 mm, long	GHX2.5L	•	•
Tournevis hexagonal Ø 1,25 mm pour contre-angle, court	HX1.25D	•	•
Tournevis hexagonal GemLock Ø 1,25 mm, long	HXLGR1.25	•	•
Tournevis hexagonal GemLock Ø 1,25 mm, court	HXGR1.25	•	•
Tournevis hexagonal GemLock Ø 2,1 mm pour contre-angle, court	CHD2.1		•
Tournevis hexagonal GemLock Ø 2,1 mm pour contre-angle, long	CHDL2.1		•
Tournevis hexagonal GemLock Ø 2,1 mm, court	CHR2.1		•
Tournevis hexagonal GemLock Ø 2,1 mm, long	CHRL2.1		•

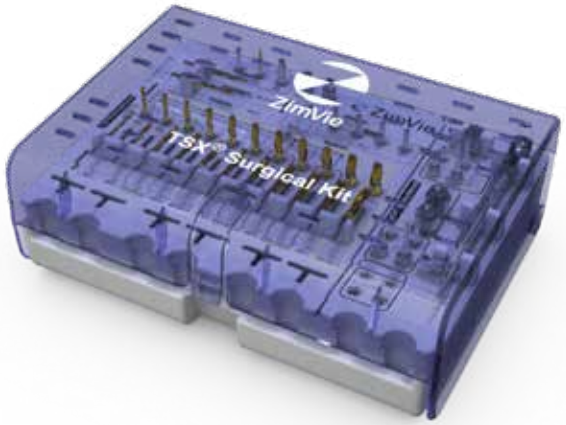

*Les inserts de pose hexagonaux Ø 3,0 mm ne sont pas utilisés avec l'implant TSX.
Le point indique que l'élément est inclus dans l'ensemble modulaire rempli.

Trousse TSX, configurations modulaires

Module de tarauds

Désignation	Référence	TAPMOD | Module de tarauds TSX	TSXTAPMOD | Module de tarauds TSX pour implants TSX	TSVTAPMOD | Module de tarauds TSX pour implants TSV et Eztetic
Plateau pour module de tarauds TSX (vide)	TAPTRAY	•	•	•
Taraud chirurgical TSX Ø 3,1 mm	TSXTAP31		•	•
Taraud chirurgical TSX Ø 3,7 mm	TSXTAP37		•	•
Taraud chirurgical TSX Ø 4,1 mm	TSXTAP41		•	•
Taraud chirurgical TSX Ø 4,7 mm	TSXTAP47		•	•
Taraud chirurgical TSX Ø 5,4 mm	TSXTAP54		•	•
Taraud chirurgical TSX Ø 6,0 mm	TSXTAP60		•	•
Taraud chirurgical Eztetic Ø 3,0 mm	ZOPTT30	•		•
Taraud chirurgical TSV Ø 3,7 mm	TT3.7	•		•
Taraud chirurgical TSV Ø 4,1 mm	TT4.1	•		•
Taraud chirurgical TSV Ø 4,7 mm	TT4.7	•		•
Taraud chirurgical TSV Ø 6,0 mm	TT6.0	•		•

Module de profileurs d'os TSX

Référence	Module / Instruments	Désignation
TSXBPRO	**Module de profileurs d'os TSX** pour implants TSX, TSV et Eztetic	Comprend un plateau de profileurs d'os [TSXBPROTRAY] et des profileurs d'os pour implants TSX, TSV et Eztetic
TSXBPROTRAY	**Module de profileurs d'os TSX**	Plateau (vide)
BPE2937	**Profileur d'os NP**	Ø 2,9 mm x 3,7 mm (P)
BPE2945	**Profileur d'os NP**	Ø 2,9 mm x 4,5 mm (P)
BPT3535	**Profileur d'os**	Ø 3,5 mm x 3,5 mm (P)
BPT3545	**Profileur d'os**	Ø 3,5 mm x 4,5 mm (P)
BPT3555	**Profileur d'os**	Ø 3,5 mm x 5,5 mm (P)
BPT4545	**Profileur d'os**	Ø 4,5 mm x 4,5 mm (P)
BPT4555	**Profileur d'os**	Ø 4,5 mm x 5,5 mm (P)
BPT4565	**Profileur d'os**	Ø 4,5 mm x 6,5 mm (P)
BPT5765	**Profileur d'os**	Ø 5,7 mm x 6,5 mm (P)

Module d'arcade complète TSX

Référence	Module / Instruments	Désignation
TSXRESTOR	**Module d'arcade complète TSX** avec instruments	Comprend un plateau pour arcade complète [TSXRESORTRAY] et des instruments pour la mise en place au fauteuil des piliers Multi-Unit universels et des Ti-Bases sur les implants TSX, TSV et Eztetic
TSXRESTORTRAY	**Module d'arcade complète TSX**	Plateau (vide)
UMUA-D	**Tournevis pour Multi-Unit Universel**	À utiliser avec la clé dynamométrique TWR pour serrer les piliers droits UMUA
ISO4X4A	**Adaptateur de tournevis à loquet ISO**	À utiliser avec la clé dynamométrique L-TIRW pour serrer les piliers UMUA
HXGR1.25	**Tournevis hexagonal GemLock**	Court, Ø 1,25 mm
HXLGR1.25	**Tournevis hexagonal GemLock**	Long, Ø 1,25 mm
HX1.25D	**Tournevis hexagonal pour contre-angle**	Court, Ø 1,25 mm
HXL1.25D	**Tournevis hexagonal pour contre-angle**	Long, Ø 1,25 mm
TW1.25	**Tournevis hexagonal pour clé dynamométrique**	Court, Ø 1,25 mm, à utiliser avec la clé dynamométrique TWR
TW1.25L	**Tournevis hexagonal pour clé dynamométrique**	Long, Ø 1,25 mm, à utiliser avec la clé dynamométrique TWR
ASC-SD24	**Tournevis mandrin pour canal de vis désaxé**	L 24 mm, serre les Ti-Bases à canal de vis désaxé
ASC-SD30	**Tournevis mandrin pour canal de vis désaxé**	L 30 mm, serre les Ti-Bases à canal de vis désaxé

Module de clés dynamométriques prothétiques TSX

Référence	Module / Instruments	Désignation
TSXRESTORTW	**Module de clés dynamométriques prothétiques TSX** avec instruments	Comprend le plateau de clés dynamométriques prothétiques [TSXRESOTRTWTRAY] et les clés dynamométriques prothétiques L-TIRW et TWR
TSXRESTORTWTRAY	**Module de clés dynamométriques prothétiques TSX**	Plateau (vide)
L-TIRW	**Clé dynamométrique à couple faible**	Comprend l'adaptateur pour contre-angle C9980, à utiliser avec les tiges de connexion pour contre-angle
TWR	**Clé dynamométrique**	À utiliser avec les tournevis TW1.25 et TW1.25L

Préférences modulaires personnelles
Références pour passer commande

Trousse chirurgicale et modules TSX

Référence	Trousse chirurgicale	Désignation
TSXKIT	**Trousse de chirurgie TSX** pour implants TSX, TSV et Eztetic	Comprend un plateau chirurgical [TSXTRAY], un module de forage et un module d'instruments, avec les instruments nécessaires pour placer les implants TSX Ø 3,1 mm, 3,7 mm, 4,1 mm, 4,7 mm, 5,4 mm et 6,0 mm, les implants TSV Ø 3,7 mm, 4,1 mm, 4,7 mm et 6,0 mm et les implants Eztetic Ø 3,1 mm
TSXSTRKIT	**Trousse de chirurgie de démarrage TSX** pour implants TSX et TSV	Comprend un plateau chirurgical [TSXTRAY], un module de forage et un module d'instruments avec instruments pour implants TSX et TSV Ø 3,7 mm, 4,1 mm et 4,7 mm
TAPMOD	**Module de tarauds TSX** pour implants TSX, TSV et Eztetic	Comprend un plateau de tarauds [TAPTRAY] et des tarauds chirurgicaux TSX, TSV et Eztetic
TSXTAPMOD	**Module de tarauds TSX** pour implants TSX	Comprend un plateau de tarauds [TAPTRAY] et des tarauds chirurgicaux TSX
TSVTAPMOD	**Module de tarauds TSX** pour implants TSV et Eztetic	Comprend un plateau de tarauds [TAPTRAY] et des tarauds chirurgicaux TSV et Eztetic
TSXBPRO	**Module de profileurs d'os TSX** pour implants TSX, TSV et Eztetic	Comprend un plateau de profileurs d'os [TSXBPROTRAY] et des profileurs d'os pour implants TSX, TSV et Eztetic
TSXRESTOR	**Module d'arcade complète TSX**	Comprend un plateau pour arcade complète [TSXRESORTRAY] et des instruments pour la mise en place au fauteuil des piliers Multi-Unit universels et des Ti-Bases sur les implants TSX, TSV et Eztetic
TSXRESTORTW	**Module de clés dynamométriques prothétiques TSX**	Comprend un plateau de clés dynamométriques prothétiques [TSXRESOTRTWTRAY] ; clés dynamométriques prothétiques L-TIRW et TWR
TSXTRAY	**Plateau chirurgical TSX**	Plateaux de modules de forage et d'instruments avec couvercle et base (vide)
TAPTRAY	**Module de tarauds TSX**	Plateau pour module de tarauds (vide)
TSXBPROTRAY	**Module de profileurs d'os TSX**	Plateau pour profileurs d'os (vide)
TSXRESTORTRAY	**Module d'arcade complète TSX**	Arcade complète (vide)
TSXRESTORTWTRAY	**Module de clés dynamométriques prothétiques TSX**	Clé dynamométrique prothétique (vide)
UNPMODTRAY	**Plateau pour module**	Plateau (vide), maintient fermement les instruments avec loquet certifié ISO

Forets chirurgicaux Dríva Gold Series

Forets pilotes chirurgicaux

Diamètre	L 15 mm*	L 16 mm*	L 19 mm	L 22 mm*	L 25 mm
Ø 2,1/1,6 mm	0201G	—	—	—	—

Forets chirurgicaux Dríva

Diamètre	L 15 mm*	L 16 mm*	L 19 mm	L 22 mm*	L 25 mm
Ø 2,3 mm	—	TSV23SG	STR23D19	TSV23G	STR23D25
Ø 2,4 mm	—	—	—	EZT24G	—
Ø 2,8 mm	—	TSV28SG	STR28D19	TSV28G	STR28D25
Ø 3,4 mm	—	TSV34SG	STR34D19	TSV34G	STR34D25
Ø 3,8 mm	—	TSV38SG	STR38D19	TSV38G	STR38D25
Ø 5,1 mm	—	TSV51SG	—	TSV51G	—

Forets coniques chirurgicaux Dríva

Diamètre	L 16 mm*	L 19 mm	L 22 mm*	L 25 mm	Code couleur
Ø 2,8/2,4 mm	—	—	EZT28D24G	—	Bleu
Ø 3,4/2,8 mm	TSV34D28SG	STP34D19	TSV34D28G	STP34D25	Points positifs
Ø 3,8/3,4 mm	TSV38D34SG	STP38D19	TSV38D34G	STP38D25	Blanc
Ø 4,4/3,8 mm	TSV44D38SG	STP44D19	TSV44D38G	STP44D25	Violet
Ø 5,1/4,4 mm	TSV51D44SG**	—	TSV51D44G**	—	—
Ø 5,7/5,1 mm	TSV57D51SG	—	TSV57D51G	—	Jaune

*Les forets de longueur 15, 16 et 22 mm présentent des bandes axiales pour faciliter leur identification lors de l'utilisation avec le kit de butées pour foret.
**Les forets TSV51D44SG et TSV51D44G sont les forets finaux pour l'implant TSX de Ø 5,4 mm dans l'os dense, sont des forets intermédiaires facultatifs dans la séquence de forage de Ø 6,0 mm et sont vendus séparément et non dans les trousses chirurgicales.

Les repères de profondeur sont usinés et marqués au laser pour une meilleure visibilité.
Les bandes sont environ 1,25 mm plus longues que la jonction implant-pilier.
(Par exemple : la bande 13 mm mesure 14,25 mm à partir de la pointe du foret.)

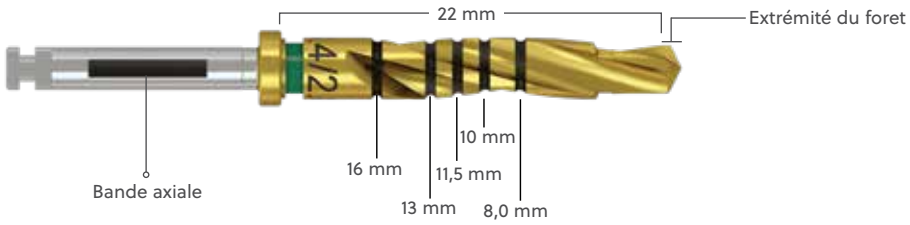

Forets à usage unique

Description	Quantité	Référence
Kit de forets, usage unique, long, implant Ø 3,7 mm, L 17 mm	Fraise boule Foret pilote Ø 2,3 mm Foret conique Ø 3,4/2,8 mm	DSTK3
Kit de forets, usage unique, court, implant Ø 3,7 mm, L 11 mm	Fraise boule Foret pilote Ø 2,3 mm Foret conique Ø 3,4/2,8 mm	DSTK3S
Foret, usage unique, long, implant Ø 4,7 mm, L 17 mm	Foret conique Ø 4,4/3,8 mm	DST4
Foret, usage unique, court, implant Ø 4,7 mm, L 11 mm	Foret conique Ø 4,4/3,8 mm	DST4S
Foret, usage unique, long, implant Ø 6,0 mm, L 17 mm	Foret conique Ø 5,7/5,1 mm	DST6
Foret, usage unique, court, implant Ø 6,0 mm, L 11 mm	Foret conique Ø 5,7/5,1 mm	DST6S

Remarque : pas d'irrigation interne. Les kits de forets longs ont des repères de profondeur pour les implants L 8, 10, 11,5, 13 et 16 mm. Les kits de forets courts ont des repères de profondeur pour les implants L 8 et 10 mm.

Instruments pour la pose d'implants

Description	Référence	
Clé dynamométrique chirurgicale	ZTIRW	
Clé à cliquet rétentive GemLock	RSR	
Manche de tournevis en acier inoxydable	SSHS	

Tournevis hexagonaux Ø 1,25 mm

Description	Mode d'utilisation	Référence	
Tournevis hexagonal rétentif GemLock, court, compatible avec les vis chirurgicales et prothétiques, L 17 mm	Manuel	HXGR1.25	
Tournevis hexagonal, long, compatible avec les vis chirurgicales et prothétiques, L 22 mm	Manuel	HXLGR1.25	
Tournevis mandrin hexagonal, court, L 22 mm	pour contre-angle et clé dynamométrique L-TIRW	HX1.25D	
Tournevis mandrin hexagonal, long, L 30 mm	pour contre-angle et clé dynamométrique L-TIRW	HXL1.25D	
Tournevis hexagonal pour clé à cliquet RSR, court, L 23 mm	RSR	HX1.25	
Tournevis hexagonale pour clé à cliquet RSR, long, L 26 mm	RSR	HXL1.25	

Inserts de pose Ø 2,1 mm pour pose d'implants TSX Ø 3,1 mm

Description	Mode d'utilisation	Référence
Insert de pose GemLock 2,1 mm, court	ZTIRW, RSR, SSHS	CHR2.1
Insert de pose GemLock 2,1 mm, long	ZTIRW, RSR, SSHS	CHRL2.1
Insert de pose hexagonal Gemlock 2,1 mm, court	Contre-angle	CHD2.1
Insert de pose hexagonal Gemlock 2,1 mm, long	Contre-angle	CHDL2.1

Inserts de pose Ø 2,5 mm pour pose d'implants TSX Ø 3,7 à 6,0 mm

Description	Mode d'utilisation	Référence
Insert de pose rétentif GemLock de 2,5 mm, L 28 mm	ZTIRW, RSR, SSHS	RH2.5
Insert de pose hexagonal rétentif GemLock de 2,5 mm, long, L 21 mm	ZTIRW, RSR, SSHS	RHL2.5
Insert de pose rétentif GemLock de 2,5 mm pour contre-angle, L 28 mm	Contre-angle	RHD2.5

Instruments chirurgicaux

Description	Référence
Prolongateur de foret	DEG
Jauge de parallélisme	PPAR
Fraise boule	1203G
Instrument pour extraction d'implants, acier carbure Remarque : ne pas stériliser à l'autoclave (stérilisation à froid uniquement)	IRT

Instruments de chirurgie guidée

Les implants TSX peuvent être posés de manière totalement guidée en utilisant le kit de chirurgie guidée RealGUIDE® Z3D™ et les instruments figurant aux pages 31 et 32. Des informations sur le module chirurgical partiellement guidé pour les kits chirurgicaux TSVKITG sont disponibles à la page 33.

Kit chirurgical RealGUIDE Z3D pour chirurgie totalement guidée*

Produit	Référence
Trousse chirurgicale Z3D RealGuide (complète)	3DM0070Z
Trousse chirurgicale autoclavable Z3D RealGUIDE (vide)	3DM0070ZUS

*Ne sont pas approuvés sur tous les marchés.

Configuration

Produit	Référence	
Foret pour pins de fixation max. 1 000 tr/min, acier inoxydable AISI 420B avec revêtement DLC	3DM00610Z	
Pins de fixation TiAl6V4 ASTM F136	3DM00609Z	
Prolongateur pour clé dynamométrique max. 50 Ncm, acier inoxydable AISI 420F MOD	3DM00623Z	
Adaptateur carré 4 × 4 pour contre-angle max. 50 Ncm, acier inoxydable AISI 420F MOD	3DM00612Z	
Jauge d'évaluation d'ouverture buccale/jauge d'occlusion acier inoxydable AISI 303	3DM00622Z	
Mucotome/Bistouri circulaire Diamètre interne : 4,2 mm, max. 100 tr/min, acier inoxydable AISI 420F MOD avec revêtement DLC	3DM00607Z	
Niveleur de crête osseuse max. 600 tr/min, acier inoxydable AISI 420B avec revêtement DLC	3DM00614Z	
Foret pilote Foret de préparation du site implantaire, max. 600 tr/min, acier inoxydable AISI 420B avec revêtement DLC	3DM00621Z	
Foret, Ø 2,4 × 6 mm max. 800 tr/min, acier inoxydable AISI 420B avec revêtement DLC	3DM00619Z	

Composants du kit chirurgical RealGUIDE Z3D pour chirurgie totalement guidée

Porte-implants RealGUIDE Z3D (acier inoxydable AISI 420F MOD)

Produit	Référence	
TSX/Eztetic ZimVie Ø 3,1 mm vis incluse, max. 20 tr/min, 50 Ncm	3DM00606ZIM31	
TSX ZimVie Ø 3,7/4,1/4,7 mm, TSV ZimVie Ø 3,7/4,1 mm vis incluse, max. 20 tr/min, 50 Ncm	3DM00606ZIM35	
TSV ZimVie Ø 4,7 mm vis incluse, max. 20 tr/min, 50 Ncm	3DM00606ZIM47	

Forets RealGUIDE Z3D (acier inoxydable AISI 420B avec revêtement DLC)

Longueur	Foret Ø 2,4 mm	Foret étagé, Ø 2,8/2,4 mm	Foret étagé, Ø 3,4/2,8 mm	Foret étagé, Ø 3,8/3,4 mm	Foret étagé, Ø 4,4/3,8 mm
			max. 800 tr/min		
8 mm	3DM00613.24.080Z	3DM00613.28.080Z	3DM00613.34.080Z	3DM00613.38.080Z	3DM00613.44.080Z
10 mm	3DM00613.24.100Z	3DM00613.28.100Z	3DM00613.34.100Z	3DM00613.38.100Z	3DM00613.44.100Z
11,5 mm	3DM00613.24.115Z	3DM00613.28.115Z	3DM00613.34.115Z	3DM00613.38.115Z	3DM00613.44.115Z
13 mm	3DM00613.24.130Z	3DM00613.28.130Z	3DM00613.34.130Z	3DM00613.38.130Z	3DM00613.44.130Z
16 mm	3DM00613.24.160Z	3DM00613.28.160Z	3DM00613.34.160Z	3DM00613.38.160Z	3DM00613.44.160Z

Accessoires RealGUIDE Z3D

Produit	Référence
Douille chirurgicale de guidage Procédure RealGUIDE CAD 5,05 mm, compatible 3DM RealGUIDE, trousse ZimVie RealGUIDE Z3D, trousse Nobel RP (10 unités)	3DM00670
Douille pour pins de fixation de guide chirurgical Procédure RealGUIDE CAD (10 unités)	3DM00671

Instruments de chirurgie totalement guidée

Description	Référence
Module de foret pour chirurgie partiellement guidée Peut être inséré dans la trousse chirurgicale TSVKITG pour obtenir une trousse de chirurgie assistée tout-en-un	GSMOD
Foret chirurgical Dríva EG Ø 2,3 mm, L 19 mm	STR23D19
Foret chirurgical Dríva EG Ø 2,3 mm, L 25 mm	STR23D25
Foret chirurgical conique Dríva EG Ø 2,8 mm/2,4 mm, L 19 mm	STP28D19
Foret chirurgical conique Dríva EG Ø 2,8 mm/2,4 mm, L 25 mm	STP28D25
Foret chirurgical Dríva EG Ø 2,8 mm, L 19 mm	STR28D19
Foret chirurgical Dríva EG Ø 2,8 mm, L 25 mm	STR28D25
Foret chirurgical conique Dríva EG Ø 3,4 mm/2,8 mm, L 19 mm	STP34D19
Foret chirurgical conique Dríva EG Ø 3,4 mm/2,8 mm, L 25 mm	STP34D25
Foret chirurgical Dríva EG Ø 3,4 mm, L 19 mm	STR34D19
Foret chirurgical Dríva EG Ø 3,4 mm, L 25 mm	STR34D25
Foret chirurgical conique Dríva EG Ø 3,8 mm/3,4 mm, L 19 mm	STP38D19
Foret chirurgical conique Dríva EG Ø 3,8 mm/3,4 mm, L 25 mm	STP38D25
Foret chirurgical Dríva EG Ø 3,8 mm, L 19 mm	STR38D19
Foret chirurgical Dríva EG Ø 3,8 mm, L 25 mm	STR38D25
Foret chirurgical conique Dríva EG Ø 4,4 mm/3,8 mm, L 19 mm	STP44D19
Foret chirurgical conique Dríva EG Ø 4,4 mm/3,8 mm, L 25 mm	STP44D25
Insert de module pour chirurgie partiellement assistée (vide)	GSTRAY
Kit de cuillères* Inclut 1 exemplaire de chacune des cuillères ci-dessous ; les forets EG sont utilisés avec le kit de cuillères ;	TADKIT
Cuillère, Ø 2,3 mm, A	TAD23A
Cuillère, Ø 2,8 mm, A	TAD28A
Cuillère, Ø 3,4 mm, A	TAD34A
Cuillère, Ø 2,3 mm, B	TAD23B
Cuillère, Ø 2,8 mm, B	TAD28B
Cuillère, Ø 3,4 mm, B	TAD34B
Cuillère, Ø 3,8 mm, B	TAD38B
Cuillère, Ø 4,4 mm, B	TAD44B

*À utiliser avec les forets Dríva EG et les forets Dríva avec bande axiale.

Kit de butées*

Description	Référence
Kit de butées complet pour forets (forets non inclus)	DSKIT
Set de butées, implant L 8,0 mm, foret Dríva Ø 2,3 à 4,4/3,8 mm x L 17/22 mm (lot de 5)	SS8D22
Set de butées, implant L 10 mm, foret Dríva Ø 2,3 à 4,4/3,8 mm x L 17/22 mm (lot de 5)	SS10D22
Set de butées, implant L 11,5 mm, foret Dríva Ø 2,3 à 4,4/3,8 mm x L 17/22 mm (lot de 5)	SS11D22
Set de butées, implant L 13 mm, foret Dríva Ø 2,3 à 4,4/3,8 mm x L 17/22 mm (lot de 5)	SS13D22
Set de butées, implant L 8 mm, foret Dríva Ø 2,3 à 4,4/3,8 mm x L 11/16 mm (lot de 5)	SS8D16
Set de butées, implant L 10 mm - foret Dríva L 11/16 mm et implant L 16 mm - Foret Dríva L 17/22 mm, foret Dríva Ø 2,3 à 4,4/3,8 mm (lot de 5)	SS10D16
Set de butées, implant L 11,5 mm, foret Dríva Ø 2,3 à 4,4/3,8 mm x L 11/16 mm (lot de 5)	SS11D16
Set de butées, implant L 8 à 16 mm, foret Dríva Ø 5,1 x 11/16 mm & L 17/22 mm (lot de 7)	SS51D
Set de butées, implant L 8 à 16 mm, foret Dríva Ø 5,7/5,1 x 11/16 mm & L 17/22 mm (lot de 7)	SS57D
Instrument multifonction pour butées	MTL

Profileurs d'os

Profileurs d'os pour piliers de cicatrisation Encode®

Plate-forme prothétique	Profil d'émergence	Encode TSV Pilier de cicatrisation	Connexion TSV
3,5 mm	3,8 mm	TEHA3383/TEEHA333	BPT3545
		TEHA3385/TEEHA335	
		TEHA3387/TEEHA337	
	5,0 mm	TEHA3503/TEEHA353	BPT3555
		TEHA3505/TEEHA355	
4,5 mm	5,0 mm	TEHA4503	BPT4555
		TEHA4505	
	5,6 mm	TEHA4563/TEEHA453	BPT4565
		TEHA4565/TEEHA455	
		TEHA4567/TEEHA457	
	6,0 mm	TEHA4603/TEEHA463	BPT4565
		TEHA4605/TEEHA465	

Profileurs d'os pour implants TSX

Plate-forme prothétique	Profil d'émergence	Connexion Eztetic
2,9 mm	3,7 mm	BPE2937
	4,5 mm	BPE2945

Profileurs d'os pour implants TSX

Plate-forme prothétique	Profil d'émergence	Connexion TSV
3,5 mm	3,7 mm	BPT3535
	4,5 mm	BPT3545
	5,5 mm	BPT3555
4,5 mm	4,5 mm	BPT4545
	5,5 mm	BPT4555
	6,5 mm	BPT4565

Remarque : pour la mise en place de piliers coniques, les profileurs d'os d'émergence 4,5 mm peuvent être utilisés.

Notes

Pour plus d'informations, consultez ZimVie.eu

ZimVie US Corp LLC
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Phone: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272
dentalCS@ZimVie.com

ZimVie France SAS
Bâtiment Québec
19 Rue d'Arcueil
94528 Rungis Cedex
Tel. : 0141-05-43-43
Fax : 0141-05-43-40
ZV.commandes@ZimVie.com

Sauf indication contraire, comme indiqué dans les présentes, toutes les marques de commerce et tous les droits de propriété intellectuelle sont la propriété de ZimVie Inc. et de ses filiales ; et tous les produits sont fabriqués par une ou plusieurs des filiales dentaires de ZimVie US Corp LLC (Biomet 3i, LLC, etc.) et distribués par ZimVie US Corp LLC et par ses partenaires de commercialisation autorisés. Les analogues d'implants numériques, les piliers Multi-Unit universels et les piliers OverdenSURE sont fabriqués par Terrats Medical S.L. La clé dynamométrique à couple élevé ZTIRW et la clé dynamométrique à couple faible L-TIRW sont fabriquées par Elos Medtech Pinol A/S. L'instrumentation RealGUIDE Z3D est fabriquée par Biomec S.r.l., à l'exception des articles 3DM0070ZUS, 3DM00670 et 3DM00671 qui sont fabriqués par 3DIEMME S.r.l. Classification des dispositifs médicaux de l'UE : Piliers dentaires et chapes (Classe IIb), analogues dentaires (Classe I), outils dentaires (Classe IIa), scanbody dentaires (Classe I), pilier de cicatrisation dentaire (Classe IIb). Implants dentaires (Classe IIb), coiffes d'empreinte (Classe Is). L'objectif des piliers dentaires et des chapes est de restaurer les implants, l'objectif des analogues dentaires est de reproduire les implants dans un modèle de laboratoire, l'objectif des outils dentaires est de placer les composants, l'objectif des scanbody dentaires est de numériser les cas d'implants, l'objectif des piliers de cicatrisation dentaire est de mettre en forme les tissus mous pendant la cicatrisation de l'implant. L'objectif des implants dentaires est de remplacer les dents manquantes ou les arcades dentaires édentées en fournissant un moyen de fixation prothétique. L'objectif des coiffes d'empreinte est de faciliter la référence positionnelle d'un pilier. Les produits présentés ici ne sont pas remboursables en France. Pour les autres pays, veuillez consulter les lois et réglementations locales. Pour plus d'informations sur le produit, consulter l'étiquetage de produit individuel ou la notice d'utilisation du produit. L'autorisation et la disponibilité du produit peuvent être limitées à certains pays/certaines régions. Ce document s'adresse uniquement aux praticiens et n'a pas pour objectif de fournir un avis ou des recommandations d'ordre médical. La distribution à tout autre destinataire est formellement interdite. Ce document ne peut être ni copié ni réimprimé sans l'autorisation écrite expresse de ZimVie. ZVINST0037-EMEA-FR REV F 05/26 ©2026 ZimVie. Tous droits réservés.

Le numéro de l'ON applicable à chaque dispositif se trouve sur l'étiquetage de produit, le cas échéant.

CE 2797 CE 0051 CE