Catálogo de produtos

Sistema de implante TSX®

ZimVie

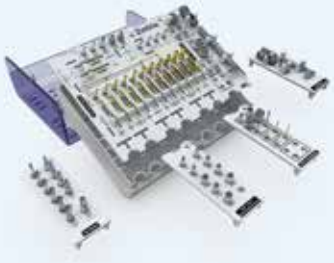

SOLUÇÕES DENTÁRIAS ZimVie

Índice

Implantes dentários **3**
Implantes TSX® 3

Componentes de cicatrização **4**
Diretrizes para a seleção de colos de cicatrização 4
Pilares de cicatrização Encode® Emergence 4
Pilares de cicatrização Encode 4
Colos de cicatrização 5

Restaurações protéticas **6**
Toma de impressão 6
Restaurações provisórias 7
Restaurações digitais 8
Restaurações cimentadas 9
Restaurações de ouro "Cast-To" 12
Restaurações aparafusadas 13
Restaurações do tipo "overdenture" 16
Ferramentas protéticas 18

Sistema de kit cirúrgico modular TSX **20**
Gráfico de disposição 20
Sistema de kit cirúrgico modular TSX para implantes TSX 24
Kit TSX, configuração modular 25
Informações de encomenda para preferências modulares pessoais 27

Kit cirúrgico e instrumentos **28**
Brocas cirúrgicas Dríva™ da série Gold 28
Instrumentos para cirurgia guiada 31
Componentes do kit RealGUIDE® Z3D™ totalmente guiado 32
Perfiladores ósseos 34

Implantes TSX

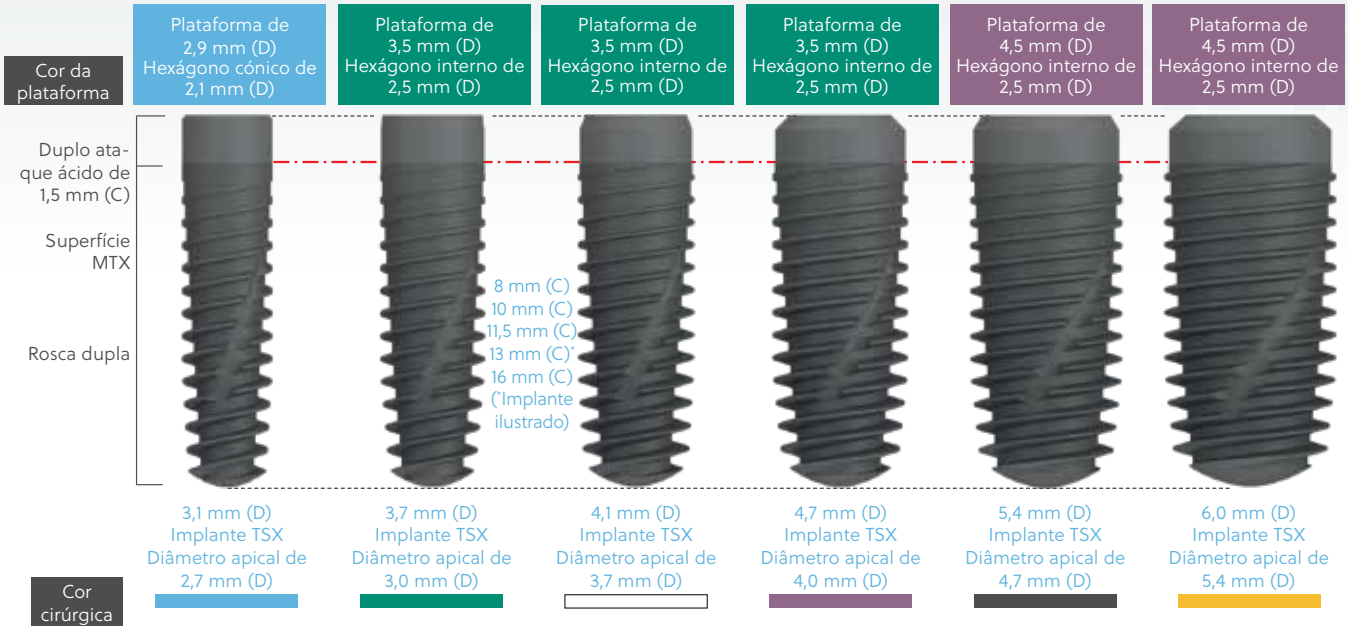

Parafusos de fecho cirúrgicos

Fornecidos com o implante.

Plataforma de implante		
NP (2,9 mm [D])	3,5 mm (D)	4,5 mm (D)
CCSNP	TSC	TSCW

Implantes TSX

Inclui parafuso de fecho e pino de alinhamento opcional para auxiliar na orientação do paralelismo durante a colocação de vários implantes.

Diâmetro do implante	Plataforma de implante	Conexão hexagonal interna	Comprimento do implante				
			8 mm (C)	10 mm (C)	11,5 mm (C)	13 mm (C)	16 mm (C)
3,1 mm (D)	2,9 mm (D)	2,1 mm (D)	TSX31B8	TSX31B10	TSX31B11	TSX31B13	TSX31B16
3,7 mm (D)	3,5 mm (D)	2,5 mm (D)	TSX37B8	TSX37B10	TSX37B11	TSX37B13	TSX37B16
4,1 mm (D)	3,5 mm (D)	2,5 mm (D)	TSX41B8	TSX41B10	TSX41B11	TSX41B13	TSX41B16
4,7 mm (D)*	3,5 mm (D)	2,5 mm (D)	TSX47B8	TSX47B10	TSX47B11	TSX47B13	TSX47B16
5,4 mm (D)	4,5 mm (D)	2,5 mm (D)	TSX54B8	TSX54B10	TSX54B11	TSX54B13	TSX54B16
6,0 mm (D)*	4,5 mm (D)	2,5 mm (D)	TSX6B8	TSX6B10	TSX6B11	TSX6B13	TSX6B16

*Nota: o implante de 4,7 mm (D) inclui uma plataforma de 3,5 mm (D) codificada com a cor verde e o implante de 6,0 mm (D) inclui uma plataforma de 4,5 mm (D) codificada com a cor roxa, ao contrário dos implantes TSV®.

Componentes de cicatrização

Diretrizes para a seleção de colos de cicatrização

Selecionar um colo de cicatrização:

- Determine o tamanho da plataforma de implante
- Selecione o perfil de emergência que melhor se adequa ao local da restauração.
  O perfil deve corresponder ao componente de transferência e/ou ao pilar a utilizar.
- Selecione a altura do ombro de modo a que a parte superior do componente sobressaia ligeiramente do tecido circundante.

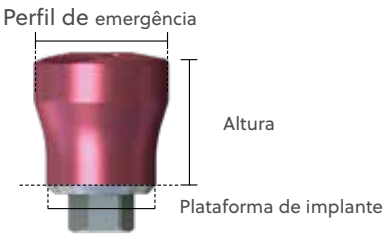

HC3/TEHA3/TEEHA3 = colo de cicatrização (plataforma de implante) de 3,5 mm (D)
HC4/TEHA4/TEEHA4 = colo de cicatrização (plataforma de implante) de 4,5 mm (D)

Exemplo:
TEEHA333 = pilar de cicatrização (plataforma de implante) de 3,5 mm (D), perfil de emergência de 3,8 mm (D), altura do ombro de 3,0 mm (o dígito central corresponde ao perfil e o último dígito à altura)
TEHA3383 = pilar de cicatrização (plataforma de implante) de 3,5 mm (D), perfil de emergência de 3,8 mm (D), altura do ombro de 3,0 mm (os dois dígitos centrais correspondem ao perfil e o último dígito à altura)
HC343 = colo de cicatrização (plataforma de implante) de 3,5 mm (D), perfil de emergência de 4,5 mm (D), altura do ombro de 3,0 mm (o segundo dígito corresponde ao perfil e o terceiro dígito à altura)

Pilares de cicatrização Encode Emergence*

O pilar de cicatrização Encode é um pilar de cicatrização/coifa de impressão/scanbody de duas peças 3 em 1.

Pilares de cicatrização Encode Emergence para implantes TSX 3,1 mm (D)

Plataforma de implante	Perfil de emergência	Altura do ombro		
		3,0 mm	5,0 mm	7,0 mm
2,9 mm (D)	3,7 mm (D)	CEEHA333	CEEHA335	CEEHA337
	4,5 mm (D)	CEEHA343	CEEHA345	CEEHA347

Pilares de cicatrização Encode Emergence para implantes TSX

Plataforma de implante	Perfil de emergência	Altura do ombro		
		3,0 mm	5,0 mm	7,0 mm
3,5 mm (D)	3,8 mm (D)	TEEHA333	TEEHA335	TEEHA337
3,5 mm (D)	5,0 mm (D)	TEEHA353	TEEHA355	TEEHA357
3,5 mm (D)	6,5 mm (D)	TEEHA363	TEEHA365	TEEHA367
4,5 mm (D)	4,5 mm (D)	TEEHA443	TEEHA445	TEEHA447
4,5 mm (D)	5,5 mm (D)	TEEHA453	TEEHA455	TEEHA457
4,5 mm (D)	6,5 mm (D)	TEEHA463	TEEHA465	TEEHA467
4,5 mm (D)	7,5 mm (D)	TEEHA473	TEEHA475	TEEHA477

*Não disponível em todos os mercados.

Pilares de cicatrização

Plataforma de implante	Perfil de emergência	Altura do ombro		
		1,5 mm	3,0 mm	4,5 mm
NP (2,9 mm [D])	3,7 mm (D)	CHCNP31	CHCNP33	CHCNP34
NP (2,9 mm [D])	4,5 mm (D)	CHCNP41	CHCNP43	CHCNP44

Plataforma de implante	Perfil de emergência	Altura do ombro		
		3,0 mm	5,0 mm	7,0 mm
3,5 mm (D)	3,5 mm (D) (sem rebordo)	HC333	HC335	—
3,5 mm (D)	4,5 mm (D)	HC343	HC345	HC347
3,5 mm (D)	5,5 mm (D)	HC353	HC355	—
4,5 mm (D)	4,5 mm (D) (sem rebordo)	HC443	HC445	—
4,5 mm (D)	5,5 mm (D)	HC453	HC455	HC457
4,5 mm (D)	6,5 mm (D)	HC463	HC465	—

Restaurações protéticas

Toma de impressão

Suporte de restauração/transferências

Não incluído no implante TSX. Inclui parafuso de retenção (URS2). Pode ser utilizado como pilar temporário de preparação.

Plataforma de implante	Perfil de emergência	N.º do item
3,5 mm (D)	4,5 mm (D)	FMT3
4,5 mm (D)	5,5 mm (D)	FMT4
Parafuso de retenção de substituição	—	URS2

Transferências indiretas (procedimento com moldeira fechada)

Com código de cores por plataforma de implante. Inclui parafuso de retenção (CASLT).

Plataforma de implante	Perfil de emergência	Altura do ombro		
		1,5 mm	3,0 mm	4,5 mm
NP (2,9 mm [D])	3,7 mm (D)	CITNP31	CITNP33	CITNP34
NP (2,9 mm [D])	4,5 mm (D)	CITNP41	CITNP43	CITNP44
Parafuso de retenção de substituição		CASLT	CASLT	CASLT

Com código de cores por plataforma de implante. Inclui parafuso de retenção (HLTS2).

Plataforma de implante	Perfil de emergência			
	3,5 mm (D)	4,5 mm (D)	5,5 mm (D)	6,5 mm (D)
3,5 mm (D)	HLT3/3	HLT3/4	HLT3/5	—
4,5 mm (D)	—	HLT4/4	HLT4/5	HLT4/6
Parafuso de extensão de 3,0 mm para transferência indireta	HLTE	HLTE	HLTE	HLTE
Parafuso de retenção de substituição	HLTS2	HLTS2	HLTS2	HLTS2

Transferências diretas (procedimento com moldeira aberta)

Com código de cores por plataforma de implante. Inclui parafuso de retenção (CASLC).

Plataforma de implante	Perfil de emergência	Altura do ombro		
		1,5 mm	3,0 mm	4,5 mm
NP (2,9 mm [D])	3,7 mm (D)	CDTNP31	CDTNP33	CDTNP34
NP (2,9 mm [D])	4,5 mm (D)	CDTNP41	CDTNP43	CDTNP44
Parafuso de retenção de substituição		CASLC	CASLC	CASLC

Com código de cores por plataforma de implante. Inclui parafuso de retenção (DHTS).

Plataforma de implante	Perfil de emergência			
	3,5 mm (D)	4,5 mm (D)	5,5 mm (D)	6,5 mm (D)
3,5 mm (D)	DHT3/3	DHT3/4	DHT3/5	—
4,5 mm (D)	—	DHT4/4	DHT4/5	DHT4/6
Parafuso de retenção de substituição	DHTS	DHTS	DHTS	DHTS

Análogos de implante em titânio para modelos de gesso

Com código de cores por plataforma de implante.

Plataforma de implante	N.º do item
NP (2,9 mm [D])	CIANP
3,5 mm (D)	IA3
4,5 mm (D)	IA4

Restaurações provisórias

Pilar temporário de titânio

Inclui parafuso de retenção (CUAS) e parafuso de processamento longo (CASLC).

Plataforma de implante	Perfil de emergência	N.º do item
NP (2,9 mm [D])	3,5 mm (D)	CTANP31
Parafuso de retenção de substituição		CUAS
Parafuso de processamento longo de substituição		CASLC

Pilares temporários de plástico, retos

Inclui parafuso de retenção e parafuso de processamento (DHTS2).

Plataforma de implante	Perfil de emergência	Altura do ombro	
		1,0 mm	4,0 mm
3,5 mm (D)	4,5 mm (D)	PT341S	PT344S
4,5 mm (D)	5,5 mm (D)	PT451S	PT454S
Parafuso de retenção de substituição, longo		DHTS2	DHTS2

Pilar temporário de plástico, com ângulo de 17°

Inclui parafuso de retenção e parafuso de processamento (DHTS2).

Plataforma de implante	Perfil de emergência	Altura do ombro	
		1,0 mm	4,0 mm
3,5 mm (D)	4,5 mm (D)	PT341A	PT344A
4,5 mm (D)	5,5 mm (D)	PT451A	PT454A
Parafuso de retenção de substituição, longo		DHTS2	DHTS2

Restaurações digitais

Pilares específicos para cada paciente

Disponíveis em titânio.

Concebidos por computador e precisão CAD/CAM com fresagem personalizada.
Consulte um representante da ZimVie para obter informações adicionais.

NOTA: os pilares específicos para cada paciente estão disponíveis apenas em mercados selecionados.

Ferramentas e acessórios

Descrição	N.º do item	
Chave de torque, restauração Intervalo de torque ajustável 10 Ncm – 35 Ncm	TWR	
Chave de catraca indicadora de torque reduzido (inclui adaptador de contra-ângulo C9980)	L-TIRW	
Adaptador de contra-ângulo para chave de catraca indicadora de torque reduzido, norma ISO 1797	C9980	
Chave de catraca com encaixe quadrado GemLock® para uso restaurativo com HX1.25, HXL1.25 e SRT	RSR	

Restaurações cimentadas

Tabela de codificação por cores: perfil de emergência para componentes/pilares de restauração curtos e de contorno Hex-Lock®

As cores correspondem ao perfil de emergência do pilar nos pilares curtos e de contorno Hex-Lock e componentes de restauração curtos e de contorno relacionados.

Perfil de emergência do pilar*	Codificação por cores
4,5 mm (D)	Bronze
5,5 mm (D)	Rosa

*Para componentes de restauração curtos e de contorno Hex-Lock.

Pilares de contorno Hex-Lock, reto

Inclui parafuso de retenção (CUAS).

Plataforma de implante	Perfil de emergência	Altura do ombro		
		1,5 mm	3,0 mm	4,5 mm
NP (2,9 mm [D])	3,7 mm (D)*	CANP31S	CANP33S	CANP34S
NP (2,9 mm [D])	4,5 mm (D)*	CANP41S	CANP43S	CANP44S
Parafuso de retenção de substituição		CUAS	CUAS	CUAS

* Os componentes de contorno com perfil de emergência de 3,7 mm (D) não são compatíveis com os componentes de restauração de contorno de 3,5 mm (D).

Inclui parafuso de retenção (MHLAS).

Plataforma de implante	Perfil de emergência	Altura do ombro		
		1,0 mm	2,0 mm	3,0 mm
3,5 mm (D)	4,5 mm (D)	ZOA341S	ZOA342S	ZOA343S
4,5 mm (D)	4,5 mm (D)	ZOA441S	ZOA442S	ZOA443S
4,5 mm (D)	5,5 mm (D)	ZOA451S	ZOA452S	ZOA453S
Parafuso de retenção de substituição		MHLAS	MHLAS	MHLAS

Pilares de contorno Hex-Lock, com ângulo de 17°

Inclui um parafuso de retenção (CUASA ou CUAS).

Plataforma de implante	Perfil de emergência	Altura do ombro	
		1,5 mm	3,0 mm
NP (2,9 mm [D])	3,7 mm (D)*	CANP31A	CANP33A
NP (2,9 mm [D])	4,5 mm (D)**	CANP41A	CANP43A
Parafuso de retenção de substituição		CUASA	CUAS

Inclui parafuso de retenção (AH20S).

Plataforma de implante	Perfil de emergência	Altura do ombro	
		1,0 mm	2,0 mm
3,5 mm (D)	4,5 mm (D)	ZOA341A	ZOA342A
4,5 mm (D)	4,5 mm (D)	ZOA441A	ZOA442A
4,5 mm (D)	5,5 mm (D)	ZOA451A	ZOA452A
Parafuso de retenção de substituição		AH20S	AH20S

Try-Ins do pilar de contorno e kit de Try-Ins

Plataforma de implante	Perfil de emergência	Descrição	N.º do item
3,5 mm (D)	4,5 mm (D)	Conjunto de 5: vários ângulos, alturas dos ombros	ZOAT34
4,5 mm (D)	5,5 mm (D)	Conjunto de 5: vários ângulos, alturas dos ombros	ZOAT45
Todos	Todos	3 conjuntos de 5: todos os tamanhos	ZOATKIT

Coifas provisórias de contorno

Perfil de emergência	Reto	17°
4,5 mm (D)	ZCPROV4S	ZCPROV4A
5,5 mm (D)	ZCPROV5S	ZCPROV5A

Tampas de impressão de contorno

Perfil de emergência	Reto	17°
4,5 mm (D)	ZOCIMP4S	ZOCIMP4A
5,5 mm (D)	ZOCIMP5S	ZOCIMP5A

Análogos do pilar de contorno, titânio

Perfil de emergência	Reto	Angulado
4,5 mm (D)	TCANA4S	TCANA4A
5,5 mm (D)	TCANA5S	TCANA5A

Coifas para waxing de contorno

Perfil de emergência	Reto	17°
4,5 mm (D)	ZOCWAX4S	ZOCWAX4A
5,5 mm (D)	ZOCWAX5S	ZOCWAX5A

Pilares curtos Hex-Lock

Inclui parafuso de retenção (MHLAS).

Plataforma de implante	Perfil de emergência	Altura do ombro	
		1,0 mm	2,0 mm
3,5 mm (D)	4,5 mm (D)	SA341	SA342
4,5 mm (D)	5,5 mm (D)	SA451	SA452
Parafuso de retenção de substituição		MHLAS	MHLAS

Coifas provisórias curtas

Perfil de emergência	N.º do item
4,5 mm (D)	SAPROVP4
5,5 mm (D)	SAPROVP5

Tampas de impressão curtas

Perfil de emergência	N.º do item
4,5 mm (D)	SAIMP4
5,5 mm (D)	SAIMP5

Análogos de pilares curtos, titânio

Perfil de emergência	N.º do item
4,5 mm (D)	SAANA4
5,5 mm (D)	SAANA5

Coifas para waxing curtas

Perfil de emergência	N.º do item
4,5 mm (D)	SAWAX4
5,5 mm (D)	SAWAX5

Pilares Hex-Lock

Inclui parafuso de retenção (MHLAS).

Plataforma de implante	Perfil de emergência			
	3,5 mm (D)	4,5 mm (D)	5,5 mm (D)	6,5 mm (D)
3,5 mm (D)	HLA3/3	HLA3/4	HLA3/5	—
4,5 mm (D)	—	HLA4/4	HLA4/5	HLA4/6
Parafuso de retenção de substituição, curto	MHLAS	MHLAS	MHLAS	MHLAS
Parafuso de retenção de substituição, longo	HLTS2	HLTS2	HLTS2	HLTS2

Pilar angulado, 20°

Inclui parafuso de retenção (CUAS).

Plataforma de implante	Perfil de emergência	N.º do item
NP (2,9 mm [D])	3,5 mm (D)	C20A3
Parafuso de retenção de substituição		CUAS

Inclui parafuso de retenção (AH2OS).

Plataforma de implante	Perfil de emergência	N.º do item
3,5 mm (D)	4,5 mm (D)	AH20/4
4,5 mm (D)	5,5 mm (D)	AH20W/5
Parafuso de retenção de substituição	—	AH20S

Restaurações de ouro "Cast-To"

Pilares de Ouro "Cast-To", de encaixe

Inclui parafuso de retenção (CUAS).

Plataforma de implante	Perfil de emergência	N.º do item
NP (2,9 mm [D])	3,5 mm (D)	CEANP31
Parafuso de retenção de substituição		CUAS
Parafuso de processamento longo		CASLC

Inclui parafuso de retenção (MHLAS).

Plataforma de implante	N.º do item
3,5 mm (D)	HLA3G
4,5 mm (D)	HLA4G
Parafuso de retenção de substituição	MHLAS
Parafuso para waxing para pilares "Cast-To"	MTWSD

Pilares de ouro "Cast-To", de não encaixe

Inclui parafuso de retenção (MHLAS).

Plataforma de implante	N.º do item
3,5 mm (D)	NEA3G
4,5 mm (D)	NEA4G
Parafuso de retenção de substituição	MHLAS

Restaurações aparafusadas

Pilares de restaurações de várias unidades universais retos

Sendo rotacional, o pilar não encaixa na conexão hexagonal interna. Não utilizar em restaurações individuais. Tampa de cicatrização (UMUA-HCS) vendida separadamente.

Plataforma de implante	Altura do colo				
	1,0 mm	2,0 mm	3,0 mm	4,0 mm	5,0 mm
NP (2,9 mm [D])	UMUA-NP291S	UMUA-NP292S	UMUA-NP293S	UMUA-NP294S	UMUA-NP295S
3,5 mm (D)	UMUA-TSV351S	UMUA-TSV352S	UMUA-TSV353S	UMUA-TSV354S	UMUA-TSV355S
4,5 mm (D)	UMUA-TSV451S	UMUA-TSV452S	UMUA-TSV453S	UMUA-TSV454S	UMUA-TSV455S

Pilares de restaurações de várias unidades universais angulados, 17°

Os pilares encaixam na conexão hexagonal interna. Não utilizar em reabilitações unitárias (inclui parafuso de retenção pré-montado).

Plataforma de implante	Altura do colo	
	2,5 mm	3,5 mm
NP (2,9 mm [D])	UMUA-NP2925-17S	UMUA-NP2935-17S
3,5 mm (D)	UMUA-TSV3525-17S	UMUA-TSV3535-17S
4,5 mm (D)	UMUA-TSV4525-17S	UMUA-TSV4535-17S

Pilares de restaurações de várias unidades universais angulados, 30°

Os pilares encaixam na conexão hexagonal interna. Não utilizar em reabilitações unitárias (inclui parafuso de retenção pré-montado).

Plataforma de implante	Altura do colo	
	3,5 mm	4,5 mm
NP (2,9 mm [D])	UMUA-NP2935-30S	UMUA-NP2945-30S
3,5 mm (D)	UMUA-TSV3535-30S	UMUA-TSV3545-30S
4,5 mm (D)	UMUA-TSV4535-30S	UMUA-TSV4545-30S

Tampa de cicatrização para pilar universal

A tampa de cicatrização é enroscada no pilar de restaurações de várias unidades universal e no pilar de restaurações de várias unidades angulado.

Descrição	N.º do item
Tampa de cicatrização para pilar universal	UMUA-HCS

Coifa de impressão para pilar universal

A coifa de impressão é enroscada no pilar universal de restaurações de várias unidades e no pilar de restaurações de várias unidades angulado para o processo de impressão. Este método transfere a posição do pilar.

Descrição	Altura	N.º do item
Coifa de impressão para pilar universal de moldeira aberta Inclui parafusos de transferência	12 mm	UMUA-OTIC
Coifa de impressão para pilar universal de moldeira fechada	5 mm	UMUA-CTICS
Coifa de impressão para pilar universal de moldeira fechada, (Qtd. 4)	5 mm	UMUA-CTICS4
Coifa de impressão para pilar universal de moldeira fechada	8 mm	UMUA-CTICL
Coifa de impressão para pilar universal de moldeira fechada, (Qtd. 4)	8 mm	UMUA-CTICL4

Scanbodies de pilar universal

O Scanbody é enroscado no pilar universal de restaurações de várias unidades e no pilar de restaurações de várias unidades angulado.

Descrição	N.º do item
Scanbody de pilar universal, intraoral	UMUA-SBIO
Scanbody de pilar universal, Ti-base, (Qtd. 5)	UMUA-SBTB5
Scanbody de pilar universal, área de trabalho Inclui parafuso de várias unidades (UMUA-S)	UMUA-SBDT

Ti-base de pilar universal

A Ti-base é enroscada no pilar universal de restaurações de várias unidades e no pilar de restaurações de várias unidades angulado.

Descrição	Altura	N.º do item
Ti-base de pilar universal Inclui parafuso de várias unidades (UMUA-S)	6 mm	UMUA-TTS
Ti-base de pilar universal Inclui parafuso de várias unidades (UMUA-S)	8 mm	UMUA-TTL

Ti-base para pilar universal, canal para parafuso angulado

Descrição	N.º do item
Ti-base para pilar universal, canal para parafuso angulado Inclui canal para parafuso angulado (UMUA-ASCTS)	UMUA-ASCT

Análogo de pilar universal para modelos de gesso

Descrição	N.º do item
Análogo de pilar universal	UMUA-A

Análogo digital de pilar universal

Descrição	N.º do item
Análogo digital de pilar universal Inclui parafuso de várias unidades (UMUA-S)	UMUA-DA

Parafusos de substituição para componentes de restaurações de várias unidades universais

Descrição	N.º do item
Parafuso de restaurações de várias unidades universal	UMUA-S
Canal de parafuso angulado universal	UMUA-ASCTS

Cilindro temporário de pilar universal

O cilindro temporário é enroscado no pilar universal de restaurações de várias unidades e no pilar de restaurações de várias unidades angulado.

Descrição	N.º do item
Cilindro temporário de pilar universal Inclui parafuso de várias unidades (UMUA-S)	UMUA-TCS



Componente de encaixe OverdenSURE® para pilar universal

Descrição	N.º do item
Componente de encaixe OverdenSURE para pilar universal	UMUA-ODS

Restaurações do tipo "overdenture"

Sistema de encaixe amovível OverdenSURE

Altura do colo	Plataforma de implante		
	NP(2,9 mm (D))	3,5mm (D)	4,5 mm (D)
1,0 mm	ODS-NP201	ODS-TSV301	ODS-TSV401
2,0 mm	ODS-NP202	ODS-TSV302	ODS-TSV402
3,0 mm	ODS-NP203	ODS-TSV303	ODS-TSV403
4,0 mm	ODS-NP204	ODS-TSV304	ODS-TSV404
5,0 mm	ODS-NP205	ODS-TSV305	ODS-TSV405
6,0 mm	ODS-NP206	ODS-TSV306	ODS-TSV406

Kit de retenção ODS-RIKIT2001 incluído. Disponível em todas as regiões ativas, exceto nos EUA.

Ferramentas e acessórios OverdenSURE

Coifa de impressão Qtd. 1	ODS-IC01	
Coifa de impressão Qtd. 4	ODS-IC04	
Coifa de impressão Qtd. 10	ODS-IC010	
Análogo Qtd. 1	ODS-AA01	
Análogo Qtd. 4	ODS-AA04	
Análogo Qtd. 10	ODS-AA010	
Kit de retenção 20° Qtd. 1 conjunto	ODS-RIKIT2001	
Kit de retenção 20° Qtd. 2 conjuntos	ODS-RIKIT2002	
Kit de retenção 40° Qtd. 1 conjunto	ODS-RIKIT4001	
Kit de retenção 40° Qtd. 2 conjuntos	ODS-RIKIT4002	
Cápsula de retenção azul 20° Qtd. 4	ODS-RIB2004	
Cápsula de retenção rosa 20° Qtd. 4	ODS-RIP2004	
Cápsula de retenção transparente 20° Qtd. 4	ODS-RIC2004	

Cápsula de retenção vermelha 40° Qtd. 4	ODS-RIR4004	
Cápsula de retenção amarela 40° Qtd. 4	ODS-RIY4004	
Cápsula de retenção verde 40° Qtd. 4	ODS-RIG4004	
Capa de encaixe de retenção Qtd. 1	ODS-RH01	
Capa de encaixe de retenção Qtd. 4	ODS-RH04	
Capa de encaixe de retenção Qtd. 10	ODS-RH010	
Anel espaçador Qtd. 20	ODS-BS020	
Chave para pilar	ODS-DRVR	
Ferramenta de inserção e remoção	ODS-IRTOOL	
Encaixe de barras dos pilares Qtd. 1	ODS-BARATT01	
Encaixe de barras dos pilares Qtd. 2	ODS-BARATT02	
Encaixe de barras dos pilares Qtd. 4	ODS-BARATT04	
Scanbody Qtd. 10	ODS-SB010	

Pilares bola

Os pilares não são encaixados numa conexão hexagonal interna. Inclui encaixe retentivo e revestimento de nylon.

Plataforma de implante	Altura do ombro		
	2,0 mm	4,0 mm	6,0 mm
NP (2,9 mm [D])	CBANP2	CBANP4	CBANP6
3,5 mm (D)	BAC2	BAC4	BAC6
4,5 mm (D)	BACW2	BACW4	BACW6

Componentes de transferência de pilares bola

Descrição	N.º do item
Componente de transferência de pilares bola (Qtd. 2)	BAT
Réplica de pilar bola	BAR

Componentes protéticos

Descrição	N.º do item
Encaixe retentivo (CAH)/Encaixe retentivo e revestimento de nylon (CAN)	CA
Encaixe retentivo	CAH
Encaixe retentivo e revestimento de nylon, transparente	CAN
Encaixe retentivo e revestimento de nylon, cinzento – retenção rígida	CAN-G
Transfer com encaixe retentivo	CAT
Padrão de bola moldável, 2 bolas por padrão	CAB
Micro encaixe retentivo e revestimento de nylon	CANM

Ferramentas protéticas

Chaves de torque e catraca

Descrição	N.º do item	
Chave de torque, restauração Intervalo de torque ajustável 10 Ncm – 35 Ncm	TWR	
Chave de catraca indicadora de torque reduzido (inclui adaptador de contra-ângulo C9980)	L-TIRW	
Adaptador de contra-ângulo para chave de catraca indicadora de torque reduzido, norma ISO 1797	C9980	
Chave de catraca com encaixe quadrado GemLock para uso restaurativo com HX1.25, HXL1.25 e SRT	RSR	

NOTA: não aperte os parafusos cirúrgicos e protéticos para além do torque recomendado indicado no manual técnico e/ou nas instruções de utilização.

Chaves hexagonais de 1,25 mm (D) para parafusos cirúrgicos e protéticos

Descrição	Modo de utilização	N.º do item	
Chave hexagonal, curta, com retenção GemLock, 1,25 mm (D), 22 mm (C)	Manual	HXGR1.25	
Chave hexagonal, longa, com retenção GemLock, 1,25 mm (D), 30 mm (C)	Manual	HXLGR1.25	
Chave hexagonal para contra-ângulo para parafusos cirúrgicos e protéticos, curta, 1,25 mm (D), 23 mm (C); poderá necessitar de redutor	Redutor, L-TIRW	HX1.25D	
Chave hexagonal para contra-ângulo para parafusos cirúrgicos e protéticos, longa, 1,25 mm (D), 26 mm (C); poderá necessitar de redutor	Redutor, L-TIRW	HXL1.25D	
Chave de torque hexagonal, curta, 1,25 mm (D), 17 mm (C)	TWR	TW1.25	
Chave de torque hexagonal, longa, 1,25 mm (D), 22 mm (C)	TWR	TW1.25L	
Chave hexagonal, curta, padrão, 1,25 mm (D), 17 mm (C)	RSR	HX1.25	
Chave hexagonal, longa, padrão, 1,25 mm (D), 22 mm (C)	RSR	HXL1.25	

Ferramentas de remoção

Descrição	Modo de utilização	N.º do item	
Ferramenta de remoção para pilares NP (2,9 mm [D])	Manual ou RSR	CLRT2	
Ferramenta de remoção para pilares de implantes hexagonais internos Incluída nos kits cirúrgicos TSV TSVKIT e STRKIT	Manual ou RSR	TLRT2	
Chave de remoção de parafusos de pilar ou parafusos de fixação com hexágono de 1,25 mm (D), aço de carbono Nota: não autoclavar	RSR	SRT	

Acessórios e ferramentas protéticas adicionais

Descrição	N.º do item	
Tabuleiro de kit protético, autoclavável, vazio	2320	
Suporte do pilar Requer um análogo de implante para fixar os pilares	ABTH	

Gráfico do esquema do sistema de kit cirúrgico modular TSX

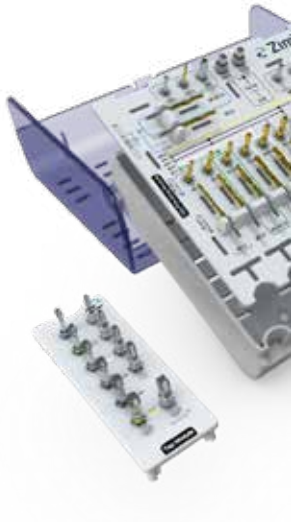

1
1203G
2,0 mm (D)
Broca esférica

2
0201G
2,1/1,6 mm (D)
Broca-piloto cónica de 8,0 mm - 11,5 mm (C)

3
DEG
Extensor de broca

4
CLRT2
Ferramenta de remoção para pilares NP

5
TLRT2
Ferramenta de remoção para pilares hexagonais internos

6
PPAR
Paralelizador (Qtd.: 4)

7
EZT28D24G
Broca escalonada de 2,8/2,4 mm (D), 22 mm (C)

8
EZT24G
Broca de 2,4 mm (D), 22 mm (C)

9
TSV23SG
Broca de 2,3 mm (D), 16 mm (C)

10
TSV28SG
Broca de 2,8 mm (D), 16 mm (C)

11
TSV34D28SG
Broca escalonada de 3,4/2,8 mm (D), 16 mm (C)

12
TSV34SG
Broca de 3,4 mm (D), 16 mm (C)

13
TSV38D34SG
Broca escalonada de 3,8/3,4 mm (D), 16 mm (C)

14
TSV38SG
Broca de 3,8 mm (D), 16 mm (C)

15
TSV44D38SG
Broca escalonada de 4,4/3,8 mm (D), 16 mm (C)

16
TSV44SG
Broca de 4,4 mm (D), 16 mm (C)

Módulo de broca **(incluído no TSXKIT)**

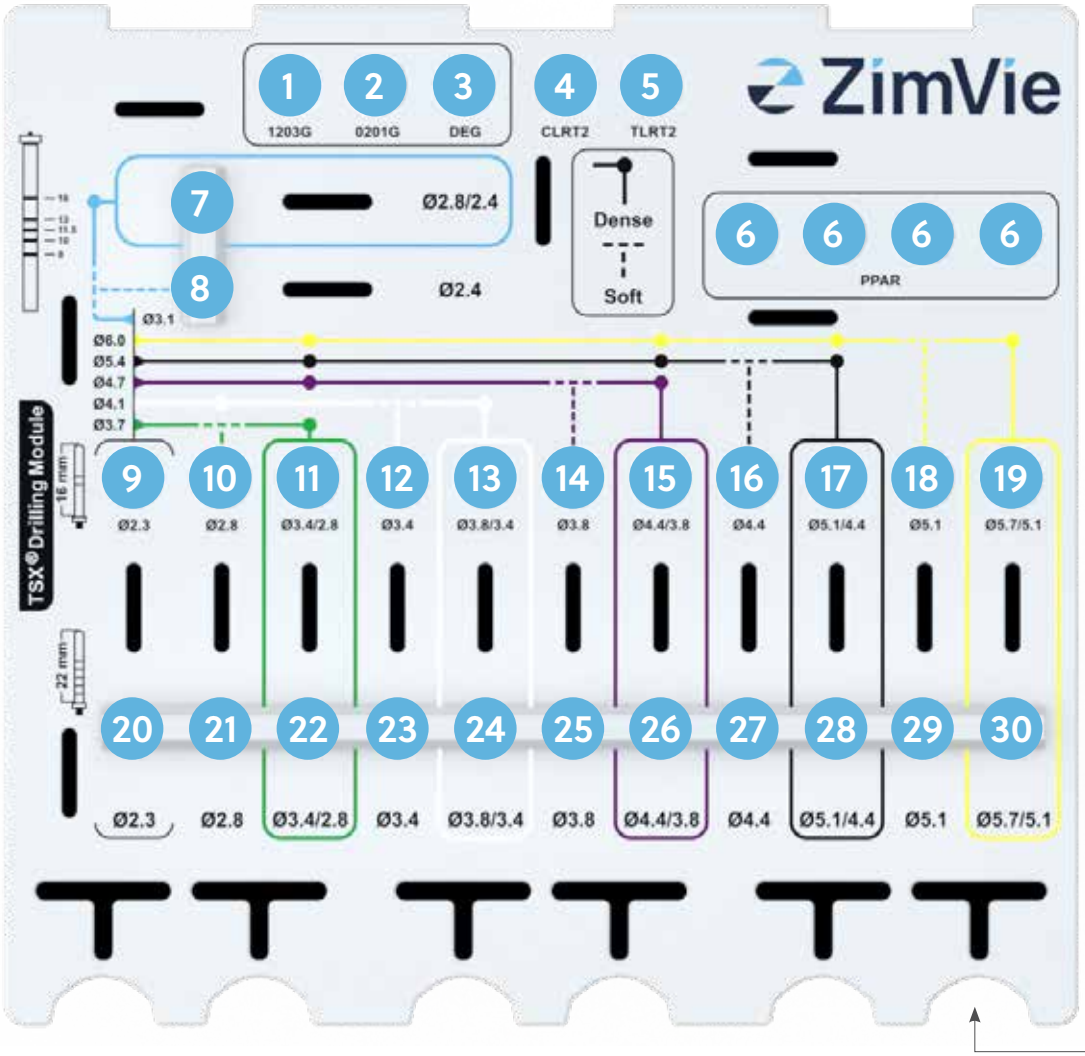

Ranhuras de preparação do implante

20
TSV23G
Broca de 2,3 mm (D), 22 mm (C)

24
TSV38D34G
Broca escalonada de 3,8/3,4 mm (D), 22 mm (C)

28
TSV51D44G
Broca escalonada de 5,1/4,4 mm (D), 22 mm (C)

17

TSV51D44SG
TSV51D44SG Broca escalonada de 5,1/4,4 mm (D), 16 mm (C)

18

TSV51SG
Broca de 5,1 mm (D), 16 mm (C)

19

TSV57D51SG
Broca escalonada de 5,7/5,1 mm (D), 16 mm (C)

21

TSV28G
Broca de 2,8 mm (D), 22 mm (C)

22

TSV34D28G
Broca escalonada de 3,4/2,8 mm (D), 22 mm (C)

23

TSV34G
Broca de 3,4 mm (D), 22 mm (C)

25

TSV38G
Broca de 3,8 mm (D), 22 mm (C)

26

TSV44D38G
Broca escalonada de 4,4/3,8 mm (D), 22 mm (C)

27

TSV44G
Broca de 4,4 mm (D), 22 mm (C)

29

TSV51G
Broca de 5,1 mm (D), 22 mm (C)

30

TSV57D51G
Broca escalonada de 5,7/5,1 mm (D), 22 mm (C)

Módulo de ferramentas
(incluído no TSXKIT)

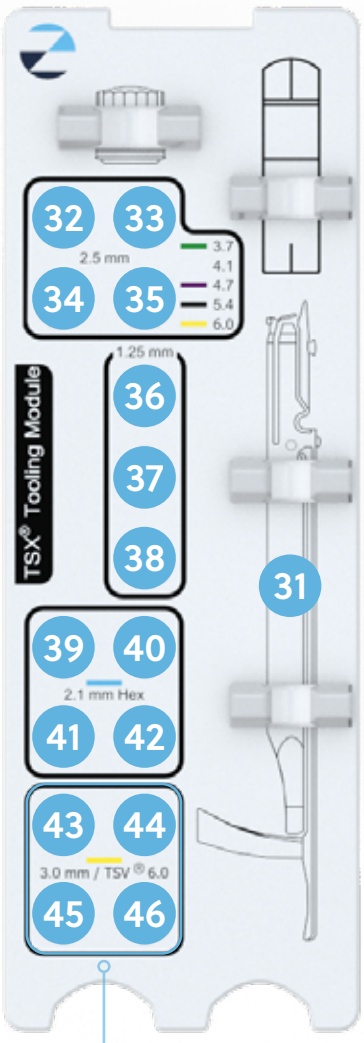

Chaves hexagonais de 3,0 mm utilizadas com o implante TSV de 6,0 mm (D) quando o suporte de fixação foi removido (adquirido em separado)

31

ZTIRW
Chave de roquete indicadora de torque elevado (0-90 Ncm)

32

GHX2.5D
Broca hexagonal GemLock® de 2,5 mm, com encaixe de contra-ângulo, curta

33

GHX2.5DL
Broca hexagonal GemLock de 2,5 mm, com encaixe de contra-ângulo, longa

34

GHX2.5
Chave hexagonal GemLock de 2,5 mm, curta

35

GHX2.5L
Chave hexagonal GemLock de 2,5 mm, longa

36

HX1.25D
Chave hexagonal de 1,25 mm, contra-ângulo, curta

37

HXLGR1.25
Chave hexagonal GemLock de 1,25 mm, longa

38

HXGR1.25
Chave hexagonal GemLock de 1,25 mm, curta

39

CHD2.1
Broca hexagonal GemLock de 2,1 mm, contra-ângulo, curta

40

CHDL2.1
Broca hexagonal GemLock de 2,1 mm, contra-ângulo, longa

41

CHR2.1
Ferramenta hexagonal GemLock de 2,1 mm, curta

42

CHRL2.1
Ferramenta hexagonal GemLock de 2,1 mm, longa

43

RHX3.0DS
Chave hexagonal, Latch-lock, 3,0 mm (D), 21 mm (C) (adquirido em separado)

44

RHX3.0DL
Chave hexagonal, Latch-lock, 3,0 mm (D), 25 mm (C) (adquirido em separado)

45

RHX3.0RS
Chave hexagonal, roquete, 3,0 mm (D) 17 mm (C) (adquirido em separado)

46

RHX3.0RM
Chave hexagonal, roquete, 3,0 mm (D) 22 mm (C) (adquirido em separado)

Módulo de toque **(TAPMOD)**

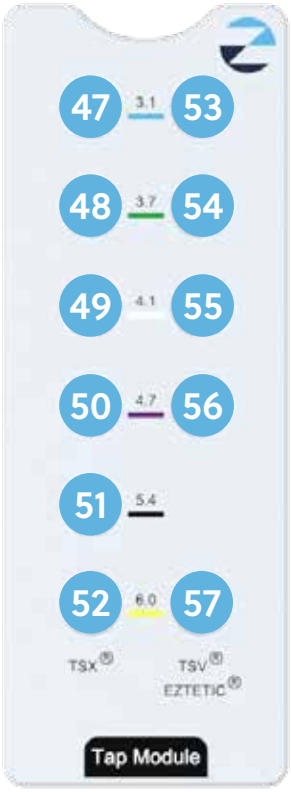

47

TSXTAP31
3,1 mm (D)
Formador de rosca TSX

48

TSXTAP37
3,7 mm (D)
Formador de rosca TSX

49

TSXTAP41
4,1 mm (D)
Formador de rosca TSX

50

TSXTAP47
4,7 mm (D)
Formador de rosca TSX

51

TSXTAP54
5,4 mm (D)
Formador de rosca TSX

52

TSXTAP60
6,0 mm (D)
Formador de rosca TSX

53

ZOPTT30
3,0 mm (D)
Formador de rosca Eztetic

54

TT3.7
3,7 mm (D)
Formador de rosca TSV

55

TT4.1
4,1 mm (D)
Formador de rosca TSV

56

TT4.7
4,7 mm (D)
Formador de rosca TSV

57

TT6.0
6,0 mm (D)
Formador de rosca TSV

Módulo de restauração de arcada completa **(TSXRESTOR)**

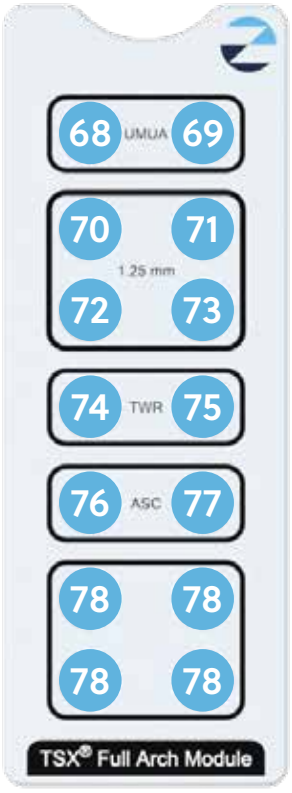

68

UMUA-D
Chave para várias unidades universal

69

ISO4X4A
Porta implantes contra-ângulo 4x4

70

HXGR1.25
Chave hexagonal GemLock de 1,25 mm, curta

71

HXLGR1.25
Chave hexagonal GemLock de 1,25 mm, longa

72

HX1.25D
1,25 mm
Chave hexagonal, contra-ângulo, curta

73

HXL1.25D
1,25 mm
Chave hexagonal, contra-ângulo, longa

74

TW1.25
1,25 mm
Chave de torque hexagonal, curta

75

TW1.25L
1,25 mm
Chave de torque hexagonal, longa

76

ASC-SD24
Chave de parafusos com canal de parafuso angulado, 24 mm (C)

77

ASC-SD30
Chave de parafusos com canal de parafuso angulado, 30 mm (C)

78

Anilha vazia

Módulo de perfiladores ósseos **(TSXBPRO)**

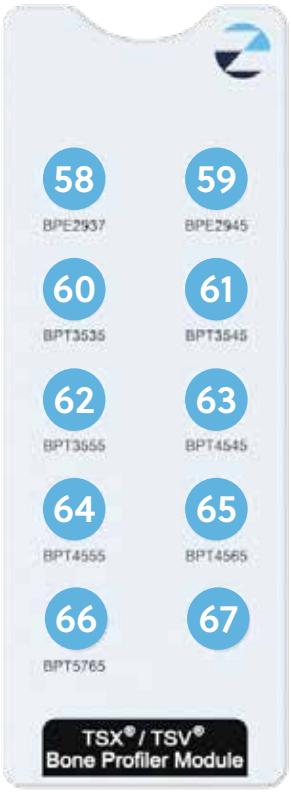

58
BPE2937
Perfiladores ósseos NP de 2,9 mm (D) x 3,7 mm (P)

59
BPE2945
Perfiladores ósseos NP de 2,9 mm (D) x 4,5 mm (P)

60
BPT3535
Perfiladores ósseos de 3,5 mm (D) x 3,5 mm (P)

61
BPT3545
Perfiladores ósseos de 3,5 mm (D) x 4,5 mm (P)

62
BPT3555
Perfiladores ósseos de 3,5 mm (D) x 5,5 mm (P)

63
BPT4545
Perfiladores ósseos de 4,5 mm (D) x 4,5 mm (P)

64
BPT4555
Perfiladores ósseos de 4,5 mm (D) x 5,5 mm (P)

65
BPT4565
Perfiladores ósseos de 4,5 mm (D) x 6,5 mm (P)

66
BPT5765
Perfiladores ósseos de 5,7 mm (D) x 6,5 mm (P)

67
Anilha vazia

81
UNPMODTRAY
Tabuleiro modular, vazio, contém com segurança instrumentos com fecho (adquirido em separado)

Módulo de chave de torque restauradora **(TSXRESTORTW)**

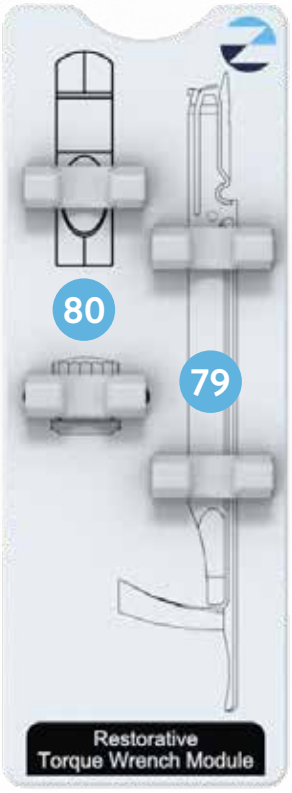

79
L-TIRW
Chave de roquete indicadora de torque reduzido (inclui adaptador de contra-ângulo C9980)

80
TWR*
Chave de torque, restauração

*** NOTA:** O TWR está incluído no módulo preenchido TSXRESTORTW e pode ser opcionalmente armazenado nos dois suportes de silicone esquerdos com a numeração 80. Siga as instruções de esterilização do fabricante para TWR.

Sistema de kit cirúrgico modular TSX para implantes TSX

Informações para encomendas

		TSXKIT | Kit cirúrgico TSX	
		TSXSTRKIT | Kit cirúrgico inicial TSX	
Descrição	**N.º do artigo**		
Tabuleiro cirúrgico TSX para módulo de brocas e ferramentas, com tampa e base (vazio)	TSXTRAY	•	•
Broca esférica de 2,0 mm (D)	1203G		•
Broca piloto cónica de 2,1/1,6 mm (D), 8,0 mm - 11,5 mm (C)	0201G	•	•
Extensor de broca	DEG	•	•
Ferramenta de remoção para pilares NP	CLRT2		•
Ferramenta de remoção para pilares hexagonais internos	TLRT2	•	•
Paralelizador (Qtd. 4)	PPAR	•	•
Broca escalonada de 2,8/2,4 mm (D), 22 mm (C)	EZT28D24G		•
Broca de 2,4 mm (D), 22 mm (C)	EZT24G		•
Broca de 2,3 mm (D), 16 mm (C)	TSV23SG	•	•
Broca de 2,8 mm (D), 16 mm (C)	TSV28SG	•	•
Broca escalonada de 3,4/2,8 mm (D), 16 mm (C)	TSV34D28SG	•	•
Broca de 3,4 mm (D), 16 mm (C)	TSV34SG	•	•
Broca escalonada de 3,8/3,4 mm (D), 16 mm (C)	TSV38D34SG	•	•
Broca de 3,8 mm (D), 16 mm (C)	TSV38SG	•	•
Broca escalonada de 4,4/3,8 mm (D), 16 mm (C)	TSV44D38SG	•	•
Broca de 4,4 mm (D), 16 mm (C)	TSV44SG		•
Broca escalonada de 5,1/4,4 mm (D), 16 mm (C)	TSV51D44SG		•
Broca de 5,5 mm (D), 16 mm (C)	TSV51SG		•
Broca escalonada de 5,7/5,1 mm (D), 16 mm (C)	TSV57D51SG		•
Broca de 2,3 mm (D), 22 mm (C)	TSV23G	•	•
Broca de 2,8 mm (D), 22 mm (C)	TSV28G	•	•
Broca escalonada de 3,4/2,8 MM (D), 22 mm (C)	TSV34D28G	•	•
Broca de 3,4 mm (D), 22 mm (C)	TSV34G	•	•
Broca escalonada de 3,8/3,4 mm (D), 22 mm (C)	TSV38D34G	•	•
Broca de 3,8 mm (D), 22 mm (C)	TSV38G	•	•
Broca escalonada de 4,4/3,8 mm (D), 22 mm (C)	TSV44D38G	•	•
Broca de 4,4 mm (D), 22 mm (C)	TSV44G		•
Broca escalonada de 5,1/4,4 mm (D), 22 mm (C)	TSV51D44G		•
Broca de 5,1 mm (D), 22 mm (C)	TSV51G		•
Broca escalonada de 5,7/5,1 mm (D), 22 mm (C)	TSV57D51G		•
Chave de roquete indicadora de torque elevado (0-90 Ncm)	ZTIRW	•	•
Chave hexagonal com encaixe de contra-ângulo GemLock de 2,5 mm (D), curta	GHX2.5D	•	•
Chave hexagonal com encaixe de contra-ângulo GemLock de 2,5 mm (D), longa	GHX2.5DL	•	•
Chave hexagonal manual GemLock de 2,5 mm (D), curta	GHX2.5	•	•
Chave hexagonal manual GemLock de 2,5 mm (D), longa	GHX2.5L	•	•
Chave hexagonal de 1,25 mm (D), encaixe de contra-ângulo, curta	HX1.25D	•	•
Chave hexagonal GemLock de 1,25 mm (D), longa	HXLGR1.25	•	•
Chave hexagonal GemLock de 1,25 mm (D), curta	HXGR1.25	•	•
Chave hexagonal GemLock de 2,1 mm (D), encaixe de contra-ângulo, curta	CHD2.1		•
Chave hexagonal GemLock de 2,1 mm (D), encaixe de contra-ângulo, longa	CHDL2.1		•
Chave hexagonal GemLock de 2,1 mm (D), curta	CHR2.1		•
Chave hexagonal GemLock de 2,1 mm (D), longa	CHRL2.1		•

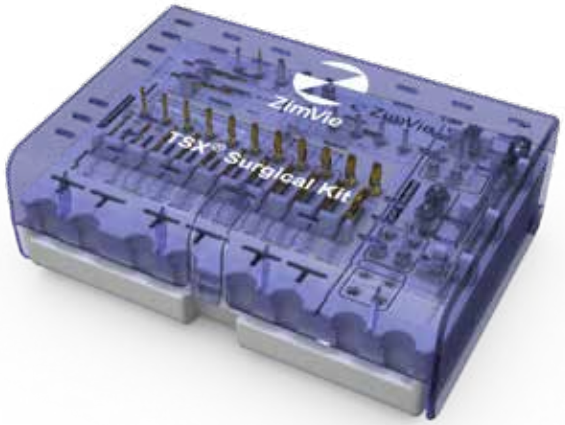

*As chaves hexagonais de 3,0 mm (D) não são utilizadas com o implante TSX.
O ponto indica que o item está incluído no pacote modular preenchido.

Kit TSX, configurações modulares

Módulo de formador de rosca

	TAPMOD | Módulo de formador de rosca TSX	TSXTAPMOD | Módulo de formador de rosca TSX para implantes TSX	TSVTAPMOD | Módulo de formador de rosca TSX para implantes TSV e Eztetic
Descrição	**N.º do artigo**		
Tabuleiro do módulo de formador de rosca TSX (vazio)	**TAPTRAY**	•	•	•
Formador de rosca TSX de 3,1 mm (D)	**TSXTAP31**		•	•
Formador de rosca TSX de 3,7 mm (D)	**TSXTAP37**		•	•
Formador de rosca TSX de 4,1 mm (D)	**TSXTAP41**		•	•
Formador de rosca TSX de 4,7 mm (D)	**TSXTAP47**		•	•
Formador de rosca TSX de 5,4 mm (D)	**TSXTAP54**		•	•
Formador de rosca TSX de 6,0 mm (D)	**TSXTAP60**		•	•
Formador de rosca óssea Eztetic de 3,0 mm (D)	**ZOPTT30**	•		•
Formador de rosca óssea TSV de 3,7 mm (D)	**TT3.7**	•		•
Formador de rosca óssea TSV de 4,1 mm (D)	**TT4.1**	•		•
Formador de rosca óssea TSV de 4,7 mm (D)	**TT4.7**	•		•
Formador de rosca óssea TSV de 6,0 mm (D)	**TT6.0**	•		•

Módulo de perfiladores ósseos TSX

Número do artigo	Módulo/Ferramentas	Descrição
TSXBPRO	**Módulo de perfiladores ósseos TSX** para implantes TSX, TSV e Eztetic	Inclui tabuleiro para perfiladores ósseos [TSXBPROTRAY] e criadores de perfis ósseos para implantes TSX, TSV e Eztetic
TSXBPROTRAY	**Módulo de perfiladores ósseos TSX**	Tabuleiro (vazio)
BPE2937	**Perfilador ósseo NP**	2,9 mm (D) x 3,7 mm (P)
BPE2945	**Perfilador ósseo NP**	2,9 mm (D) x 4,5 mm (P)
BPT3535	**Perfilador ósseo**	3,5 mm (D) x 3,5 mm (P)
BPT3545	**Perfilador ósseo**	3,5 mm (D) x 4,5 mm (P)
BPT3555	**Perfilador ósseo**	3,5 mm (D) x 5,5 mm (P)
BPT4545	**Perfilador ósseo**	4,5 mm (D) x 4,5 mm (P)
BPT4555	**Perfilador ósseo**	4,5 mm (D) x 5,5 mm (P)
BPT4565	**Perfilador ósseo**	4,5 mm (D) x 6,5 mm (P)
BPT5765	**Perfilador ósseo**	5,7 mm (D) x 6,5 mm (P)

Módulo de arco completo TSX

Número do artigo	Módulo/Ferramentas	Descrição
TSXRESTOR	**Módulo de arco completo TSX** com instrumentos	Inclui tabuleiro de arco completo [TSXRESORTRAY] e instrumentos para colocação na clínica de pilares universais de restaurações múltiplas e Ti-bases nos implantes TSX, TSV e Eztetic
TSXRESTORTRAY	**Módulo de arco completo TSX**	Tabuleiro (vazio)
UMUA-D	**Chave para várias unidades universal**	Utilizado com chave de torque TWR para apertar pilares UMUA retos
ISO4X4A	**Adaptador de chave de bloqueio ISO**	Utilizado com a chave de torque L-TIRW para apertar pilares UMUA
HXGR1.25	**Chave hexagonal GemLock**	Curto, 1,25 mm (D)
HXLGR1.25	**Chave hexagonal GemLock**	Longo, 1,25 mm (D)
HX1.25D	**Chave hexagonal, com encaixe contra-ângulo**	Curto, 1,25 mm (D)
HXL1.25D	**Chave hexagonal, com encaixe contra-ângulo**	Longo, 1,25 mm (D)
TW1.25	**Ponta para chave de torque hexagonal**	Curto, 1,25 mm (D), utilizada com a chave de torque TWR
TW1.25L	**Ponta para chave de torque hexagonal**	Longo, 1,25 mm (D), utilizado com chave de torque TWR
ASC-SD24	**Chave de parafusos com canal de parafuso angulado**	24 mm (C), aperta o canal de parafuso angulado Ti-base
ASC-SD30	**Chave de parafusos com canal de parafuso angulado**	30 mm (C), aperta o canal de parafuso angulado Ti-base

Módulo de chave de torque restauradora TSX

Número do artigo	Módulo/Ferramentas	Descrição
TSXRESTORTW	**Módulo de chave de torque restauradora TSX** com instrumentos	Inclui tabuleiro de chaves de torque restauradora [TSXRESOTRTWTRAY], L-TIRW e chaves de torque restaurativas TWR
TSXRESTORTWTRAY	**Módulo de chave de torque restauradora TSX**	Tabuleiro (vazio)
L-TIRW	**Chave de roquete indicadora de baixo torque**	Inclui adaptador de bloqueio C9980, utilizado com chaves de ligação de bloqueio
TWR	**Chave de torque**	Utilizado com chaves TW1.25 e TW1.25L

Preferências modulares pessoais
Informações para encomendas

Kit cirúrgico e módulos TSX

Número do artigo	Kit cirúrgico	Descrição
TSXKIT	**Kit cirúrgico TSX** para implantes TSX, TSV e Eztetic	Inclui tabuleiro cirúrgico [TSXTRAY], módulo de broca e módulo de ferramentas, com instrumentos para colocar implantes TSX de 3,1 mm (D), 3,7 mm (D), 4,1 mm (D), 4,7 mm (D), 5,4 mm (D) e 6,0 mm (D), implantes TSV de 3,7 mm (D), 4,1 mm (D), 4,7 mm (D) e 6,0 mm (D) e implantes Eztetic de 3,1 mm (D)
TSXSTRKIT	**Kit cirúrgico inicial TSX** para implantes TSX e TSV	Inclui tabuleiro cirúrgico [TSXTRAY], módulo de brocas e módulo de ferramentas com instrumentos para implantes TSX e TSV de 3,7 mm (D), 4,1 mm (D) e 4,7 mm (D)
TAPMOD	**Módulo de formador de rosca TSX** para implantes TSX, TSV e Eztetic	Inclui tabuleiro de formador de rosca [TAPTRAY] e formador de rosca ósseo TSX, TSV e Eztetic
TSXTAPMOD	**Módulo de formador de rosca TSX** para implantes TSX	Inclui tabuleiro de formador de rosca [TAPTRAY] e formadores de rosca ósseas TSX
TSVTAPMOD	**Módulo de formador de rosca TSX** para implantes TSV e Eztetic	Inclui tabuleiro de formador de rosca [TAPTRAY]; formador de rosca TSV e Eztetic
TSXBPRO	**Módulo de perfiladores ósseos TSX** para implantes TSX, TSV e Eztetic	Inclui tabuleiro para perfiladores ósseos [TSXBPROTRAY] e criadores de perfis ósseos para implantes TSX, TSV e Eztetic
TSXRESTOR	**Módulo de arco completo TSX**	Inclui tabuleiro de arco completo [TSXRESORTRAY] e instrumentos para colocação na clínica de pilares universais de restaurações múltiplas e Ti-bases nos implantes TSX, TSV e Eztetic
TSXRESTORTW	**Módulo de chave de torque restauradora TSX**	Inclui tabuleiro de chave de torque restauradora [TSXRESOTRTWTRAY]; chaves de torque restauradoras L-TIRW e TWR
TSXTRAY	**Tabuleiro cirúrgico TSX**	Tabuleiros de módulos de brocas e ferramentas com tampa e base (vazios)
TAPTRAY	**Módulo de formador de rosca TSX**	Tabuleiro do módulo de formador de rosca (vazio)
TSXBPROTRAY	**Módulo de perfiladores ósseos TSX**	Tabuleiro de perfiladores ósseos (vazio)
TSXRESTORTRAY	**Módulo de arco completo TSX**	Arco completo (vazio)
TSXRESTORTWTRAY	**Módulo de chave de torque restauradora TSX**	Chave de torque restauradora (vazia)
UNPMODTRAY	**Tabuleiro modular**	Tabuleiro (vazio), suporta com segurança instrumentos com fecho ISO

Brocas cirúrgicas Dríva da série Gold

Brocas piloto cónicas

Diâmetro	15 mm (C)*	16 mm (C)*	19 mm (C)	22 mm (C)*	25 mm (C)
2,1/1,6 mm (D)	0201G	—	—	—	—

Brocas cirúrgicas Dríva

Diâmetro	15 mm (C)*	16 mm (C)*	19 mm (C)	22 mm (C)*	25 mm (C)
2,3 mm (D)	—	TSV23SG	STR23D19	TSV23G	STR23D25
2,4 mm (D)	—	—	—	EZT24G	—
2,8 mm (D)	—	TSV28SG	STR28D19	TSV28G	STR28D25
3,4 mm (D)	—	TSV34SG	STR34D19	TSV34G	STR34D25
3,8 mm (D)	—	TSV38SG	STR38D19	TSV38G	STR38D25
5,1 mm (D)	—	TSV51SG	—	TSV51G	—

Brocas escalonadas cirúrgicas Dríva

Diâmetro	16 mm (C)*	19 mm (C)	22 mm (C)*	25 mm (C)	Código de cores
2,8/2,4 mm (D)	—	—	EZT28D24G	—	Azul
3,4/2,8 mm (D)	TSV34D28SG	STP34D19	TSV34D28G	STP34D25	Verde
3,8/3,4 mm (D)	TSV38D34SG	STP38D19	TSV38D34G	STP38D25	Branco
4,4/3,8 mm (D)	TSV44D38SG	STP44D19	TSV44D38G	STP44D25	Roxo
5,1/4,4 mm (D)	TSV51D44SG**	—	TSV51D44G**	—	—
5,7/5,1 mm (D)	TSV57D51SG	—	TSV57D51G	—	Amarelo

*As brocas de 15 mm (C), 16 mm (C) e 22 mm (C) apresentam riscas axiais para ajudar na sua rápida identificação no kit Drill Stop.
**A TSV51D44SG e a TSV51D44G são as brocas finais para o implante TSX de 5,4 mm (D) em osso tipo I, são brocas intercalares opcionais na sequência de perfuração de 6,0 mm (D) e são vendidas em separado, não estando incluídas em kits cirúrgicos.

As marcações de profundidade são mecanizadas e gravadas a laser para uma maior visibilidade. As bandas estão posicionadas aproximadamente a 1,25 mm da junção implante-pilar. (Por exemplo: a banda de 13 mm está posicionada a 14,25 mm da ponta da broca).

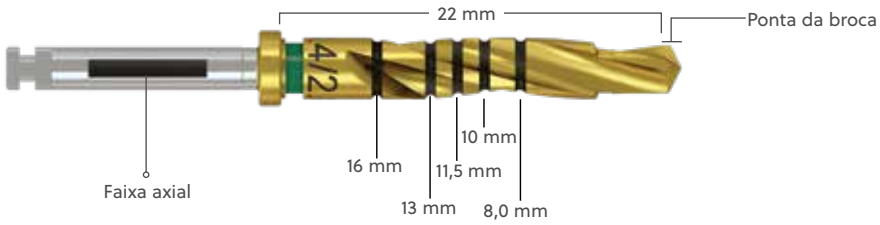

Brocas de utilização única por paciente

Descrição	Qtd.	N.º do item
Kit de broca, para um único paciente, implante longo de 3,7 mm (D), 17 mm (C)	Broca esférica Broca piloto de 2,3 mm (D) Broca escalonada de 3,4/2,8 mm (D)	DSTK3
Kit de broca, para um único paciente, implante curto de 3,7 mm (D), 11 mm (C)	Broca esférica Broca piloto de 2,3 mm (D) Broca escalonada de 3,4/2,8 mm (D)	DSTK3S
Broca, para um único paciente, implante longo de 4,7 mm (D), 17 mm (C)	Broca escalonada de 4,4/3,8 mm (D)	DST4
Broca, para um único paciente, implante curto de 4,7 mm (D), 11 mm (C)	Broca escalonada de 4,4/3,8 mm (D)	DST4S
Broca, para um único paciente, implante longo de 6,0 mm (D), 17 mm (C)	Broca escalonada de 5,7/5,1 mm (D)	DST6
Broca, para um único paciente, implante curto de 6,0 mm (D), 11 mm (C)	Broca escalonada de 5,7/5,1 mm (D)	DST6S

Nota: sem irrigação interna. Os kits com brocas longas têm marcações de profundidade para implantes de 8, 10, 11,5, 13 e 16 mm (C). Os kits com brocas curtas têm marcações de profundidade para implantes de 8 e 10 mm (C).

Instrumentos para colocação de implantes

Descrição	N.º do item	
Chave de catraca indicadora de alto torque	ZTIRW	
Chave de catraca com encaixe quadrado GemLock	RSR	
Cabo de chave em aço inoxidável	SSHS	

Chaves hexagonais de 1,25 mm (D)

Descrição	Modo de utilização	N.º do item	
Chave hexagonal, curta, para apertar parafusos cirúrgicos e protéticos, 17 mm (C)	Manual	HXGR1.25	
Chave hexagonal, longa, para apertar parafusos cirúrgicos e protéticos, 22 mm (C)	Manual	HXLGR1.25	
Chave hexagonal, curta, com retenção GemLock, 22 mm (C)	Redutor, L-TIRW	HX1.25D	
Chave hexagonal, longa, com retenção GemLock, 30 mm (C)	Redutor, L-TIRW	HXL1.25D	
Chave hexagonal para contra-ângulo para parafusos cirúrgicos e protéticos, curta, 23 mm (C) Poderá necessitar de redutor	RSR	HX1.25	
Chave hexagonal para contra-ângulo para parafusos cirúrgicos e protéticos, longa, 26 mm (C) Poderá necessitar de redutor	RSR	HXL1.25	

Chaves hexagonais de 2,1 mm (D) para a colocação de implantes TSX de 3,1 mm (D)

Descrição	Modo de utilização	N.º do item
Broca hexagonal GemLock de 2,1 mm, parafuso de fecho, curta	ZTIRW, RSR, SSHS	CHR2.1
Broca hexagonal GemLock de 2,1 mm, parafuso de fecho, longa	ZTIRW, RSR, SSHS	CHRL2.1
Chave hexagonal GemLock de 2,1 mm, catraca	Redutor	CHD2.1
Chave hexagonal GemLock de 2,1 mm, catraca	Redutor	CHDL2.1

Chaves hexagonais de 2,5 mm (D) para a colocação de implantes TSX de 3,7 a 6,0 mm (D)

Descrição	Modo de utilização	N.º do item
Chave hexagonal com retenção GemLock de 2,5 mm, curta, 17 mm (C)	ZTIRW, RSR, SSHS	RH2.5
Chave hexagonal com retenção GemLock de 2,5 mm (D), longa, 21 mm (C)	ZTIRW, RSR, SSHS	RHL2.5
Broca hexagonal com retenção GemLock de 2,5 mm, contra-ângulo, 28 mm (C)	Redutor	RHD2.5

Instrumentos cirúrgicos

Descrição	N.º do item
Extensor de broca	DEG
Paralelizador	PPAR
Broca esférica	1203G
Ferramentas de remoção para implantes de tipo parafuso, aço de carbono Nota: não autoclavar	IRT

Instrumentos para cirurgia guiada

Os implantes TSX podem ser colocados de forma totalmente guiada utilizando o kit de cirurgia guiada RealGUIDE® Z3D™ e os instrumentos apresentados nas páginas 31-32. Pode encontrar informações sobre o módulo cirúrgico parcialmente guiado para TSVKITG na página 33.

Kit de cirurgia totalmente guiada RealGUIDE Z3D*

Produto	N.º do item
Kit cirúrgico RealGUIDE Z3D (totalmente carregado)	3DM0070Z
Kit autoclavável RealGUIDE Z3D Box	3DM0070ZUS

*Não aprovado em todos os mercados.

Configuração

Produto	N.º do item	
Broca para pino de fixação Máx. 1000 rpm, em aço inoxidável endurecido AISI 420B com revestimento DLC	3DM00610Z	
Pino de fixação TiAl6V4 ASTM F136	3DM00609Z	
Extensão de chave de torque Máx. 50 Ncm, em aço inoxidável endurecido AISI 420F MOD	3DM00623Z	
Conetor quadrado 4 × 4 para redutor Máx. 50 Ncm, em aço inoxidável endurecido AISI 420F MOD	3DM00612Z	
Medidor de abertura de boca/medidor de mordida Aço inoxidável endurecido AISI 303	3DM00622Z	
Mucótomo/bisturi circular Diâmetro interno: 4,2 mm, máx. 100 rpm, Aço inoxidável endurecido AISI 420F MOD com revestimento DLC	3DM00607Z	
Nivelador de crista óssea Máx. 600 rpm, em aço inoxidável endurecido AISI 420B com revestimento DLC	3DM00614Z	
Broca inicial Broca de preparação do local do implante, máx. 600 rpm, Aço inoxidável endurecido AISI 420B com revestimento DLC	3DM00621Z	
Broca 2,4 × 6 mm (D) Máx. 800 rpm, em aço inoxidável endurecido AISI 420B com revestimento DLC	3DM00619Z	

Componentes do kit RealGUIDE Z3D totalmente guiado

Suportes de implantes RealGUIDE Z3D (aço inoxidável endurecido AISI 420F MOD)

Produto	N.º do item	
TSX/Eztetic de 3,1 mm (D) ZimVie Incl. parafuso, máx. 20 rpm, 50 Ncm	3DM00606ZIM31	
TSX de 3,7/4,1/4,7 mm (D) ZimVie, TSV de 3,7/4,1 mm (D) ZimVie Incl. parafuso, máx. 20 rpm, 50 Ncm	3DM00606ZIM35	
TSV de 4,7 mm (D) ZimVie Incl. parafuso, máx. 20 rpm, 50 Ncm	3DM00606ZIM47	

Brocas RealGUIDE Z3D (aço inoxidável endurecido AISI 420B com revestimento DLC)

Comprimento	Broca 2,4 mm (D)	Broca de diâmetro duplo 2,8/2,4 mm (D)	Broca de diâmetro duplo 3,4/2,8 mm (D)	Broca de diâmetro duplo 3,8/3,4 mm (D)	Broca de diâmetro duplo 4,4/3,8 mm (D)
			Máx. 800 rpm		
8 mm	3DM00613.24.080Z	3DM00613.28.080Z	3DM00613.34.080Z	3DM00613.38.080Z	3DM00613.44.080Z
10 mm	3DM00613.24.100Z	3DM00613.28.100Z	3DM00613.34.100Z	3DM00613.38.100Z	3DM00613.44.100Z
11,5 mm	3DM00613.24.115Z	3DM00613.28.115Z	3DM00613.34.115Z	3DM00613.38.115Z	3DM00613.44.115Z
13 mm	3DM00613.24.130Z	3DM00613.28.130Z	3DM00613.34.130Z	3DM00613.38.130Z	3DM00613.44.130Z
16 mm	3DM00613.24.160Z	3DM00613.28.160Z	3DM00613.34.160Z	3DM00613.38.160Z	3DM00613.44.160Z

Acessórios RealGUIDE Z3D

Produto	N.º do item
Manga de guia cirúrgica Procedimento RealGUIDE CAD de 5,05 mm, compatível com 3DM RealGUIDE, kit ZimVie RealGUIDE Z3D, kit Nobel RP (10 unidades)	3DM00670
Manga de fixação do pino da guia cirúrgica Procedimento RealGUIDE CAD (10 unidades)	3DM00671

Instrumentos para cirurgia parcialmente guiada

Descrição	N.º do item
Módulo de brocas para cirurgia guiada Pode ser inserido num TSVKITG para um kit tudo em um destinado a cirurgia guiada	GSMOD
Broca cirúrgica EG Dríva de 2,3 mm (D), 19 mm (C)	STR23D19
Broca cirúrgica EG Dríva de 2,3 mm (D), 25 mm (C)	STR23D25
Broca escalonada cirúrgica EG Dríva de 2,8/2,4 mm (D), 19 mm (C)	STP28D19
Broca escalonada cirúrgica EG Dríva de 2,8/2,4 mm (D), 25 mm (C)	STP28D25
Broca cirúrgica EG Dríva de 2,8 mm (D), 19 mm (C)	STR28D19
Broca cirúrgica EG Dríva de 2,8 mm (D), 25 mm (C)	STR28D25
Broca escalonada cirúrgica EG Dríva de 3,4/2,8 mm (D), 19 mm (C)	STP34D19
Broca escalonada cirúrgica EG Dríva de 3,4/2,8 mm (D), 25 mm (C)	STP34D25
Broca cirúrgica EG Dríva de 3,4 mm (D), 19 mm (C)	STR34D19
Broca cirúrgica EG Dríva de 3,4 mm (D), 25 mm (C)	STR34D25
Broca escalonada cirúrgica EG Dríva de 3,8/3,4 mm (D), 19 mm (C)	STP38D19
Broca escalonada cirúrgica EG Dríva de 3,8/3,4 mm (D), 25 mm (C)	STP38D25
Broca cirúrgica EG Dríva de 3,8 mm (D), 19 mm (C)	STR38D19
Broca cirúrgica EG Dríva de 3,8 mm (D), 25 mm (C)	STR38D25
Broca escalonada cirúrgica EG Dríva de 4,4/3,8 mm (D), 19 mm (C)	STP44D19
Broca escalonada cirúrgica EG Dríva de 4,4/3,8 mm (D), 25 mm (C)	STP44D25
Inserto do módulo de cirurgia guiada (vazio)	GSTRAY
Kit de adaptadores de tubos* Inclui 1 de cada adaptador de tubos listado abaixo; As brocas EG são utilizadas com o kit de adaptadores de tubos;	TADKIT
Adaptador de tubos de 2,3 mm (D), A	TAD23A
Adaptador de tubos de 2,8 mm (D), A	TAD28A
Adaptador de tubos de 3,4 mm (D), A	TAD34A
Adaptador de tubos de 2,3 mm (D), B	TAD23B
Adaptador de tubos de 2,8 mm (D), B	TAD28B
Adaptador de tubos de 3,4 mm (D), B	TAD34B
Adaptador de tubos de 3,8 mm (D), B	TAD38B
Adaptador de tubos de 4,4 mm (D), B	TAD44B

*Para utilização com brocas Dríva e Dríva EG com risca axial.

Kit Drill Stop*

Descrição	N.º do item
Kit Drill Stop completo (brocas não incluídas)	DSKIT
Conjunto de drill stops, implante de 8,0 mm (C), Broca Dríva de 2,3-4,4/3,8 mm (D) x 17/22 mm (C) (Qtd. 5)	SS8D22
Conjunto de drill stops, implante de 10 mm (C), Broca Dríva de 2,3-4,4/3,8 mm (D) x 17/22 mm (C) (Qtd. 5)	SS10D22
Conjunto de drill stops, implante de 11,5 mm (C), Broca Dríva de 2,3-4,4/3,8 mm (D) x 17/22 mm (C) (Qtd. 5)	SS11D22
Conjunto de drill stops, implante de 13 mm (C), Broca Dríva de 2,3-4,4/3,8 mm (D) x 17/22 mm (C) (Qtd. 5)	SS13D22
Conjunto de drill stops, implante de 8 mm (C), Broca Dríva de 2,3-4,4/3,8 mm (D) x 11/16 mm (C) (Qtd. 5)	SS8D16
Conjunto de drill stops, implante de 10 mm (C) – Broca Dríva de 11/16 mm (C) e implante de 16 mm (C) – Broca Dríva de 17/22 mm (C), Broca Dríva de 2,3-4,4/3,8 mm (D) (Qtd. 5)	SS10D16
Conjunto de drill stops, implante de 11,5 mm (C), Broca Dríva de 2,3-4,4/3,8 mm (D) x 11/16 mm (C) (Qtd. 5)	SS11D16
Conjunto de drill stops, implante de 8-16 mm (C), Broca Dríva de 5,1 mm (D) x 11/16 mm (C) e 17/22 mm (C) (Qtd. 7)	SS51D
Conjunto de drill stops, implante de 8-16 mm (C), Broca Dríva de 5,7/5,1 mm (D) x 11/16 mm (C) e 17/22 mm (C) (Qtd. 7)	SS57D
Multi-chave para drill stops	MTL

Perfiladores ósseos

Perfiladores ósseos para pilares de cicatrização Encode®

Plataforma de restauração	Perfil de emergência	Pilar de cicatrização TSV Encode	Conexão TSV
3,5 mm	3,8 mm	TEHA3383/TEEHA333	BPT3545
		TEHA3385/TEEHA335	
		TEHA3387/TEEHA337	
	5,0 mm	TEHA3503/TEEHA353	BPT3555
		TEHA3505/TEEHA355	
4,5 mm	5,0 mm	TEHA4503	BPT4555
		TEHA4505	
	5,6 mm	TEHA4563/TEEHA453	BPT4565
		TEHA4565/TEEHA455	
		TEHA4567/TEEHA457	
	6,0 mm	TEHA4603/TEEHA463	BPT4565
		TEHA4605/TEEHA465	

Perfiladores ósseos para implantes TSX

Plataforma de restauração	Perfil de emergência	Conexão Eztetic
2,9 mm	3,7 mm	BPE2937
	4,5 mm	BPE2945

Perfiladores ósseos para implantes TSX

Plataforma de restauração	Perfil de emergência	Conexão TSV
3,5 mm	3,7 mm	BPT3535
	4,5 mm	BPT3545
	5,5 mm	BPT3555
4,5 mm	4,5 mm	BPT4545
	5,5 mm	BPT4555
	6,5 mm	BPT4565

Nota: pode ser utilizado para pilares cónicos

Notas

Para obter mais informações, visite ZimVie.eu

ZimVie US Corp LLC
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Phone: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272
dentalCS@ZimVie.com

ZimVie Spain S.L.U.
WTC Almeda Park, Ed. 4, Pl. 2
C/Tirso de Molina, 40 (entrada Plaça de la Pau)
08940, Cornellà de Llobregat, Espanha
Atención al cliente: 800-827-836
Fax para pedidos: +34-93-445-81-36
ZV.pedidos@ZimVie.com

Salvo indicação em contrário, conforme aqui mencionado, todas as marcas comerciais e os direitos de propriedade intelectual são propriedade da ZimVie Inc. ou de uma afiliada, e todos os produtos são fabricados por uma ou mais subsidiárias da divisão de medicina dentária da ZimVie US Corp LLC (Biomet 3i, LLC, etc.) e comercializados e distribuídos pela ZimVie US Corp LLC e pelos seus parceiros de comercialização autorizados. Os análogos de implante digitais, os pilares universais de restaurações de várias unidades e os pilares OverdenSURE são fabricados pela Terrats Medical S.L. ZTIRW A chave de roquete indicadora de torque elevado e a chave de roquete indicadora de torque baixo L-TIRW são fabricadas pela Elos Medtech Pinol A/S. Os instrumentos RealGUIDE Z3D são fabricados pela Biomec S.r.l., à exceção dos artigos 3DM0070ZUS, 3DM00670 e 3DM00671, os quais são fabricados pela 3DIEMME S.r.l. Classificação da UE relativa a dispositivos médicos: Pilares e moldeiras dentários (Classe IIb), análogos dentários (Classe I), ferramentas dentárias (Classe IIa), scanbody dentário (Classe I), pilar de cicatrização dentário (Classe IIb). Implantes dentários (Classe IIb), tampas de impressão (Classe Is). A finalidade prevista dos pilares e moldeiras dentários é restaurar implantes, a dos análogos dentários é replicar o implante num modelo de laboratório, a das ferramentas dentárias é colocar componentes, a do scanbody dentário é digitalizar casos de implantes, a do pilar de cicatrização dentário é moldar o tecido mole durante a cicatrização do implante. Os implantes dentários destinam-se a substituir dentes em falta ou arcos dentários edêntulos, fornecendo um componente de encaixe protético. As tampas de impressão destinam-se a facilitar a referência posicional de um pilar. Os produtos aqui apresentados não são elegíveis para reembolso em França. Para outros países, consulte as leis e os regulamentos locais. Para obter informações adicionais sobre os produtos, consulte os rótulos individuais do produto ou as instruções de utilização. Os produtos podem não estar disponíveis ou autorizados em determinados países/regiões. Este material destina-se apenas a profissionais médicos e não constitui parecer ou recomendações médicas. É proibida a distribuição a qualquer outro destinatário. Este material não pode ser copiado nem reproduzido sem o expresso consentimento escrito da ZimVie. ZVINST0037-EMEA-PT REV F 05/26 ©2026 ZimVie. Todos os direitos reservados.

O número do ON aplicável a cada dispositivo pode ser encontrado na rotulagem do produto, se aplicável.

CE 2797 CE 0051 CE