Kit Cirúrgico e Módulos T3® PRO Immediate Molar

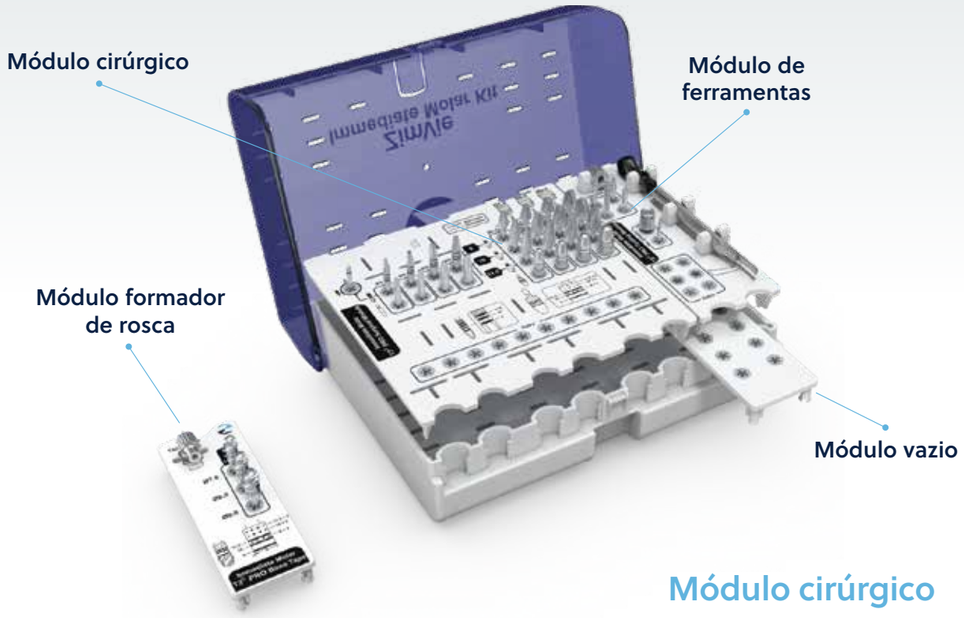

Módulo cirúrgico

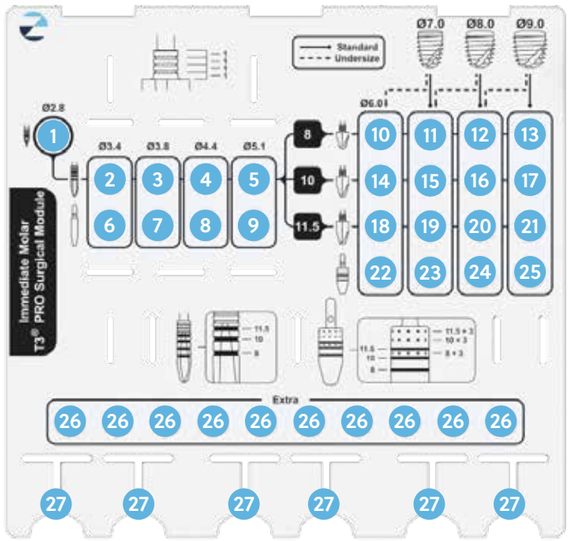

1 **IMDR28L** Broca inicial com ponta, 2,8 mm (D), longa

2 **IMDR34T3P** Broca cónica T3 PRO 3,4 mm (D)

3 **IMDR38T3P** Broca cónica T3 PRO 3,8 mm (D)

4 **IMDR44T3P** Broca cónica T3 PRO 4,4 mm (D)

5 **IMDR51T3P** Broca cónica T3 PRO 5,1 mm (D)

6 **IMDIR34** Indicador de direção 3,4 mm (D)

7 **IMDIR38** Indicador de direção 3,8 mm (D)

8 **IMDIR44** Indicador de direção 4,4 mm (D)

9 **IMDIR51** Indicador de direção 5,1 mm (D)

10 **IMDR68** Broca de modelação de 6 mm (D), 8 mm (C)

11 **IMDR78** Broca de modelação de 7 mm (D), 8 mm (C)

12 **IMDR88** Broca de modelação de 8 mm (D), 8 mm (C)

13 **IMDR98** Broca de modelação de 9 mm (D), 8 mm (C)

14 **IMDR610** Broca de modelação de 6 mm (D), 10 mm (C)

15 **IMDR710** Broca de modelação de 7 mm (D), 10 mm (C)

16 **IMDR810** Broca de modelação de 8 mm (D), 10 mm (C)

17 **IMDR910** Broca de modelação de 9 mm (D), 10 mm (C)

18 **IMDR611** Broca de modelação de 6 mm (D), 11,5 mm (C)

19 **IMDR711** Broca de modelação de 7 mm (D), 11,5 mm (C)

20 **IMDR811** Broca de modelação de 8 mm (D), 11,5 mm (C)

21 **IMDR911** Broca de modelação de 9 mm (D), 11,5 mm (C)

22 **IMDI6** Indicador de profundidade 6 mm (D), 8–11,5 mm (C)

23 **IMDI7** Indicador de profundidade 7 mm (D), 8–11,5 mm (C)

24 **IMDI8** Indicador de profundidade 8 mm (D), 8–11,5 mm (C)

25 **IMDI9** Indicador de profundidade 9 mm (D), 8–11,5 mm (C)

26 Anilhas vazias

27 Ranhuras de preparação do implante

Módulo de ferramentas

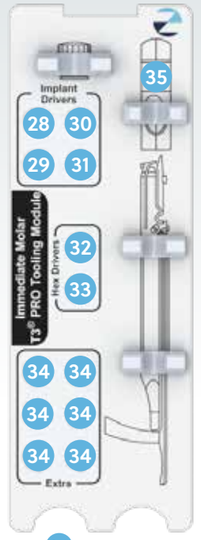

34 Anilhas vazias

28 **IIPDTUL** Ponta de chave para colocação universal de conexões internas (longa)

30 **IIPDTUS** Ponta de chave para colocação universal de conexões internas (curta)

29 **IRE200U** Chave para extensão de roquete universal Certain (longa)

31 **IRE100U** Chave para extensão de roquete universal Certain (curta)

32 **PHD02N** Chave hexagonal 1,2 mm (D) 17 mm (C)

33 **IHX1.2D** Ponta de chave hexagonal Latch-Lock com retenção GemLock, 1,2 mm (D), 24 mm (C)

35 **H-TIRW** Chave de roquete indicadora de alto torque (0–90 Ncm)

Módulo formador de rosca (opcional)

36 **ISOHEXADPT** Adaptador hexagonal ISO de torque elevado

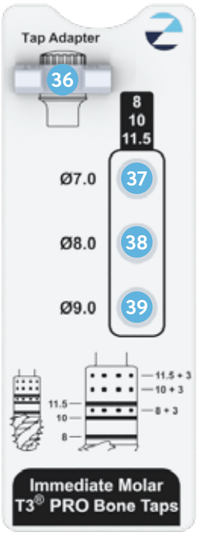

37 **IMT7** Formador de rosca, 7 mm (D), 8–11,5 mm (C)

38 **IMT8** Formador de rosca 8 mm (D) 8–11,5 mm (C)

39 **IMT9** Formador de rosca 9 mm (D), 8–11,5 mm (C)

Para obter mais informações, visite ZimVie.eu

As imagens apresentadas têm natureza meramente exemplificativa e podem não estar à escala ou apresentar a geometria ou cor exatas dos componentes reais.

Salvo indicação em contrário, conforme mencionado no presente documento, todas as marcas comerciais e os direitos de propriedade intelectual são propriedade da ZimVie Inc. e das suas afiliadas, e todos os produtos são fabricados por uma ou mais subsidiárias da divisão de medicina dentária da ZimVie US Corp LLC (Biomet 3i, LLC, etc.) e distribuídos pela ZimVie US Corp LLC e pelos seus parceiros de comercialização autorizados. O H-TIRW é fabricado pela Elos Medtech AB e distribuído pela ZimVie. Classificação do RDM da UE: Implantes dentários (Classe IIb), ferramentas dentárias (Classe IIa). Estão disponíveis mais informações sobre a finalidade prevista do(s) restante(s) dispositivo(s) em: labeling.ZimVie.com. Os produtos aqui apresentados não são elegíveis para reembolso em França. Para outros países, consulte as leis e os regulamentos locais. Para obter informações adicionais sobre os produtos, consulte os rótulos individuais do produto ou as instruções de utilização. Os produtos podem não estar disponíveis ou autorizados em determinados países/regiões. Este material destina-se apenas a profissionais médicos e não constitui parecer ou recomendações médicas. É proibida a distribuição a qualquer outro destinatário. Este material não pode ser copiado nem reproduzido sem o expresso consentimento escrito da ZimVie. ZVINST0233-GLBL-PT REV C 03/26 ©2026 ZimVie. Todos os direitos reservados.

CE 2797

ZimVie