Catálogo de productos

# T3® PRO

## Sistema de implantes molares inmediatos

ZimVie

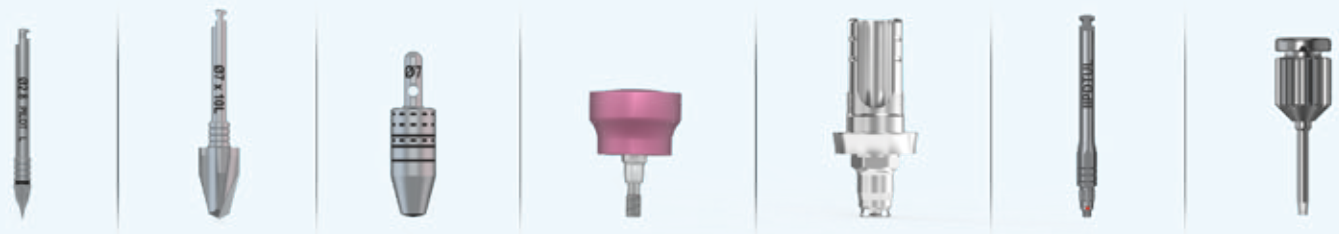

ZimVie

# Índice


**Implantes molares inmediatos T3 PRO** **5**

**Kit y módulos quirúrgicos T3 PRO** **6**

Instrumental quirúrgico 10

Portaimplantes 11

**Soluciones de restauración** **12**

Pilares de cicatrización 12

Restauraciones provisionales 13

Prótesis definitivas de CAD/CAM 13

Componentes protésicos GenTek® 14

Restauraciones calcinables 16

Restauraciones cementadas 16

Componentes del poste GingiHue® y del pilar UCLA 16

Restauraciones atornilladas 17

**Tornillos** **18**

**Herramientas protésicas** **19**


**NOTA:** Las imágenes incluidas en este manual son de carácter representativo y pueden no estar a escala o no mostrar la geometría o el color exactos de los componentes reales.

# SuperPoderes
para
# SuperHéroes

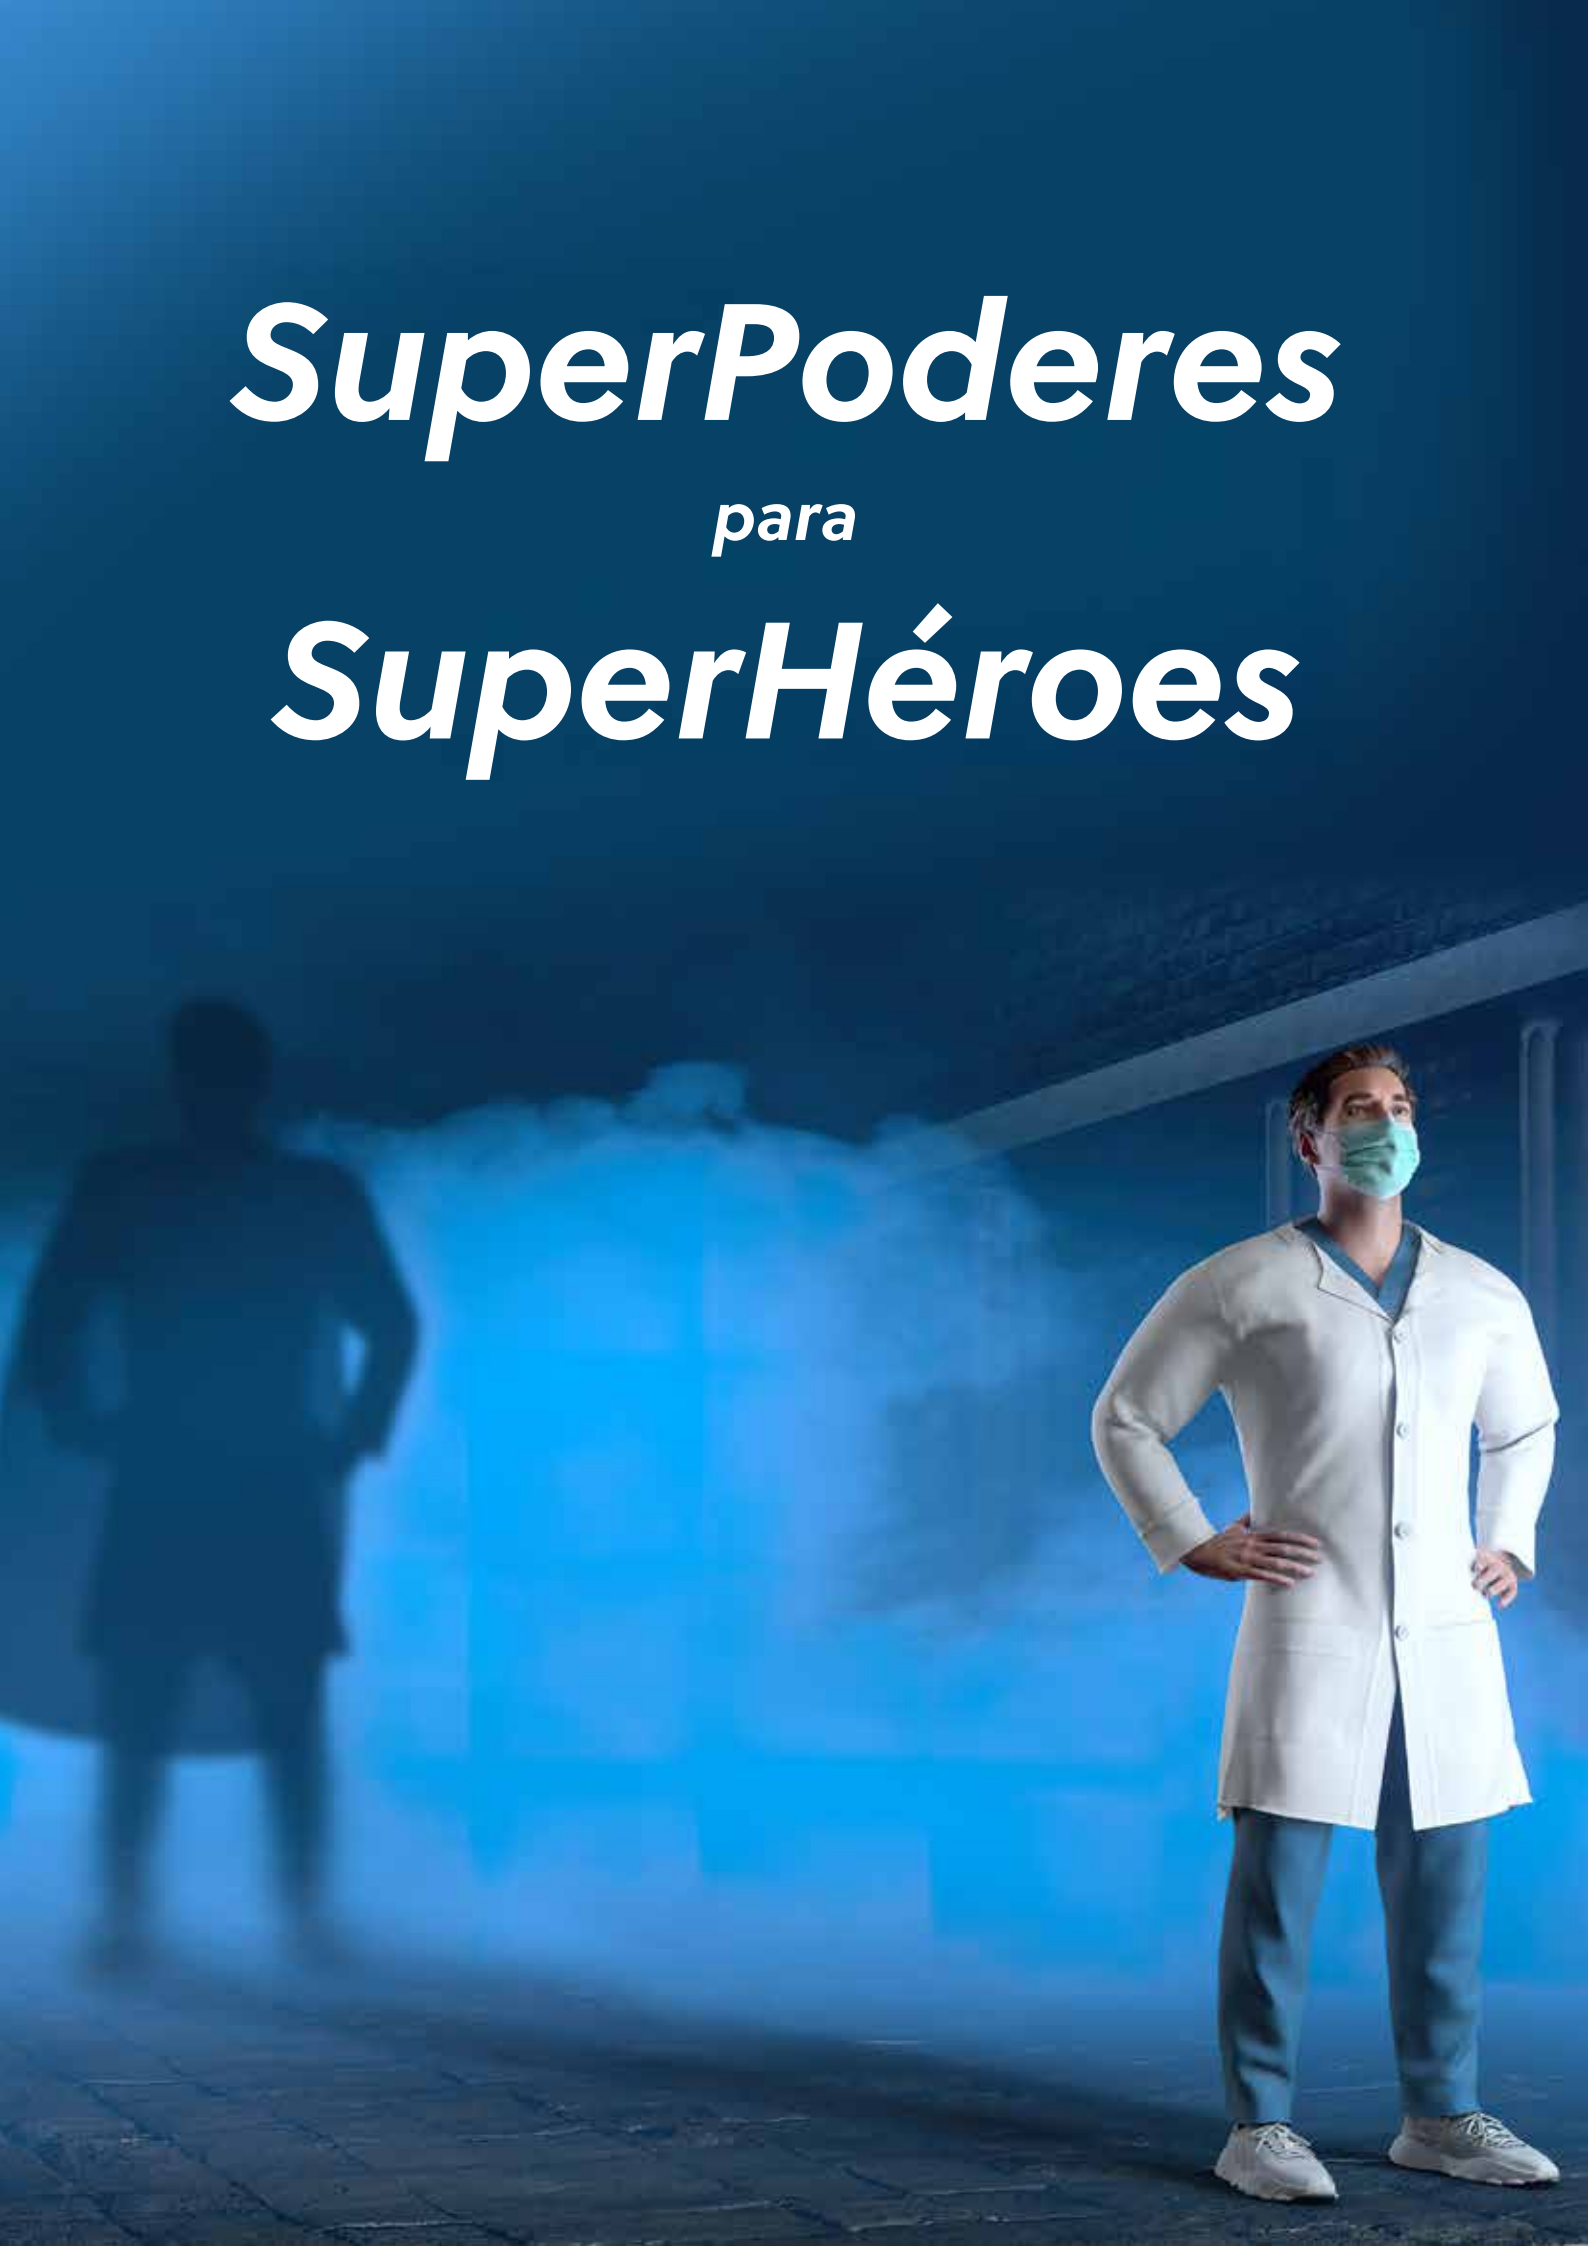

# Implantes molares inmediatos T3 PRO

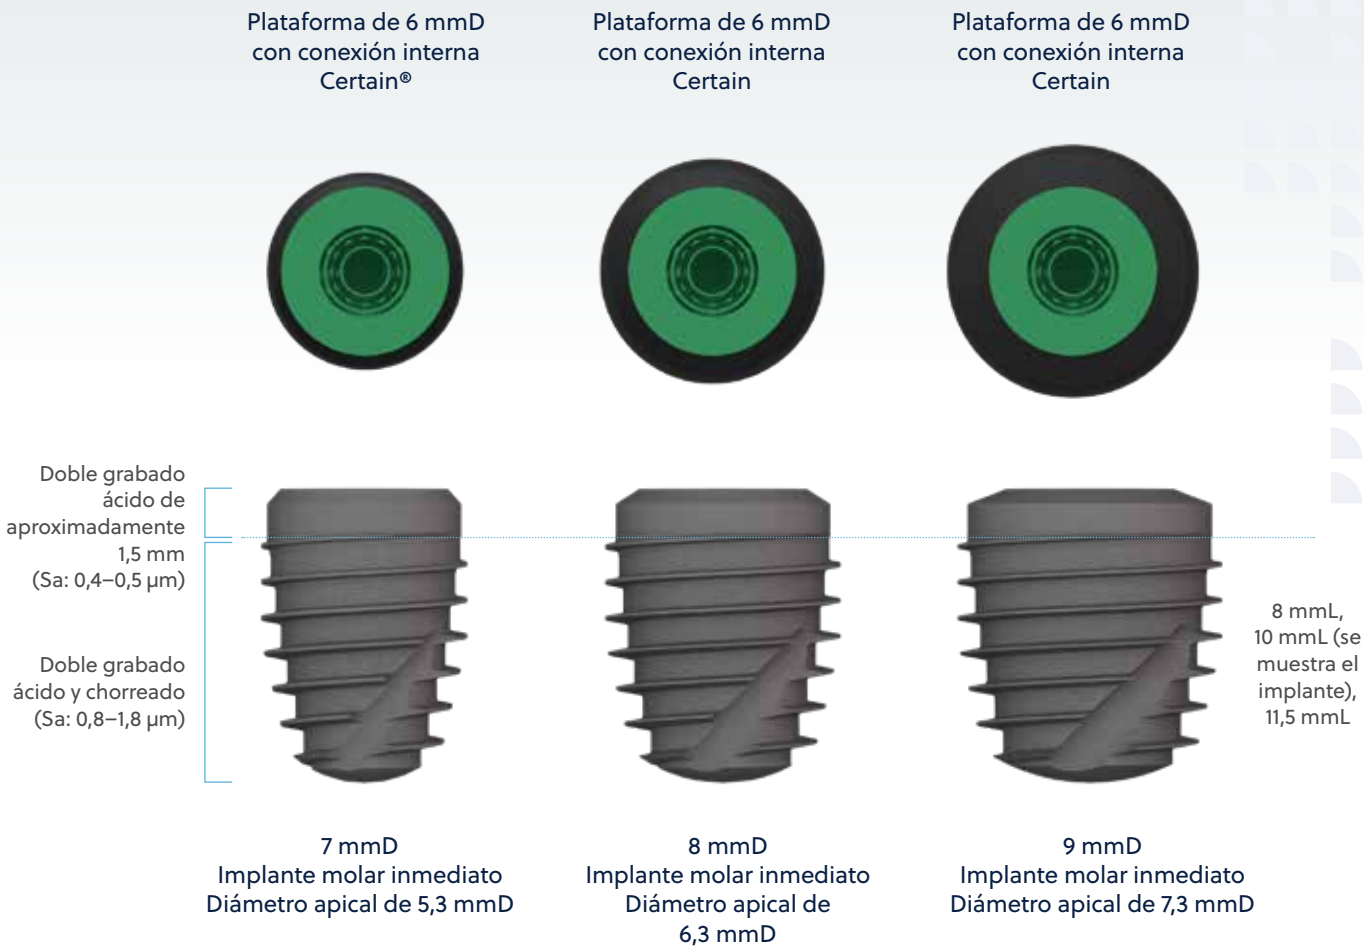


| Diámetro del implante | Plataforma del implante | | Longitud del implante | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8 mmL | 10 mmL | 11,5 mmL |
| 7,0 mmD | 6,0 mmD | Conexión interna Certain | T3PIM7D8L | T3PIM7D10L | T3PIM7D115L |
| 8,0 mmD | 6,0 mmD | Conexión interna Certain | T3PIM8D8L | T3PIM8D10L | T3PIM8D115L |
| 9,0 mmD | 6,0 mmD | Conexión interna Certain | T3PIM9D8L | T3PIM9D10L | T3PIM9D115L |

## Tornillo de cierre quirúrgico

| Descripción | Plataforma del implante | Referencia |
|---|---|---|
| Tornillo de cierre, plano (incluido con el implante) | 6,0 mmD | ICSF60 |

# Kit y módulos quirúrgicos de molares inmediatos T3 PRO

1 **IMDR28L** Fresa de iniciación lanceolada 2,8 mmD, larga

2 **IMDR34T3P** Fresa cónica T3 PRO 3,4 mmD

3 **IMDR38T3P** Fresa cónica T3 PRO 3,8 mmD

4 **IMDR44T3P** Fresa cónica T3 PRO 4,4 mmD

5 **IMDR51T3P** Fresa cónica T3 PRO 5,1 mmD

6 **IMDIR34** Indicador de dirección 3,4 mmD

7 **IMDIR38** Indicador de dirección 3,8 mmD

8 **IMDIR44** Indicador de dirección 4,4 mmD

9 **IMDIR51** Indicador de dirección 5,1 mmD

## Módulo quirúrgico

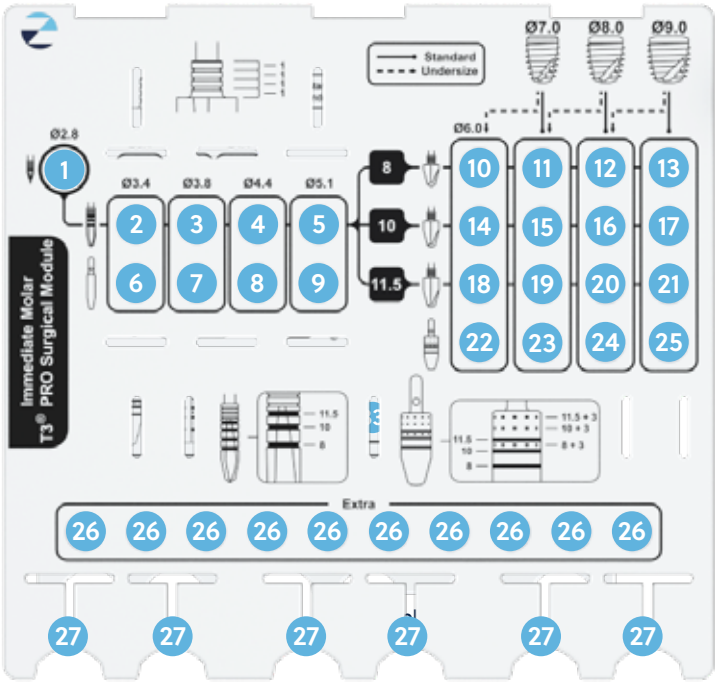


26 **Empty Grommets**

27 **Implant Staging Slots**

10
**IMDR68**
Fresa de perfil 6 mmD, 8 mmL

11
**IMDR78**
Fresa de perfil 7 mmD, 8 mmL

12
**IMDR88**
Fresa de perfil 8 mmD, 8 mmL

13
**IMDR98**
Fresa de perfil 9 mmD, 8 mmL

14
**IMDR610**
Fresa de perfil 6 mmD, 10 mmL

15
**IMDR710**
Fresa de perfil 7 mmD, 10 mmL

16
**IMDR810**
Fresa de perfil 8 mmD, 10 mmL

17
**IMDR910**
Fresa de perfil 9 mmD, 10 mmL

18
**IMDR611**
Fresa de perfil 6 mmD, 11,5 mmL

19
**IMDR711**
Fresa de perfil 7 mmD, 11,5 mmL

20
**IMDR811**
Fresa de perfil 8 mmD, 11,5 mmL

21
**IMDR911**
Fresa de perfil 9 mmD, 11,5 mmL

22
**IMDI6**
Indicador de profundidad 6 mmD, 8–11,5 mmL

23
**IMDI7**
Indicador de profundidad 7 mmD, 8–11,5 mmL

24
**IMDI8**
Indicador de profundidad 8 mmD, 8–11,5 mmL

25
**IMDI9**
Indicador de profundidad 9 mmD, 8–11,5 mmL

# Módulo de herramientas

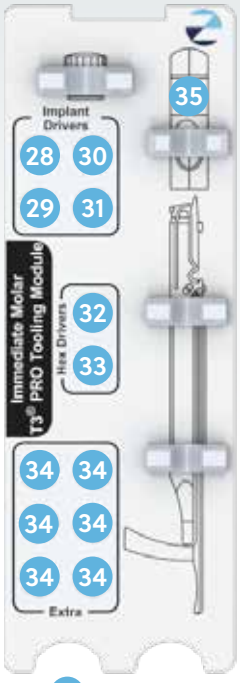


34
**Arandelas vacías**

28
**IIPDTUL**
Punta portaimplantes universal de conexión interna (larga)

30
**IIPDTUS**
Punta portaimplantes universal de conexión interna (corta)

29
**IRE200U**
Destornillador extensor de carraca universal Certain (largo)

31
**IRE100U**
Destornillador extensor de carraca universal Certain (corto)

32
**PHD02N**
Destornillador hexagonal 1,2 mmD, 17 mmL

33
**IHX1.2D**
Punta destornilladora hexagonal de tipo latch con retención GemLock 1,2 mmD, 24 mmL

35
**H-TIRW**
Llave de carraca indicadora de alto torque (0–90 Ncm)

# Terrajas óseas (opcionales)

36
**ISOHEXADPT**
Adaptador hexagonal ISO de alto torque (0–90 Ncm)

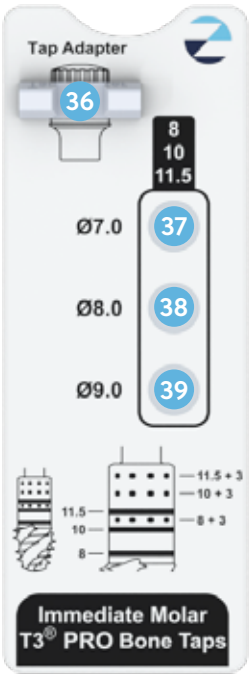

37
**IMT7**
Terraja ósea 7 mmD, 8–11,5 mmL

38
**IMT8**
Terraja ósea 8 mmD, 8–11,5 mmL

39
**IMT9**
Terraja ósea 9 mmD, 8–11,5 mmL

# Kit quirúrgico de molares inmediatos T3 PRO, completo

| Descripción | Referencia |
|---|---|
| Kit quirúrgico de molares inmediatos T3 PRO, completo | IMKITT3P |

**Nota:** Las terrajas óseas son instrumentos opcionales y no se incluyen en el kit quirúrgico. Puede adquirirse un módulo de terraja ósea por separado y añadirse al kit. El kit quirúrgico también incluye un módulo sin rellenar con 10 arandelas vacías.

## Componentes del kit quirúrgico de molares inmediatos T3 PRO

| | REF. | Descripción | IMKITT3P |
|---|---|---|---|
| Fresa de iniciación | IMDR28L | Fresa de iniciación de molares inmediatos 2,8 mmD larga (30 mm) ◆ | X |
| Fresas cónicas | IMDR34T3P | Fresa cónica de molares inmediatos T3 PRO, 3,4 mmD | X |
| | IMDR38T3P | Fresa cónica de molares inmediatos T3 PRO, 3,8 mmD | X |
| | IMDR44T3P | Fresa cónica de molares inmediatos T3 PRO, 4,4 mmD | X |
| | IMDR51T3P | Fresa cónica de molares inmediatos T3 PRO, 5,1 mmD | X |
| Fresas de perfil | IMDR68 | Fresa de perfil de molares inmediatos 6 mmD, 8 mmL | X |
| | IMDR610 | Fresa de perfil de molares inmediatos 6 mmD, 10 mmL | X |
| | IMDR611 | Fresa de perfil de molares inmediatos 6 mmD, 11,5 mmL | X |
| | IMDR78 | Fresa de perfil de molares inmediatos 7 mmD, 8 mmL | X |
| | IMDR710 | Fresa de perfil de molares inmediatos 7 mmD, 10 mmL | X |
| | IMDR711 | Fresa de perfil de molares inmediatos 7 mmD, 11,5 mmL | X |
| | IMDR88 | Fresa de perfil de molares inmediatos 8 mmD, 8 mmL | X |
| | IMDR810 | Fresa de perfil de molares inmediatos 8 mmD, 10 mmL | X |
| | IMDR811 | Fresa de perfil de molares inmediatos 8 mmD, 11,5 mmL | X |
| | IMDR98 | Fresa de perfil de molares inmediatos 9 mmD, 8 mmL | X |
| | IMDR910 | Fresa de perfil de molares inmediatos 9 mmD, 10 mmL | X |
| | IMDR911 | Fresa de perfil de molares inmediatos 9 mmD, 11,5 mmL | X |
| Indicadores de dirección | IMDIR34 | Indicador de dirección de molares inmediatos, 3,4 mmD | X |
| | IMDIR38 | Indicador de dirección de molares inmediatos, 3,8 mmD | X |
| | IMDIR44 | Indicador de dirección de molares inmediatos, 4,4 mmD | X |
| | IMDIR51 | Indicador de dirección de molares inmediatos, 5,1 mmD | X |
| Indicadores de profundidad | IMDI6 | Indicador de profundidad de molares inmediatos 6 mmD, 8–11,5 mmL | X |
| | IMDI7 | Indicador de profundidad de molares inmediatos 7 mmD, 8–11,5 mmL | X |
| | IMDI8 | Indicador de profundidad de molares inmediatos 8 mmD, 8–11,5 mmL | X |
| | IMDI9 | Indicador de profundidad de molares inmediatos 9 mmD, 8–11,5 mmL | X |
| Implante Destornilladores | IRE100U | Destornillador de implante de extensor de carraca Certain universal (corto) | X |
| | IRE200U | Destornillador de implante de extensor de carraca Certain universal (largo) | X |
| | IIPDTUS | Punta portaimplantes universal de conexión interna (corta) | X |
| | IIPDTUL | Punta portaimplantes universal de conexión interna (larga) | X |
| Destornilladores protésicos | IHX1.2D | Punta destornilladora hexagonal de tipo latch con retención GemLock 1,2 mmD, 24 mmL | X |
| | PHD02N | Destornillador hexagonal 1,2 mmD, 17 mmL | X |
| Llave dinamométrica | H-TIRW | Llave de carraca indicadora de alto torque | X |

◆ IMDR28S: La fresa de molares inmediatos 2,8 mmD corta (27 mm) se comercializa por separado.

## Terrajas óseas (opcionales)

| Descripción | Referencia |
|---|---|
| Módulo de terrajas óseas para molares inmediatos T3 PRO | IMT3PTAPS |
| **Componentes** | |
| Terraja para molares inmediatas 7,0 mmD, 8–11,5 mmL | IMT7 |
| Terraja para molares inmediatas 8,0 mmD, 8–11,5 mmL | IMT8 |
| Terraja para molares inmediatas 9,0 mmD, 8–11,5 mmL | IMT9 |
| Adaptador hexagonal de tipo latch de alto torque* | ISOHEXADPT |

*Nota: Las terrajas óseas para molares inmediatos tienen una conexión tipo latch especializada. Este adaptador permite el uso manual de las terrajas óseas para molares inmediatas cuando se acoplan a la llave de carraca indicadora de alto torque (H-TIRW) ZimVie.

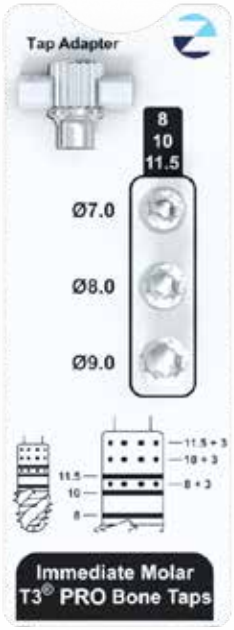


## Bandeja y módulos vacíos

| Descripción | Referencia |
|---|---|
| Kit quirúrgico de molares inmediatos T3 PRO<br>Incluye tapa y base de kit quirúrgico, módulo quirúrgico y de herramientas vacío | IMKITT3PUNP |
| Módulo quirúrgico de molares inmediatos T3 PRO | IMT3PDRILLSUNP |
| Módulo de herramientas de molares inmediatos T3 PRO | IMT3PTOOLINGUNP |
| Módulo de terrajas óseas para molares inmediatos T3 PRO | IMT3PTAPSUNP |
| Bandeja modular, vacía, sujeta de forma segura los instrumentos de conexión ISO | UNPMODTRAY |

# Instrumental quirúrgico

## Fresas de iniciación lanceoladas

| Descripción | Referencia |
|---|---|
| Fresa de iniciación de molares inmediatos 2,8 mmD corta^ | IMDR28S |
| Fresa de iniciación de molares inmediatos 2,8 mmD larga* | IMDR28L |

^Disponible para su adquisición por separado
*Incluida en el kit quirúrgico de molares inmediatos T3 PRO

## Fresas cónicas

| Descripción | Referencia |
|---|---|
| Fresa de molares inmediatos T3 PRO, 3,4 mmD | IMDR34T3P |
| Fresa de molares inmediatos T3 PRO, 3,8 mmD | IMDR38T3P |
| Fresa de molares inmediatos T3 PRO, 4,4 mmD | IMDR44T3P |
| Fresa de molares inmediatos T3 PRO, 5,1 mmD | IMDR51T3P |

## Fresas de perfil

| Diámetro | 8 mmL | 10 mmL | 11,5 mmL |
|---|---|---|---|
| 6,0 mmD | IMDR68 | IMDR610 | IMDR611 |
| 7,0 mmD | IMDR78 | IMDR710 | IMDR711 |
| 8,0 mmD | IMDR88 | IMDR810 | IMDR811 |
| 9,0 mmD | IMDR98 | IMDR910 | IMDR911 |

## Indicadores de dirección

| Descripción | Referencia |
|---|---|
| Indicador de dirección de molares inmediatos, 3,4 mmD | IMDIR34 |
| Indicador de dirección de molares inmediatos, 3,8 mmD | IMDIR38 |
| Indicador de dirección de molares inmediatos, 4,4 mmD | IMDIR44 |
| Indicador de dirección de molares inmediatos, 5,1 mmD | IMDIR51 |

## Indicadores de profundidad

| Descripción | Referencia |
|---|---|
| Indicador de profundidad de molares inmediatos 6 mmD, 8–11,5 mmL | IMDI6 |
| Indicador de profundidad de molares inmediatos 7 mmD, 8–11,5 mmL | IMDI7 |
| Indicador de profundidad de molares inmediatos 8 mmD, 8–11,5 mmL | IMDI8 |
| Indicador de profundidad de molares inmediatos 9 mmD, 8–11,5 mmL | IMDI9 |

# Portaimplantes

## Portaimplantes

| Descripción | Modo de uso | Referencia |
|---|---|---|
| Destornillador de implante de extensor de carraca Certain universal (largo) | Carraca | IRE200U |
| Destornillador de implante de extensor de carraca Certain universal (corto) | Carraca | IRE100U |
| Punta portaimplantes universal de conexión interna (larga) | Pieza de mano | IIPDTUL |
| Punta portaimplantes universal de conexión interna (corta) | Pieza de mano | IIPDTUS |

## Destornilladores para tornillos quirúrgicos y tornillos protésicos

| Descripción | Modo de uso | Referencia |
|---|---|---|
| Destornillador hexagonal manual 1,2 mmD, 17 mmL | A mano | PHD02N |
| Destornillador hexagonal manual 1,2 mmD, 24 mmL | A mano | PHD03N |
| Destornillador hexagonal de tipo latch con retención GemLock, 1,2 mmD, 24 mmL | Pieza de mano | IHX1.2D |
| Destornillador hexagonal de tipo latch con retención GemLock, 1,2 mmD, 30 mmL | Pieza de mano | IXL1.2D |

## Llave de carraca indicadora de torque

| Descripción | Referencia |
|---|---|
| Llave de carraca indicadora de alta torsión, 0–90 Ncm (incluida en el kit de molares inmediatos T3 PRO) | H-TIRW |

# Pilares de cicatrización de soluciones de restauración

## Encode® Emergence

| Plataforma protésica | Perfil de emergencia | Altura | |
|---|---|---|---|
| | | 3 mm (Alt) | 5 mm (Alt) |
| 6,0 mmD | 6,0 mm (P) | IEEHA663 | IEEHA665 |
| | 6,8 mm (P) | IEEHA6683 | IEEHA6685 |
| | 7,5 mm (P) | IEEHA673 | IEEHA675 |

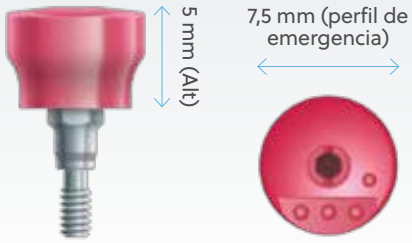


## Pilares de cicatrización de una pieza EP®

| Plataforma protésica | Perfil de emergencia | Altura del cuello | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 mm (Alt) | 3 mm (Alt) | 4 mm (Alt) | 6 mm (Alt) | 8 mm (Alt) |
| 6,0 mmD | 6,0 mm (P) | ISWHA62 | ISWHA63 | ISWHA64 | ISWHA66 | ISWHA68 |
| | 6,8 mm (P) | IWTH62 | IWTH63 | IWTH64 | IWTH66 | IWTH68 |
| | 7,5 mm (P) | IWTH672 | IWTH673 | IWTH674 | IWTH676 | IWTH678 |

# Restauraciones provisionales

## Postes PreFormance®
(Material: PEEK; conexión de aleación de titanio)

| Plataforma protésica | Perfil de emergencia | Altura del cuello | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 mm (Alt) | | 6 mm (Alt) | |
| | | Recto | Preangulado 15° | Recto | Preangulado 15° |
| 6,0 mmD | 6,0 mm (P) | IWPFP664 | IPAPF664 | IWPFP666 | IPAPF666 |

## Cilindros provisionales

### Cilindros provisionales PreFormance (material: PEEK - conexión de aleación de titanio)

| Plataforma protésica | Descripción | |
|---|---|---|
| | Hexagonal | No hexagonal |
| 6,0 mmD | IWPFTC61 | IWPFTC62 |

### Cilindros provisionales de titanio (material: conexión de aleación de titanio)

| Plataforma protésica | Descripción | |
|---|---|---|
| | Hexagonal | No hexagonal |
| 6,0 mmD | IWTCS61 | IWTCS62 |

**Nota:** Todos los pilares provisionales (postes PreFormance y cilindros provisionales) incluyen el correspondiente tornillo hexagonal de titanio (UNIHT).

# Prótesis definitivas de CAD/CAM

Diseño por ordenador y precisión CAD/CAM de fresado a medida.

Póngase en contacto con un representante de ZimVie para obtener más información.

# Componentes protésicos GenTek®

## Bases de titanio GenTek®

Incluye: Tornillo hexalobular Gold-Tite® y tornillo para cementado

| Altura del poste | Plataforma protésica | Altura del cuello | Base de titanio antirrotatoria | Base de titanio rotatoria |
|---|---|---|---|---|
| 7 mm | Ø5,0 mm | 0,3 mm | ZFX11ZB-CE50ASZ03E | ZFX11ZB-CE50ASZ03N |
| | | 1,3 mm | ZFX11ZB-CE50AS13E | ZFX11ZB-CE50AS13N |
| | | 2,6 mm | ZFX11ZB-CE50AS26E | - |

**Nota**: Los implantes molares inmediatos pueden restaurarse con componentes protésicos de 5,0 mm.

## Tornillos para bases de titanio GenTek

| Descripción | Base de titanio antirrotatoria | Base de titanio rotatoria |
|---|---|---|
| Tornillo hexalobular Gold-Tite | ZFX09-ZB-CE-HLGTE | ZFX09-ZB-CE-HLGTN |
| Tornillo de prueba hexalobular | ZFX09-ZB-CE-HLTISE | ZFX09-ZB CE-HLTISN |

## Bases de titanio GenTek con poste estándar

Incluye: Tornillos Gold-Tite y tornillos para cementado

| Altura del poste | Plataforma protésica | Base de titanio antirrotatoria | Base de titanio rotatoria |
|---|---|---|---|
| 7 mm | Ø5,0 mm | ZFX11-ZB-CE-5047-EL | ZFX11-ZB-CE-5047-NEL |

**Nota**: Los implantes molares inmediatos pueden restaurarse con componentes protésicos de 5,0 mm.

## Tornillos para bases de titanio GenTek con poste estándar

| Descripción | Base de titanio antirrotatoria | Base de titanio rotatoria |
|---|---|---|
| Tornillo Gold-Tite | ZFX09-ZB-CE-HGTS | ZFX09-ZB-CE-LGTS |
| Tornillo de prueba | ZFX09-ZB-CE-HTIS | ZFX09-ZB-CE-NHTIS |

## Blank para pilares prefresados de titanio

Incluye: Tornillo Gold-Tite®

| Plataforma protésica | Referencia |
|---|---|
| Ø5,0 mm | ZFX18-ZB-CE-4160 |

**Nota**: Los implantes molares inmediatos pueden restaurarse con componentes protésicos de 5,0 mm.

## Tornillos para blanks para pilares prefresados de titanio

| Descripción | Referencia |
|---|---|
| Tornillo Gold-Tite | ZFX09-ZB-CE-HGTS |
| Tornillo de prueba | ZFX09-ZB-CE-HTIS |

## Cuerpos de escaneo GenTek

Incluye: Tornillo

| Plataforma protésica | Referencia |
|---|---|
| Ø6,0 mm | ZFX05Z-ZB-CE-60 |

## Análogos digitales GenTek

Incluye: Tornillo

| Plataforma protésica | Referencia |
|---|---|
| Ø6,0 mm | ZFX15Z-ZB-CE-60 |

## Accesorios para análogos digitales GenTek

| Descripción | Referencia |
|---|---|
| Tornillo de fijación del análogo digital<br>*(paquete de 4 tornillos)* | ZFX15Z-FS |

# Restauraciones calcinables

### Pilares UCLA hexagonales de oro (material: cilindro de aleación de oro mecanizado con Unitube de plástico)

| Plataforma protésica | Descripción | Material | Referencia |
|---|---|---|---|
| 6,0 mmD | Hexagonal | Oro | IWGA61C |
| | No hexagonal (con tornillo de diámetro grande Gold-Tite®) | Oro | IWGA62C |
| | No hexagonal (con tornillo de Ti de diámetro grande) | Oro | IWGA62T |

**Nota:** Los pilares hexagonales UCLA Gold no incluyen el tornillo.
El tornillo definitivo Gold-Tite (IUNIHG) debe pedirse por separado.

# Restauraciones cementadas

### Postes GingiHue® (material: aleación de titanio)

| Plataforma protésica | Perfil de emergencia | Altura del cuello | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 mm (Alt) | | 4 mm (Alt) | |
| | | Recto | Preangulado 15° | Recto | Preangulado 15° |
| 6,0 mmD | 6,0 mm (P) | IWPP662G | IPAP662G | IWPP664G | IPAP664G |
| | 7,5 mm (P) | IWPP672G | IPAP672G | IWPP674G | IPAP672G |

# Componentes del poste GingiHue y del pilar UCLA

### Cofias de impresión de arrastre Pick-Up

| Plataforma protésica | Perfil de emergencia | Referencia |
|---|---|---|
| 6,0 mmD | 6,0 mm | IWIP60 |
| | 6,8 mm | IWIP66 |
| | 7,5 mm | IWIP67 |

### Cofia de impresión Twist Lock™

| Plataforma protésica | Perfil de emergencia | Referencia |
|---|---|---|
| 6,0 mmD | 6,0 mm | IWIT60 |
| | 6,8 mm | IWIT66 |
| | 7,5 mm | IWIT67 |

### Análogo de laboratorio

| Plataforma protésica | Referencia |
|---|---|
| 6,0 mmD | IILAW6 |

### Componentes adicionales

| Descripción | Referencia |
|---|---|
| Tornillo Gold-Tite | IUNIHG |
| Tornillos de prueba (paquete de 5 uds.) | IUNITS |
| Mango de sujeción | ILTAH57 |
| Tornillo hexagonal grande Gold-Tite | ILRGHG |

# Restauraciones atornilladas

## Pilares de perfil bajo (material: aleación de titanio)

| Plataforma protésica | Altura del cuello | Recto (no hexagonal) | Recto (hexagonal) | Angulado de 17° (hexagonal) | Angulado de 30° (hexagonal) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,0 mmD* | 1,0 mm | ILPC541U | ILPC541 | — | — |
| | 2,0 mm | ILPC542U | ILPC542 | ILPAC5217 | — |
| | 3,0 mm | ILPC543U | ILPC543 | — | ILPAC5330 |
| | 4,0 mm | ILPC544U | ILPC544 | ILPAC5417 | — |
| | 5,0 mm | — | — | — | ILPAC5530 |



*Nota: Los implantes molares inmediatos pueden restaurarse con componentes protésicos de 5,0 mm.

## Componentes para pilar de perfil bajo

| Descripción | Plataforma protésica de 4,8 mm |
|---|---|
| Cofia de impresión de arrastre Pick-Up (hexagonal) ⬢ | LPCPIC1 |
| Cofia de impresión de arrastre Pick-Up (no hexagonal) ⬢ | LPCPIC2 |
| Cofia de impresión Twist Lock (hexagonal) ○ | LPCTIC1 |
| Cofia de impresión Twist Lock (no hexagonal) ○ | LPCTIC2 |
| Cofia de impresión QuickBridge® | LPCRIC |
| Análogo de laboratorio | LPCLA |
| Cilindro provisional (hexagonal) | LPCTC1 |
| Cilindro provisional (no hexagonal) | LPCTC2 |
| Tapa de cicatrización ⬢ | LPCHC |
| Cilindro provisional PreFormance (hexagonal) | LPCPTC1 |
| Cilindro provisional PreFormance (no hexagonal) | LPCPTC2 |
| QuickBridge | LPCQB |
| Tapa de repuesto QuickBridge | LPCQBCAP |
| Extensión distal | LPCDE |
| Cilindro de oro (hexagonal) | LPCGC1 |
| Cilindro de oro (no hexagonal) | LPCGC2 |
| Cilindro calcinable (hexagonal) | LPCCC1 |
| Cilindro calcinable (no hexagonal) | LPCCC2 |
| Cilindro para soldadura con láser | LPCTUCA |
| Tornillo de encerado | LPCWS |
| Tornillo de retención ⬢ | LPCGSH, LPCTSH |
| Instrumento de pulidor | LPCAMI |
| Protector de pulido | LPCPP |

| Compatibilidad de pilares | | |
|---|---|---|
| Componente | Pilar hexagonal | Pilar no hexagonal |
| Hexagonal | Sí | No |
| No hexagonal | Sí | Sí |

⬢ = Requiere el uso del destornillador hexagonal PHD02N, PHD03N o la punta destornilladora IHX1.2D, IXL1.2D, RASH3N, RASH8N

○ = Requiere el uso del transportador de cofias de impresión ICD00

# Tornillos

## Tornillos de pilar

| | Tornillo Gold-Tite | Tornillo de titanio | Tornillo Gold-Tite grande | Tornillo de titanio grande |
|---|---|---|---|---|
| Tornillos | IUNIHG | IUNIHT | ILRGHG | ILRGHT |
| Destornilladores | PHD02N, PHD03N | PHD02N, PHD03N | PHD02N, PHD03N | PHD02N, PHD03N |
| Puntas portaimplantes | IHX1.2D, IXL1.2D, RASH3N, RASH8N | IHX1.2D, IXL1.2D, RASH3N, RASH8N | IHX1.2D, IXL1.2D, RASH3N, RASH8N | IHX1.2D, IXL1.2D, RASH3N, RASH8N |
| Torque | 20 Ncm | 20 Ncm | 20 Ncm | 20 Ncm |
| Para uso con: | Hexagonal Express y Flex, pilar UCLA, poste GingiHue, poste GingiHue de 15°, cilindro provisional hexagonal | Pilar UCLA, poste GingiHue, poste GingiHue de 15°, cilindro provisional hexagonal | Pilar UCLA no hexagonal, pilares no hexagonales Express y Flex, cilindro provisional rotatorio, barras | Pilar UCLA no hexagonal, cilindro provisional rotatorio, barras BellaTek® |

## Tornillos de retención

| | Tornillo Gold-Tite para pilar de perfil bajo | Tornillo de pilar de titanio de perfil bajo |
|---|---|---|
| Tornillos | LPCGSH | LPCTSH |
| Destornilladores | PHD02N, PHD03N | PHD02N, PHD03N |
| Puntas portaimplantes | IHX1.2D, IXL1.2D, RASH3N, RASH8N | IHX1.2D, IXL1.2D, RASH3N, RASH8N |
| Torque | 10 Ncm | 10 Ncm |
| Para uso con: | Pilar de perfil bajo | Pilar de perfil bajo |

## Tornillos de encerado y tornillos de prueba

| | Tornillo de encerado de laboratorio | Tornillo de prueba hexagonal (paquete de 5 uds.) |
|---|---|---|
| Tornillos | IWSU30 | IUNITS |
| Destornilladores | PHD02N, PHD03N | PHD02N, PHD03N |
| Puntas portaimplantes | IHX1.2D, IXL1.2D, RASH3N, RASH8N | IHX1.2D, IXL1.2D, RASH3N, RASH8N |
| Para uso con: | Cofias de arrastre y de impresión, procedimientos de laboratorio a nivel del implante | Pilar UCLA hexagonal, poste GingiHue, poste GingiHue de 15° |

# Herramientas protésicas

| Descripción | Referencia |
|---|---|
| Llave de carraca indicadora de torque bajo<br>Incluye: Adaptador L-TIRW estándar ISO 1797 (C9980) | L-TIRW |
| Adaptador de tipo latch estándar L-TIRW | C9980 |
| Adaptador de tipo latch corto L-TIRW | C9981 |
| Escariador y mango | IRH600 |
| Herramienta de activación QuickSeat® Certain | IQSA01 |
| Protector de pulido, pilar UCLA, 6 mmD | IPPIA6 |
| Protector de pulido, pilar UCLA, 3,4 mmD, 4,1 mmD, 5mmD mmD y 6 mmD | ILTAH57 |
| Kit de guías anguladas, 15°, 25° y 35° | AG900 |
| Poste de medición de tejidos | TMP80 |
| Destornillador hexalobular para tornillo de retención hexalobular, 21 mmL | ZFX02HLD21 |
| Destornillador hexalobular para tornillo de retención hexalobular, 28 mmL | ZFX02HLD28 |
| Destornillador hexalobular para tornillo de retención hexalobular, 36 mmL | ZFX02HLD36 |

## Kit de extracción de tornillos

| Descripción | Referencia |
|---|---|
| Kit de instrumentos de extracción de tornillos Certain | ISRT10N |
| **Componentes** | |
| Tutor con mango de la fresa Certain | ISRT05N |
| Instrumento de extracción de tornillos Certain | ISRT06N |
| Fresa inversa manual | USRT07 |
| Tornillo de encerado/pin guía Certain | IWSU30 |

| Descripción | Referencia |
|---|---|
| Kit de llave de carraca indicadora de torque bajo | L-TIRWK |
| Componentes | |
| Punta destornilladora hexagonal estrecha de contraángulo, 24 mmL | RASH3N |
| Punta destornilladora cuadrada estrecha de contraángulo, 24 mmL | RASQ3N |
| Llave de carraca indicadora de torque bajo | L-TIRW |
| Bandeja torque para restauración | RTI2035TR |

## Destornilladores para pilares de perfil bajo

| Descripción | Referencia |
|---|---|
| Transportador para pilares posterior, 17 mmL | PAD00 |
| Transportador para pilares posterior, 24 mmL | PAD24 |
| Punta transportadora de pilares de contraángulo, acero | RASA3 |



## Destornilladores para tornillos quirúrgicos y tornillos protésicos

| Descripción | Modo de uso | Referencia |
|---|---|---|
| Destornillador hexagonal manual 1,2 mmD, 17 mmL | A mano | PHD02N |
| Destornillador hexagonal manual 1,2 mmD, 24 mmL | A mano | PHD03N |
| Destornillador hexagonal de tipo latch con retención GemLock, 1,2 mmD, 24 mmL | Pieza de mano | IHX1.2D |
| Destornillador hexagonal de tipo latch con retención GemLock, 1,2 mmD, 30 mmL | Pieza de mano | IXL1.2D |
| Punta destornilladora hexagonal estrecha de contraángulo, 24 mmL | | RASH3N |
| Punta destornilladora hexagonal estrecha de contraángulo, 30 mmL | | RASH8N |

## Destornilladores para cofias de impresión de transferencia Twist Lock

| Descripción | Referencia |
|---|---|
| Destornillador corto para cofia de impresión | ICD00 |

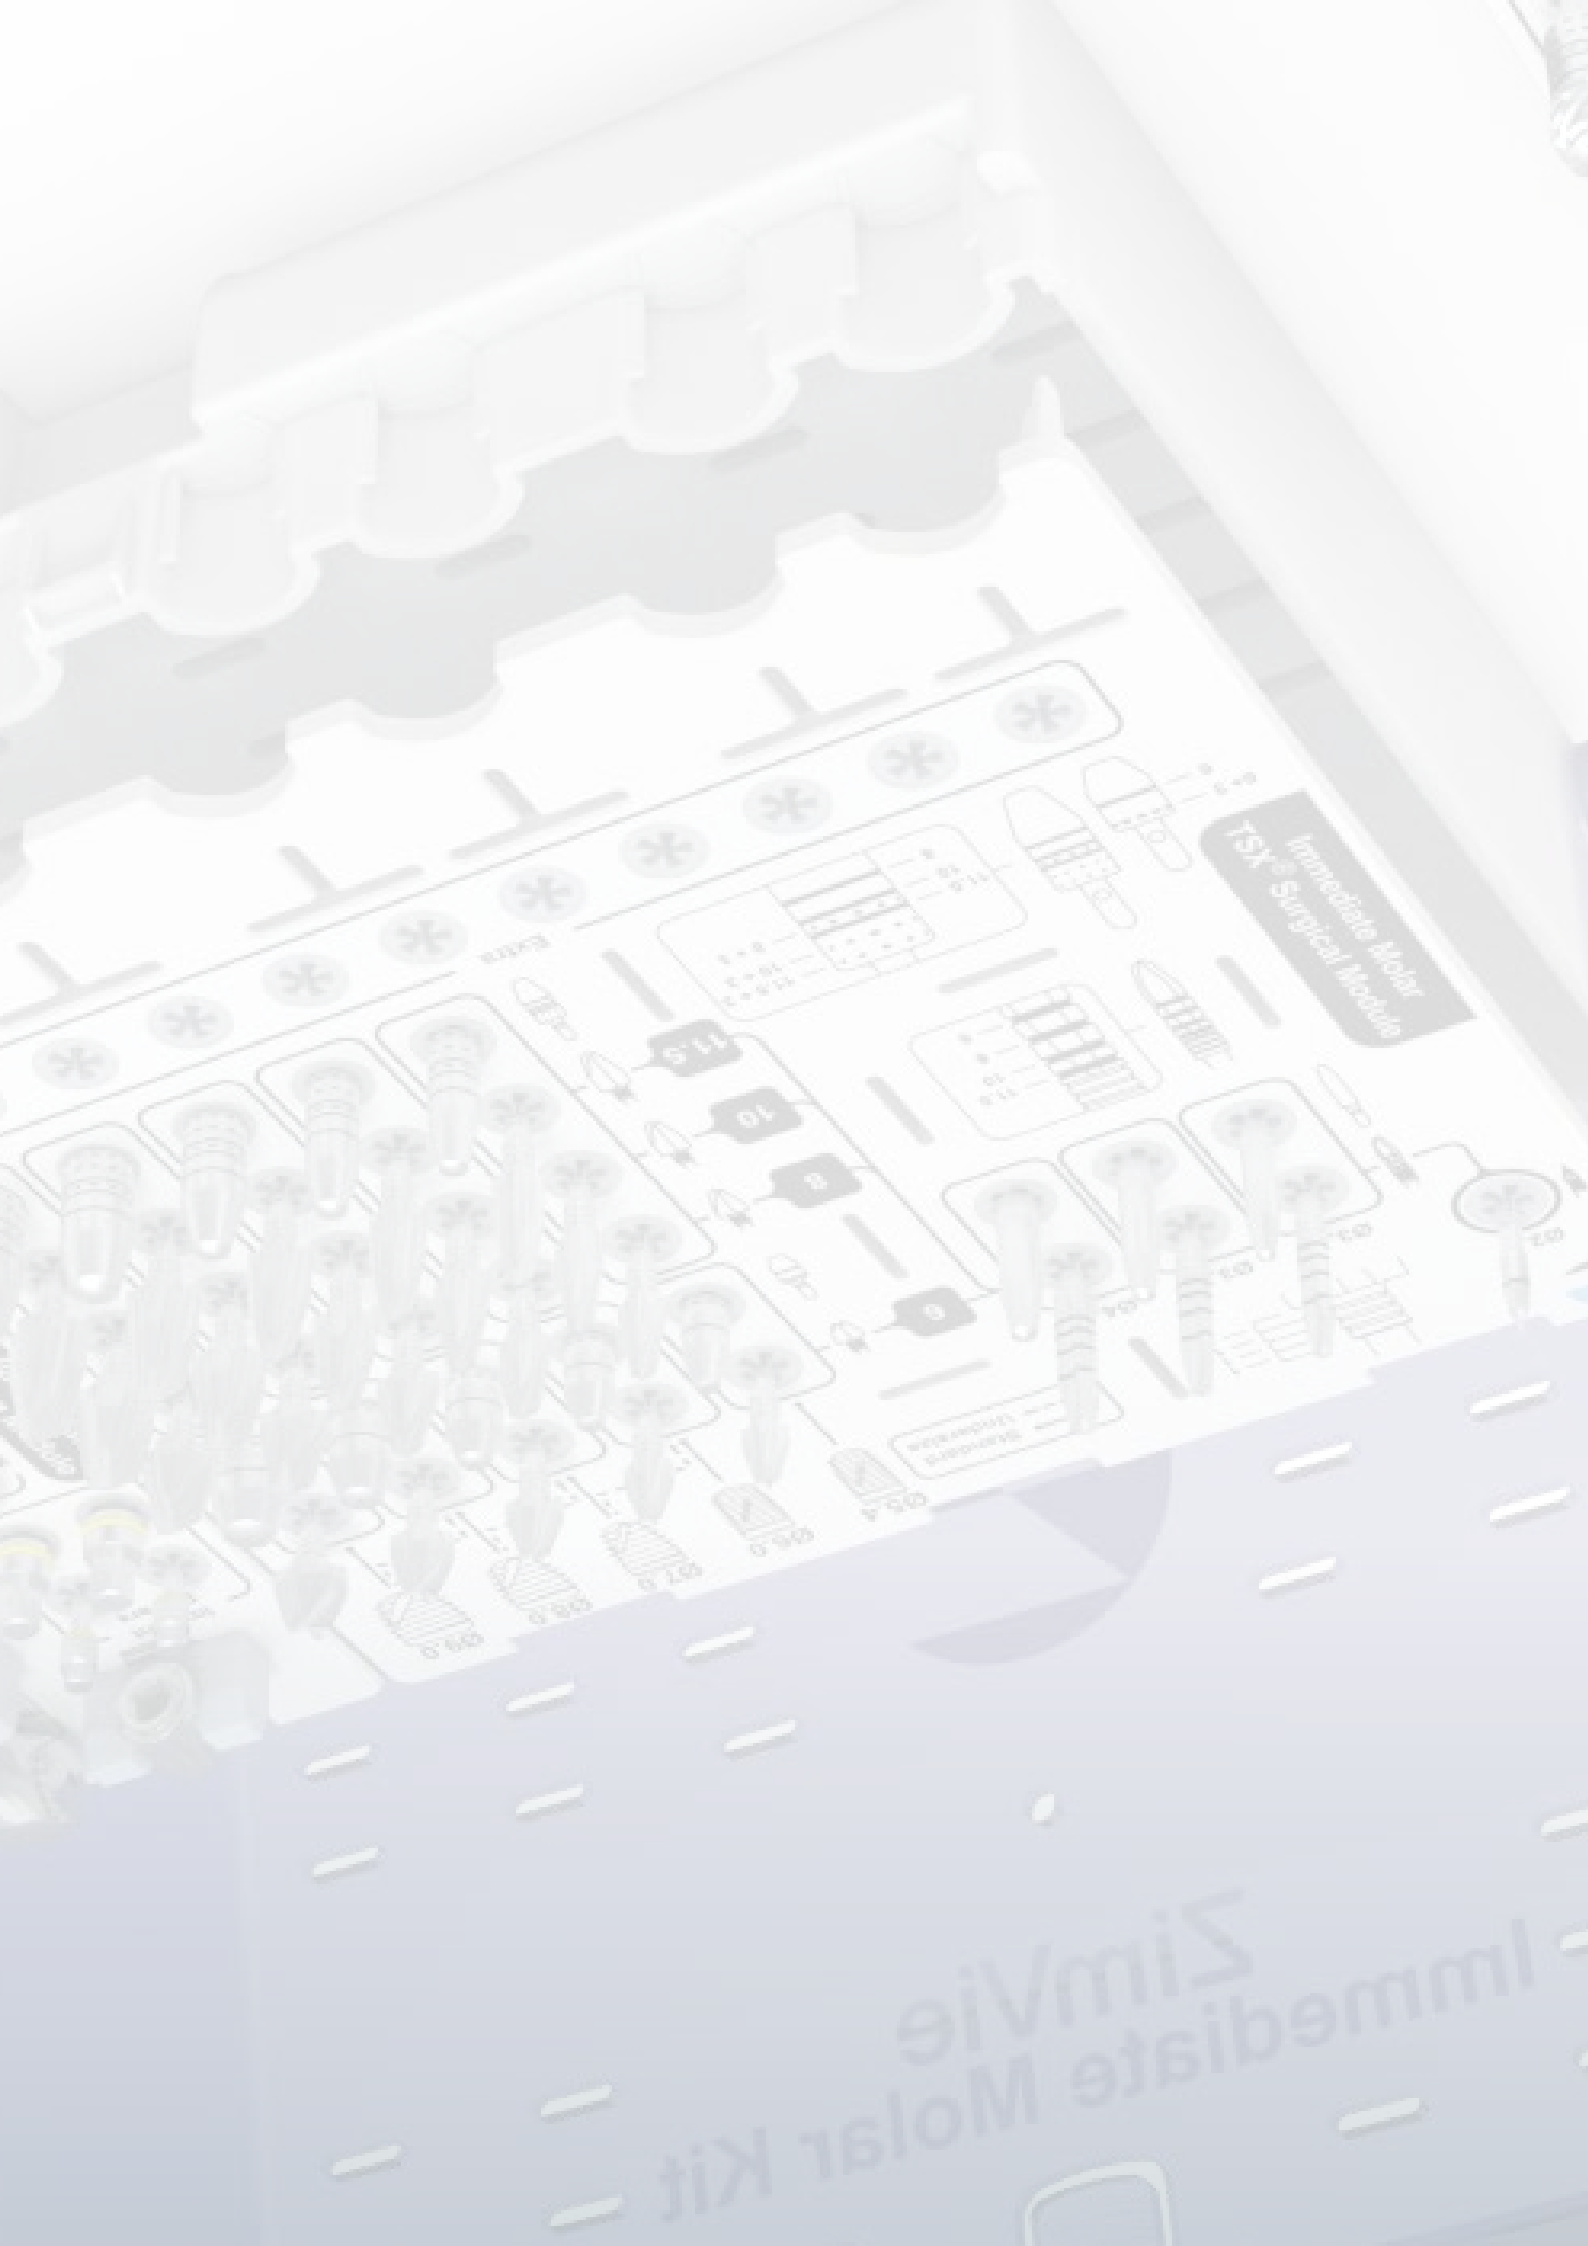
Immediate Molar
TSX Surgical Implant

# Notas

# Notas

Para obtener más información, visite ZimVie.eu

**ZimVie US Corp LLC**
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Tel.: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272
dentalCS@ZimVie.com

**ZimVie Spain S.L.U.**
WTC Almeda Park, Ed. 4, Pl. 2
C/Tirso de Molina, 40 (entrada Plaça de la Pau)
08940, Cornellà de Llobregat
Atención al cliente España: 900-800-303
Atención al cliente Portugal: 800-827-836
Fax para pedidos: 93-445-81-36

Las imágenes de SuperPoderes para SuperHéroes se ofrecen únicamente con fines ilustrativos. El funcionamiento del producto depende de la aplicación clínica adecuada y de factores individuales del paciente. Salvo que se indique lo contrario, tal y como se especifica en el presente documento, todas las marcas comerciales y los derechos de propiedad intelectual son propiedad de ZimVie Inc. o sus filiales, y todos los productos son fabricados por una o varias de las filiales dentales de ZimVie US Corp LLC (Biomet 3i, LLC, etc.), y distribuidos por ZimVie US Corp LLC y sus socios comerciales autorizados. Clasificación del MDR de la UE: implantes dentales (clase IIb), pilares y blanks dentales (clase IIb), herramientas (clase IIa y clase I), cuerpo de escaneo (clase I). Puedes obtener más información sobre la finalidad prevista de los dispositivos en: labeling.ZimVie.com. Los productos aquí mostrados no cumplen los criterios para el reembolso en Francia. Para otros países, consulta las leyes y normativas locales. Si deseas más información sobre algún producto, consulta el etiquetado o las instrucciones de uso del producto en cuestión. La autorización y la disponibilidad del producto pueden estar limitadas a ciertos países o regiones. Este material está destinado exclusivamente a odontólogos y no incluye asesoramiento ni recomendaciones de carácter médico. Queda prohibida su distribución a ningún otro destinatario. Está prohibido copiar o reimprimir este material sin el consentimiento expreso por escrito de ZimVie. ZVINST0241-EMEA-ES REV 2 07/26 ©2026 ZimVie. Todos los derechos reservados.

El número de NB aplicable a cada dispositivo se puede encontrar en la etiqueta del producto, si procede. CE 2797 CE 0123 CE