Catalogue produits

Système d'implants
T3® PRO
Immediate Molar

ZimVie

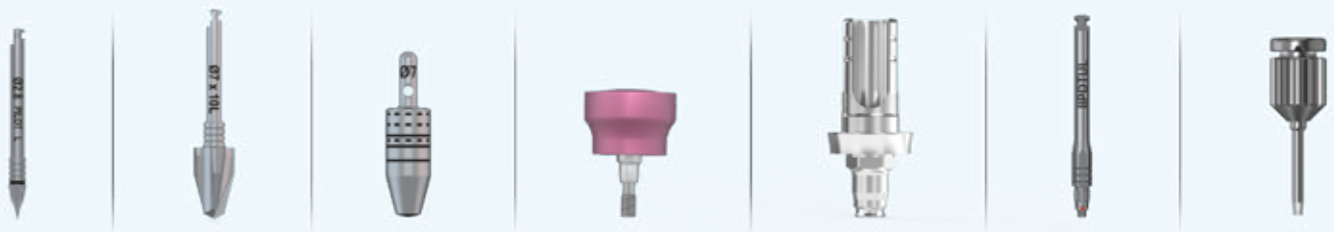

ZimVie

Table des matières

Pour T3 PRO Immediate Molar **5**

Trousse chirurgicale et modules T3 PRO **6**

Instrumentation chirurgicale 10

Connecteurs de pose pour implant 11

Solutions prothétiques **12**

Piliers de cicatrisation 12

Restaurations provisoires 13

Restaurations CFAO définitives 13

Composants prothétiques GenTek® 14

Prothèses façonnables 16

Composants pour prothèses scellées 16

Prise d'empreinte et vis de piliers GingiHue® et UCLA 16

Prothèses vissées 17

Vis **18**

Instruments prothétiques **19**

REMARQUE : les images dans ce manuel sont représentatives et peuvent ne pas être à l'échelle ou ne pas correspondre à la géométrie ou à la couleur exacte des composants réels.

Super-pouvoirs

pour des

super-héros

Pour T3 PRO Immediate Molar

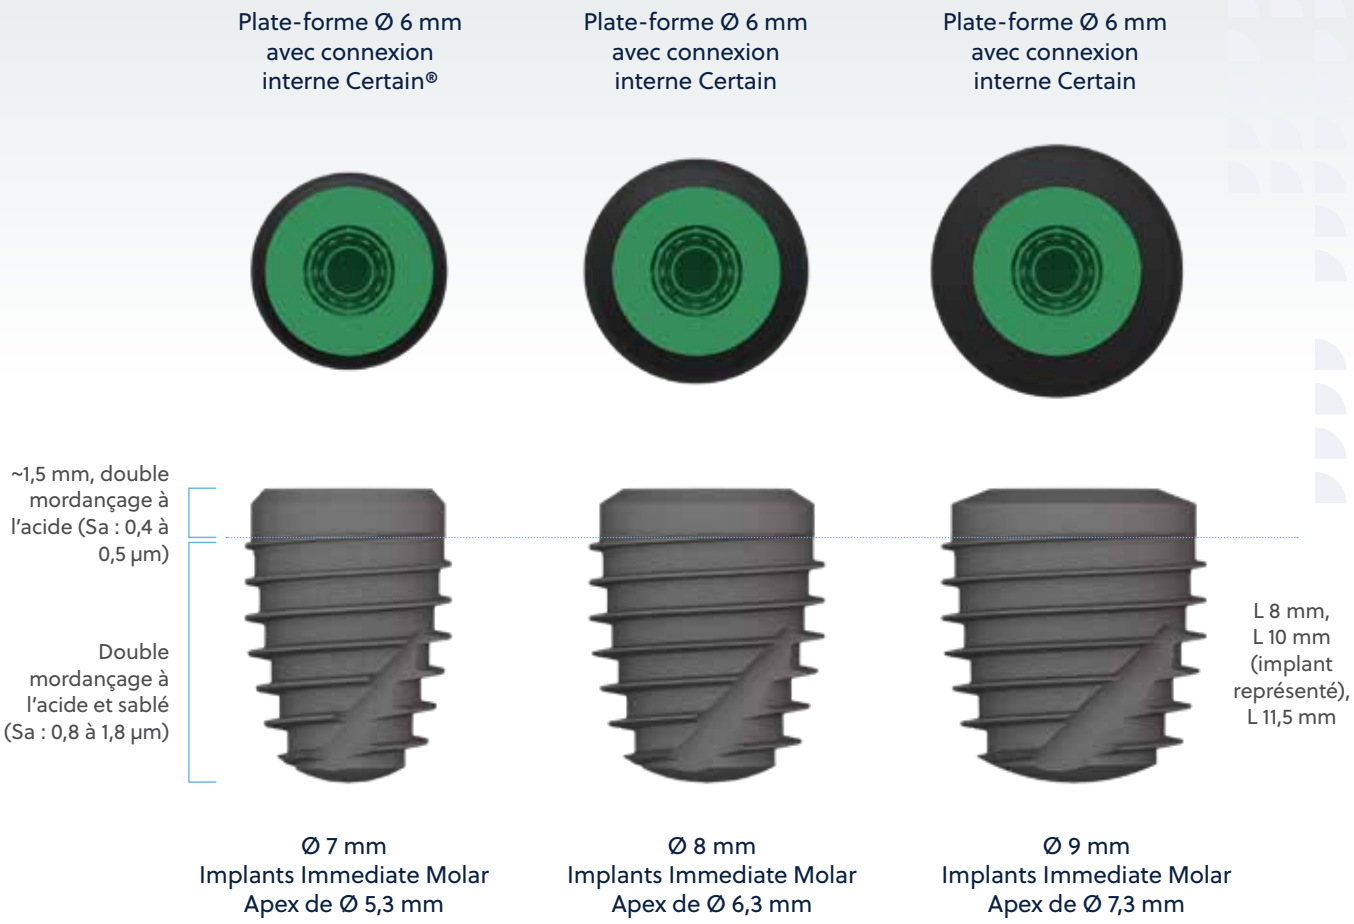

Diamètre de l'implant	Plate-forme implantaire	Connexion	Longueur de l'implant		
			L 8 mm	L 10 mm	L 11,5 mm
Ø 7,0 mm	Ø 6,0 mm	Implants à connexion interne Certain	T3PIM7D8L	T3PIM7D10L	T3PIM7D115L
Ø 8,0 mm	Ø 6,0 mm	Implants à connexion interne Certain	T3PIM8D8L	T3PIM8D10L	T3PIM8D115L
Ø 9,0 mm	Ø 6,0 mm	Implants à connexion interne Certain	T3PIM9D8L	T3PIM9D10L	T3PIM9D115L

Vis de couverture chirurgicale

Désignation	Plate-forme implantaire	Référence
Vis de couverture, plate (incluse avec l'implant)	Ø 6,0 mm	ICSF60

Trousse chirurgicale et modules T3 PRO Immediate Molar

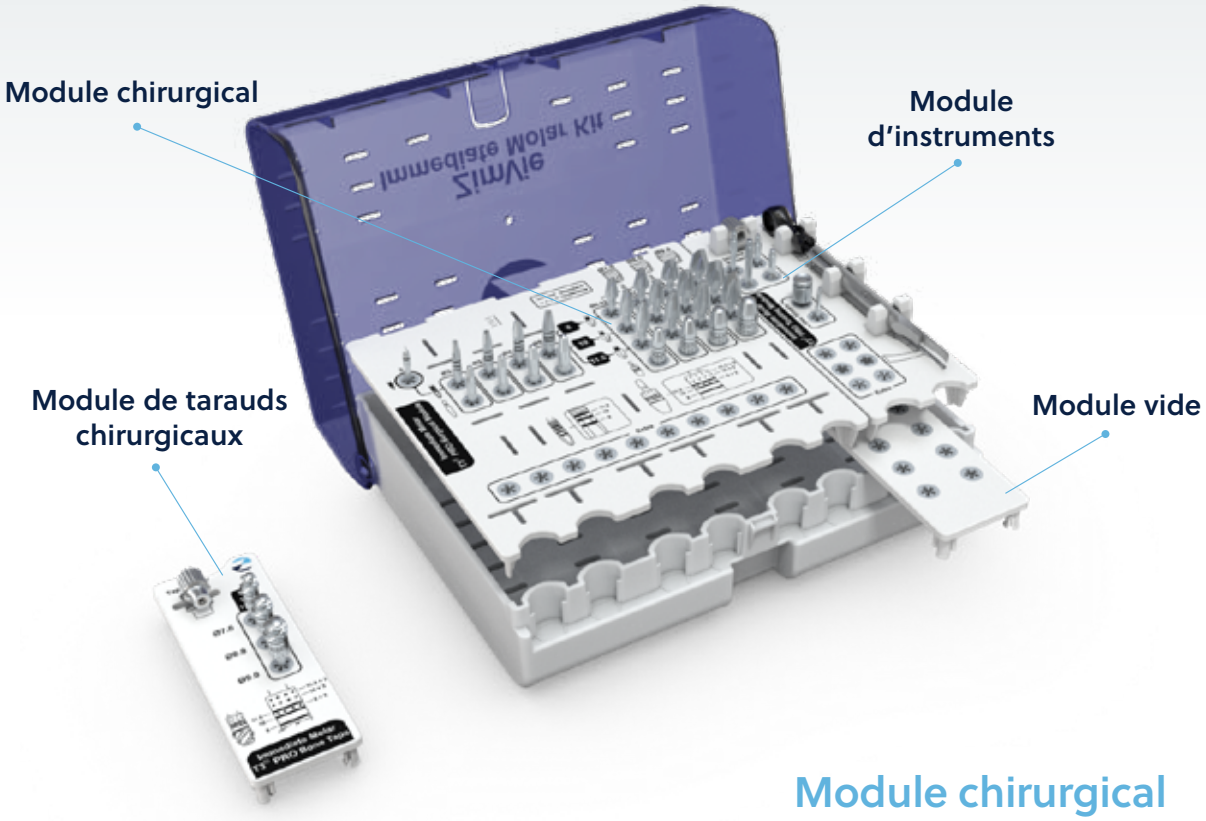

1 **IMDR28L** Foret pointeur pilote Ø 2,8 mm, long

2 **IMDR34T3P** Foret conique T3 PRO Ø 3,4 mm

3 **IMDR38T3P** Foret conique T3 PRO Ø 3,8 mm

4 **IMDR44T3P** Foret conique T3 PRO Ø 4,4 mm

5 **IMDR51T3P** Foret conique T3 PRO Ø 5,1 mm

6 **IMDIR34** Jauge de direction Ø 3,4 mm

7 **IMDIR38** Jauge de direction Ø 3,8 mm

8 **IMDIR44** Jauge de direction Ø 4,4 mm

9 **IMDIR51** Jauge de direction Ø 5,1 mm

Module chirurgical

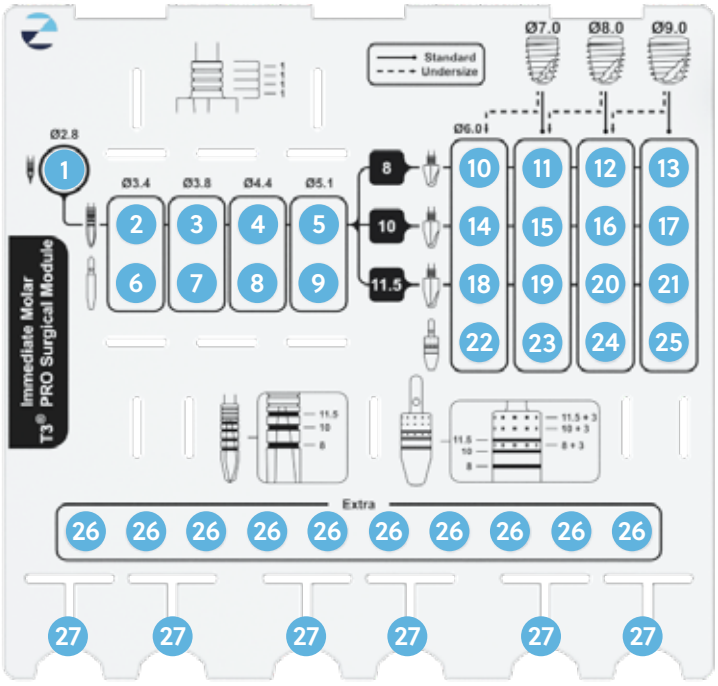

26 **Emplacements vides**

27 **Emplacements pour conditionnement d'implant**

10
IMDR68
Foret de façonnage
Ø 6 mm,
L 8 mm

11
IMDR78
Foret de façonnage
Ø 7 mm,
L 8 mm

12
IMDR88
Foret de façonnage
Ø 8 mm,
L 8 mm

13
IMDR98
Foret de façonnage
Ø 9 mm,
L 8 mm

14
IMDR610
Foret de façonnage
Ø 6 mm,
L 10 mm

15
IMDR710
Foret de façonnage
Ø 7 mm,
L 10 mm

16
IMDR810
Foret de façonnage
Ø 8 mm,
L 10 mm

17
IMDR910
Foret de façonnage
Ø 9 mm,
L 10 mm

18
IMDR611
Foret de façonnage
Ø 6 mm,
L 11,5 mm

19
IMDR711
Foret de façonnage
Ø 7 mm,
L 11,5 mm

20
IMDR811
Foret de façonnage
Ø 8 mm,
L 11,5 mm

21
IMDR911
Foret de façonnage
Ø 9 mm,
L 11,5 mm

22
IMDI6
Jauge de profondeur
Ø 6 mm,
L 8-11,5 mm

23
IMDI7
Jauge de profondeur
Ø 7 mm,
L 8-11,5 mm

24
IMDI8
Jauge de profondeur
Ø 8 mm,
L 8-11,5 mm

25
IMDI9
Jauge de profondeur
Ø 9 mm,
L 8-11,5 mm

Module d'instruments

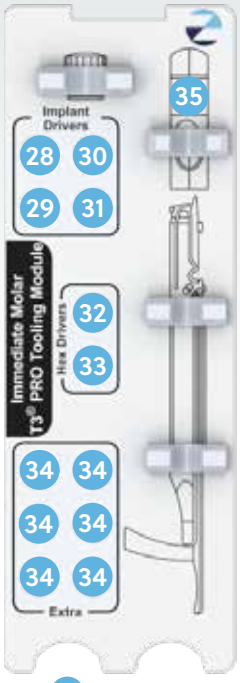

34
Emplacements vides

28
IIPDTUL
Connecteur de pose universel pour implants à connexion interne (long)

30
IIPDTUS
Connecteur de pose universel pour implants à connexion interne (court)

29
IRE200U
Connecteur de pose universel Certain pour clé dynamométrique chirurgicale (long)

31
IRE100U
Connecteur de pose universel Certain pour clé dynamométrique chirurgicale (court)

32
PHD02N
Tournevis hexagonal
Ø 1,2 mm, L 17 mm

33
IHX1.2D
Tournevis mandrin hexagonal pour contre-angle avec rétention GemLock, Ø 1,2 mm, L 24 mm

35
H-TIRW
Clé dynamométrique chirurgicale à couple élevé

Tarauds chirurgicaux (en option)

36
ISOHEXADPT
Adaptateur pour tarauds chirurgicaux

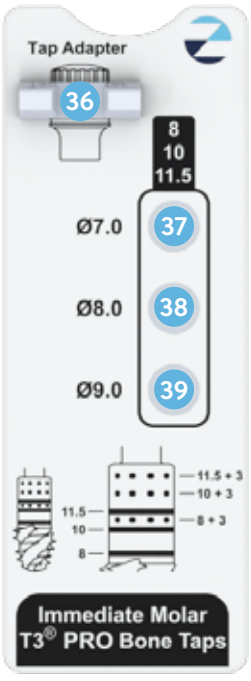

37
IMT7
Taraud chirurgical
Ø 7 mm,
L 8-11,5 mm

38
IMT8
Taraud chirurgical
Ø 8 mm,
L 8-11,5 mm

39
IMT9
Taraud chirurgical
Ø 9 mm,
L 8-11,5 mm

Trousse chirurgicale T3 PRO Immediate Molar, complète

Désignation	Référence
Trousse chirurgicale T3 PRO Immediate Molar, complète	IMKITT3P

Remarque : Les tarauds chirurgicaux sont des instruments en option et ne sont pas inclus dans la trousse chirurgicale. Un module de tarauds chirurgicaux peut être acheté séparément et ajouté à la trousse. La trousse chirurgicale comprend également un module non rempli avec 10 emplacements vides.

Composants de la trousse chirurgicale T3 PRO Immediate Molar

	Réf.	Désignation	IMKITT3P
Foret pointeur pilote	IMDR28L	Foret pointeur pilote pour implant Immediate Molar Ø 2,8 mm, long (30 mm) ◆	X
Forets coniques	IMDR34T3P	Foret conique pour implant T3 PRO Immediate Molar, Ø 3,4 mm	X
	IMDR38T3P	Foret conique pour implant T3 PRO Immediate Molar, Ø 3,8 mm	X
	IMDR44T3P	Foret conique pour implant T3 PRO Immediate Molar, Ø 4,4 mm	X
	IMDR51T3P	Foret conique pour implant T3 PRO Immediate Molar, Ø 5,1 mm	X
Forets de façonnage	IMDR68	Foret de façonnage pour implant Immediate Molar Ø 6 mm, L 8 mm	X
	IMDR610	Foret de façonnage pour implant Immediate Molar Ø 6 mm, L 10 mm	X
	IMDR611	Foret de façonnage pour implant Immediate Molar Ø 6 mm, L 11,5 mm	X
	IMDR78	Foret de façonnage pour implant Immediate Molar Ø 7 mm, L 8 mm	X
	IMDR710	Foret de façonnage pour implant Immediate Molar Ø 7 mm, L 10 mm	X
	IMDR711	Foret de façonnage pour implant Immediate Molar Ø 7 mm, L 11,5 mm	X
	IMDR88	Foret de façonnage pour implant Immediate Molar Ø 8 mm, L 8 mm	X
	IMDR810	Foret de façonnage pour implant Immediate Molar Ø 8 mm, L 10 mm	X
	IMDR811	Foret de façonnage pour implant Immediate Molar Ø 8 mm, L 11,5 mm	X
	IMDR98	Foret de façonnage pour implant Immediate Molar Ø 9 mm, L 8 mm	X
	IMDR910	Foret de façonnage pour implant Immediate Molar Ø 9 mm, L 10 mm	X
	IMDR911	Foret de façonnage pour implant Immediate Molar Ø 9 mm, L 11,5 mm	X
Jauges de direction	IMDIR34	Jauge de direction pour implant Immediate Molar Ø 3,4 mm	X
	IMDIR38	Jauge de direction pour implant Immediate Molar Ø 3,8 mm	X
	IMDIR44	Jauge de direction pour implant Immediate Molar Ø 4,4 mm	X
	IMDIR51	Jauge de direction pour implant Immediate Molar Ø 5,1 mm	X
Jauges de profondeur	IMDI6	Jauge de profondeur pour implant Immediate Molar Ø 6 mm, L 8-11,5 mm	X
	IMDI7	Jauge de profondeur pour implant Immediate Molar Ø 7 mm, L 8-11,5 mm	X
	IMDI8	Jauge de profondeur pour implant Immediate Molar Ø 8 mm, L 8-11,5 mm	X
	IMDI9	Jauge de profondeur pour implant Immediate Molar Ø 9 mm, L 8-11,5 mm	X
Systèmes d'implants Connecteurs de pose pour implant	IRE100U	Connecteur de pose pour implant universel Certain pour clé dynamométrique chirurgicale (court)	X
	IRE200U	Connecteur de pose pour implant universel Certain pour clé dynamométrique chirurgicale (long)	X
	IIPDTUS	Connecteur de pose universel Certain pour contre-angle (court)	X
	IIPDTUL	Connecteur de pose universel pour implants à connexion interne (long)	X
Tournevis prothétiques	IHX1.2D	Tournevis mandrin hexagonal pour contre-angle avec rétention GemLock, Ø 1,2 mm, L 24 mm	X
	PHD02N	Tournevis hexagonal Ø 1,2 mm, L 17 mm	X
Clé dynamométrique	H-TIRW	Clé dynamométrique chirurgicale à couple élevé	X

◆ IMDR28S : Foret pour implant Immediate Molar Ø 2,8 mm court (27 mm) disponible séparément.

Tarauds chirurgicaux (en option)

Désignation	Référence
Module de tarauds chirurgicaux T3 PRO Immediate Molar	IMT3PTAPS
Composants	
Taraud pour implant Immediate Molar Ø 7,0 mm, L 8-11,5 mm	IMT7
Taraud pour implant Immediate Molar Ø 8,0 mm, L 8-11,5 mm	IMT8
Taraud pour implant Immediate Molar Ø 9,0 mm, L 8-11,5 mm	IMT9
Adaptateur pour clé dynamométrique à couple élevé*	ISOHEXADPT

* **Remarque :** Les tarauds chirurgicaux pour implant Immediate Molar ont une connexion ISO Latch spécifique. Cet adaptateur permet l'utilisation manuelle des tarauds chirurgicaux pour implant Immediate Molar lorsqu'il est couplé à la clé dynamométrique chirurgicale à couple élevé ZimVie (H-TIRW).

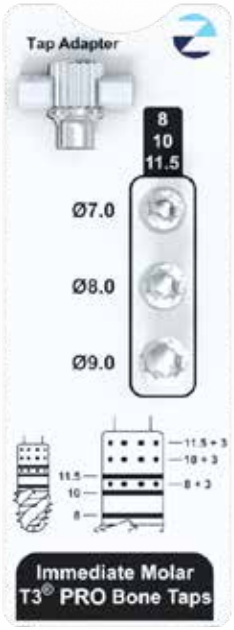

Plateau et modules vides

Désignation	Référence
Trousse chirurgicale T3 PRO Immediate Molar Comprend un couvercle et une base de trousse chirurgicale, un module d'instruments et chirurgical vide	IMKITT3PUNP
Module chirurgical T3 PRO Immediate Molar	IMT3PDRILLSUNP
Module d'instruments T3 PRO Immediate Molar	IMT3PTOOLINGUNP
Module de tarauds chirurgicaux T3 PRO Immediate Molar	IMT3PTAPSUNP
Support de module, vide, maintient solidement les instruments avec verrouillage certifié ISO	UNPMODTRAY

Instrumentation chirurgicale

Forets pointeurs pilotes

Désignation	Référence
Foret pilote pointeur pour implant Immediate Molar Ø 2,8 mm, court^	IMDR28S
Foret pilote pointeur pour implant Immediate Molar Ø 2,8 mm, long*	IMDR28L

^Disponible à la vente séparément
*Inclus dans la trousse chirurgicale T3 PRO Immediate Molar

Forets coniques

Désignation	Référence
Foret pour implant T3 PRO Immediate Molar, Ø 3,4 mm	IMDR34T3P
Foret pour implant T3 PRO Immediate Molar, Ø 3,8 mm	IMDR38T3P
Foret pour implant T3 PRO Immediate Molar, Ø 4,4 mm	IMDR44T3P
Foret pour implant T3 PRO Immediate Molar, Ø 5,1 mm	IMDR51T3P

Forets de façonnage

Diamètre	L 8 mm	L 10 mm	L 11,5 mm
Ø 6,0 mm	IMDR68	IMDR610	IMDR611
Ø 7,0 mm	IMDR78	IMDR710	IMDR711
Ø 8,0 mm	IMDR88	IMDR810	IMDR811
Ø 9,0 mm	IMDR98	IMDR910	IMDR911

Jauges de direction

Désignation	Référence
Jauge de direction pour implant Immediate Molar Ø 3,4 mm	IMDIR34
Jauge de direction pour implant Immediate Molar Ø 3,8 mm	IMDIR38
Jauge de direction pour implant Immediate Molar Ø 4,4 mm	IMDIR44
Jauge de direction pour implant Immediate Molar Ø 5,1 mm	IMDIR51

Jauges de profondeur

Désignation	Référence
Jauge de profondeur pour implant Immediate Molar Ø 6 mm, L 8-11,5 mm	IMDI6
Jauge de profondeur pour implant Immediate Molar Ø 7 mm, L 8-11,5 mm	IMDI7
Jauge de profondeur pour implant Immediate Molar Ø 8 mm, L 8-11,5 mm	IMDI8
Jauge de profondeur pour implant Immediate Molar Ø 9 mm, L 8-11,5 mm	IMDI9

Connecteurs de pose pour implant

Connecteurs de pose pour implant

Désignation	Mode d'utilisation	Référence
Connecteur de pose pour implant universel Certain pour clé dynamométrique chirurgicale (long)	Clé dynamométrique chirurgicale	IRE200U
Connecteur de pose pour implant universel Certain pour clé dynamométrique chirurgicale (court)	Clé dynamométrique chirurgicale	IRE100U
Connecteur de pose universel pour implants à connexion interne (long)	Contre-angle	IIPDTUL
Connecteur de pose universel pour implants à connexion interne (court)	Contre-angle	IIPDTUS

Tournevis pour vis chirurgicales et vis prothétiques

Désignation	Mode d'utilisation	Référence
Tournevis hexagonal manuel Ø 1,2 mm, L 17 mm	Manuel	PHD02N
Tournevis hexagonal manuel Ø 1,2 mm, L 24 mm	Manuel	PHD03N
Tournevis mandrin hexagonal pour contre-angle avec rétention GemLock, Ø 1,2 mm, L 24 mm	Contre-angle	IHX1.2D
Tournevis mandrin hexagonal pour contre-angle avec rétention GemLock, Ø 1,2 mm, L 30 mm	Contre-angle	IXL1.2D

Clé dynamométrique chirurgicale

Désignation	Référence
Clé dynamométrique chirurgicale à couple élevé, 0 à 90 Ncm (incluse dans le kit T3 PRO Immediate Molar)	H-TIRW

Solutions prothétiques – Piliers de cicatrisation

Encode® Emergence

Plate-forme prothétique	Profil d'émergence	Hauteur	
		3 mm (H)	5 mm (H)
Ø 6,0 mm	6,0 mm (P)	IEEHA663	IEEHA665
	6,8 mm (P)	IEEHA6683	IEEHA6685
	7,5 mm (P)	IEEHA673	IEEHA675



Pilier de cicatrisation traditionnel monobloc EP®

Plate-forme prothétique	Profil d'émergence	Hauteur transgingivale				
		2 mm (H)	3 mm (H)	4 mm (H)	6 mm (H)	8 mm (H)
Ø 6,0 mm	6,0 mm (P)	ISWHA62	ISWHA63	ISWHA64	ISWHA66	ISWHA68
	6,8 mm (P)	IWTH62	IWTH63	IWTH64	IWTH66	IWTH68
	7,5 mm (P)	IWTH672	IWTH673	IWTH674	IWTH676	IWTH678

Restaurations provisoires

Piliers PreFormance®
(Matériaux : Polyétherétherkétone (PEEK) : connexion en alliage de titane)

Plate-forme prothétique	Profil d'émergence	Hauteur transgingivale			
		4 mm (H)		6 mm (H)	
		Droit	Angulation 15 °	Droit	Angulation 15 °
Ø 6,0 mm	6,0 mm (P)	IWPFP664	IPAPF664	IWPFP666	IPAPF666

Cylindres provisoires

Cylindres provisoires PreFormance
(matériau : Polyétherétherkétone (PEEK) - connexion en alliage de titane)

Plate-forme prothétique	Désignation	
	Antirotationnel	Rotationnel
Ø 6,0 mm	IWPFTC61	IWPFTC62

Cylindres provisoires Titane
(matériau : connexion en alliage de titane)

Plate-forme prothétique	Désignation	
	Antirotationnel	Rotationnel
Ø 6,0 mm	IWTCS61	IWTCS62

Remarque : Tous les piliers temporaires (piliers et cylindres provisoires PreFormance) incluent la vis à tête hexagonale en titane correspondante (UNIHT).

Restaurations CFAO définitives

Conception assistée par ordinateur et précision CFAO avec usinage personnalisé.

Contacter un représentant de ZimVie pour obtenir des informations supplémentaires.

Composants prothétiques GenTek®

Ti-Bases GenTek®

Contenu : Vis hexalobulaires Gold-Tite® et vis de collage

Hauteur coronaire	Plate-forme prothétique	Hauteur transgingivale	Ti-Base avec engagement	Ti-Base sans engagement
7 mm	Ø 5,0 mm	0,3 mm	ZFX11ZB-CE50ASZ03E	ZFX11ZB-CE50ASZ03N
		1,3 mm	ZFX11ZB-CE50AS13E	ZFX11ZB-CE50AS13N
		2,6 mm	ZFX11ZB-CE50AS26E	-

Remarque : Les implants Immediate Molar peuvent être restaurés avec des composants prothétiques de 5,0 mm.

Vis pour Ti-Bases GenTek

Désignation	Ti-Base avec engagement	Ti-Base sans engagement
Vis hexalobulaire Gold-Tite	ZFX09-ZB-CE-HLGTE	ZFX09-ZB-CE-HLGTN
Vis Try-In hexalobulaire	ZFX09-ZB-CE-HLTISE	ZFX09-ZB CE-HLTISN

Ti-Bases GenTek avec bloc pré-percé

Contenu : Vis Gold-Tite et de collage

Hauteur coronaire	Plate-forme prothétique	Ti-Base avec engagement	Ti-Base sans engagement
7 mm	Ø 5,0 mm	ZFX11-ZB-CE-5047-EL	ZFX11-ZB-CE-5047-NEL

Remarque : Les implants Immediate Molar peuvent être restaurés avec des composants prothétiques de 5,0 mm.

Vis pour Ti-Bases GenTek avec bloc pré-percé

Désignation	Ti-Base avec engagement	Ti-Base sans engagement
Vis Gold-Tite	ZFX09-ZB-CE-HGTS	ZFX09-ZB-CE-LGTS
Vis Try-In	ZFX09-ZB-CE-HTIS	ZFX09-ZB-CE-NHTIS

Premilled en titane

Contenu : Vis Gold-Tite®

Plate-forme prothétique	Référence
Ø 5,0 mm	ZFX18-ZB-CE-4160

Remarque : Les implants Immediate Molar peuvent être restaurés avec des composants prothétiques de 5,0 mm.

Vis pour premilled en titane

Désignation	Référence
Vis Gold-Tite	ZFX09-ZB-CE-HGTS
Vis Try-In	ZFX09-ZB-CE-HTIS

Scanbodies GenTek

Contenu : Vis

Plate-forme prothétique	Référence
Ø 6,0 mm	ZFX05Z-ZB-CE-60

Analogues numériques GenTek

Contenu : Vis

Plate-forme prothétique	Référence
Ø 6,0 mm	ZFX15Z-ZB-CE-60

Accessoires pour analogues numériques GenTek

Désignation	Référence
Vis de fixation d'analogue numérique *(pack de 4 vis)*	ZFX15Z-FS

Prothèses façonnables

Piliers UCLA en or antirotationnels
Matériau : base de surcoulée usinée en alliage d'or avec cylindre calcinable

Plate-forme prothétique	Désignation	Matériau	Référence
Ø 6,0 mm	Antirotationnel	Or	IWGA61C
	Rotationnel (avec vis de large diamètre Gold-Tite®)	Or	IWGA62C
	Rotationnel (avec vis de large diamètre Titane)	Or	IWGA62T

Remarque : Les piliers antirotationnels en Or UCLA n'incluent pas la vis.
La vis définitive Gold-Tite (IUNISG) doit être commandée séparément.

Composants pour prothèses scellées

Piliers GingiHue® (matériau : alliage de titane)

Plate-forme prothétique	Profil d'émergence	Hauteur transgingivale			
		2 mm (H)		4 mm (H)	
		Droit	Angulation 15 °	Droit	Angulation 15 °
Ø 6,0 mm	6,0 mm (P)	IWPP662G	IPAP662G	IWPP664G	IPAP664G
	7,5 mm (P)	IWPP672G	IPAP672G	IWPP674G	IPAP672G

Prise d'empreinte et vis de piliers GingiHue et UCLA

Transfert d'empreinte Pick-Up

Plate-forme prothétique	Profil d'émergence	Référence
Ø 6,0 mm	6,0 mm	IWIP60
	6,8 mm	IWIP66
	7,5 mm	IWIP67

Transferts d'empreinte Twist Lock™

Plate-forme prothétique	Profil d'émergence	Référence
Ø 6,0 mm	6,0 mm	IWIT60
	6,8 mm	IWIT66
	7,5 mm	IWIT67

Analogue de laboratoire

Plate-forme prothétique	Référence
Ø 6,0 mm	IILAW6

Composants supplémentaires et vis

Désignation	Référence
Vis Gold-Tite	IUNIHG
Vis d'essayage (lot de 5)	IUNITS
Porte-pilier de laboratoire	ILTAH57
Vis à large tête hexagonale Gold-Tite	ILRGHG

Prothèses vissées

Piliers Low Profile (matériau : alliage de titane)

Plate-forme prothétique	Hauteur transgingivale	Droit (rotationnel)	Droit (antirotationnel)	Angulé 17° (antirotationnel)	Angulé 30° (antirotationnel)
Ø 5,0 mm*	1,0 mm	ILPC541U	ILPC541	—	—
	2,0 mm	ILPC542U	ILPC542	ILPAC5217	—
	3,0 mm	ILPC543U	ILPC543	—	ILPAC5330
	4,0 mm	ILPC544U	ILPC544	ILPAC5417	—
	5,0 mm	—	—	—	ILPAC5530



*** Remarque :** Les implants Immediate Molar peuvent être restaurés avec des composants prothétiques de 5,0 mm.

Composants pour piliers Low Profile

Désignation	Plate-forme prothétique de 4,8 mm
Transfert d'empreinte Pick-Up (antirotationnel) ⬢	LPCPIC1
Transfert d'empreinte Pick-Up (rotationnel) ⬢	LPCPIC2
Transfert d'empreinte Twist Lock (antirotationnel) ○	LPCTIC1
Transfert d'empreinte Twist Lock (rotationnel) ○	LPCTIC2
Transfert d'empreinte QuickBridge®	LPCRIC
Analogue de laboratoire	LPCLA
Cylindre provisoire (antirotationnel)	LPCTC1
Cylindre provisoire (rotationnel)	LPCTC2
Coiffe de cicatrisation ⬢	LPCHC
Cylindre provisoire PreFormance sur LP (antirotationnel)	LPCPTC1
Cylindre provisoire PreFormance sur LP (rotationnel)	LPCPTC2
QuickBridge	LPCQB
Coiffe de remplacement QuickBridge	LPCQBCAP
Extension distale	LPCDE
Cylindre de surcoulée base en or sur LP (antirotationnel)	LPCGC1
Cylindre de surcoulée base en or sur LP (rotationnel)	LPCGC2
Cylindre calcinable sur LP (antirotationnel)	LPCCC1
Cylindre calcinable sur LP (rotationnel)	LPCCC2
Cylindre pour soudure au laser	LPCTUCA
Vis de laboratoire	LPCWS
Vis de fixation ⬢	LPCGSH, LPCTSH
Instrument de polissage	LPCAMI
Protection pour le polissage	LPCPP

Compatibilité des piliers		
Composants	Pilier LP antirotationnel	Pilier LP rotationnel
Antirotationnel	Oui	Non
Rotationnel	Oui	Oui

⬢ = Nécessite l'utilisation d'un tournevis hexagonal PHD02N, PHD03N ou d'un tournevis mandrin hexagonal IHX1.2D, IXL1.2D, RASH3N, RASH8N

○ = Nécessite l'utilisation du connecteur de pose pour transfert d'empreinte ICD00

Vis

Vis de pilier

	Vis Gold-Tite	Vis Titane	Vis Large Gold-Tite	Vis Large Titane
Vis	IUNIHG	IUNIHT	ILRGHG	ILRGHT
Connecteurs de pose pour implant	PHD02N, PHD03N	PHD02N, PHD03N	PHD02N, PHD03N	PHD02N, PHD03N
Connecteurs de pose à mandrin	IHX1.2D, IXL1.2D, RASH3N, RASH8N	IHX1.2D, IXL1.2D, RASH3N, RASH8N	IHX1.2D, IXL1.2D, RASH3N, RASH8N	IHX1.2D, IXL1.2D, RASH3N, RASH8N
Couple de serrage	20 Ncm	20 Ncm	20 Ncm	20 Ncm
Pour utilisation avec :	GenTek antirotationnel, pilier UCLA, pilier GingiHue droit, pilier GingiHue 15°, cylindre provisoire antirotationnel	Pilier UCLA, pilier GingiHue droit, pilier GingiHue 15°, cylindre provisoire antirotationnel	Pilier UCLA rotationnel, piliers Express et GenTek rotationnels, cylindre provisoire rotationnel, barres	Pilier UCLA rotationnel, pilier UCLA, cylindre provisoire rotationnel, barres

Vis de fixation

	Vis de fixation Gold-Tite pour pilier Low Profile	Vis de fixation titane pour pilier Low Profile
Vis	LPCGSH	LPCTSH
Connecteurs de pose pour implant	PHD02N, PHD03N	PHD02N, PHD03N
Connecteurs de pose à mandrin	IHX1.2D, IXL1.2D, RASH3N, RASH8N	IHX1.2D, IXL1.2D, RASH3N, RASH8N
Couple de serrage	10 Ncm	10 Ncm
Pour utilisation avec :	Pilier Low Profile	Pilier Low Profile

Vis de laboratoire et vis d'essayage

	Vis de laboratoire	Vis d'essayage antirotationnel (lot de 5)
Vis	IWSU30	IUNITS
Connecteurs de pose pour implant	PHD02N, PHD03N	PHD02N, PHD03N
Connecteurs de pose à mandrin	IHX1.2D, IXL1.2D, RASH3N, RASH8N	IHX1.2D, IXL1.2D, RASH3N, RASH8N
Pour utilisation avec :	Transferts Pick-Up et d'empreinte, procédures de laboratoire	Pilier UCLA antirotationnel, pilier GingiHue droit, pilier GingiHue 15°

Instruments prothétiques

Désignation	Référence
Clé dynamométrique prothétique à couple faible Contenu : Adaptateur standard ISO 1797 L-TIRW (C9980) ou	L-TIRW
Adaptateur pour contre-angle standard L-TIRW	C9980
Adaptateur pour contre-angle court L-TIRW	C9981
Alésoir et manche	IRH600
Instrument d'activation Certain QuickSeat®	IQSA01
Capuchon de protection pour le polissage, pilier UCLA, Ø 6 mm	IPPIA6
Capuchon de protection pour le polissage, pilier UCLA, Ø 3,4 mm, Ø 4,1 mm, Ø 5 mm, Ø 6 mm	ILTAH57
Kit de jauge d'essayage d'angulation prothétique, 15°, 25°, 35°	AG900
Pilier de mesure d'épaisseur de tissus mous	TMP80
Tournevis hexalobulaire pour vis de fixation hexalobulaire, L 21 mm	ZFX02HLD21
Tournevis hexalobulaire pour vis de fixation hexalobulaire, L 28 mm	ZFX02HLD28
Tournevis hexalobulaire pour vis de fixation hexalobulaire, L 36 mm	ZFX02HLD36

Kit d'extraction de vis

Désignation	Référence
Kit d'instruments de vis Certain	ISRT10N
Composants	
Cuillère de guidage pour connexion Certain	ISRT05N
Instrument d'extraction de vis Certain	ISRT06N
Foret manuel de récupération	USRT07
Vis de laboratoire/tige guide Certain	IWSU30

Désignation	Référence
Kit prothétique avec clé dynamométrique prothétique à couple faible	L-TIRWK
Composants	
Tournevis mandrin hexagonal pour contre-angle, étroit, L 24 mm	RASH3N
Tournevis mandrin à tête carrée pour contre-angle, court, L 24 mm	RASQ3N
Clé dynamométrique prothétique à couple faible	L-TIRW
Boite prothétique stérilisable	RTI2035TR

Connecteurs de pose pour piliers Low Profile

Désignation	Référence
Tournevis manuel court, L 17 mm	PAD00
Tournevis manuel long, L 24 mm	PAD24
Connecteur de pose pour contre-angle	RASA3



Tournevis pour vis chirurgicales et vis prothétiques

Désignation	Mode d'utilisation	Référence
Tournevis hexagonal manuel Ø 1,2 mm, L 17 mm	Manuel	PHD02N
Tournevis hexagonal manuel Ø 1,2 mm, L 24 mm	Manuel	PHD03N
Tournevis mandrin hexagonal pour contre-angle avec rétention GemLock, Ø 1,2 mm, L 24 mm	Contre-angle	IHX1.2D
Tournevis mandrin hexagonal pour contre-angle avec rétention GemLock, Ø 1,2 mm, L 30 mm	Contre-angle	IXL1.2D
Tournevis hexagonal en angle droit, étroit, L 24 mm		RASH3N
Embout de tournevis hexagonal en angle droit, étroit, L 30 mm		RASH8N

Connecteurs de pose pour transfert d'empreinte Twist Lock

Désignation	Référence
Connecteur de pose étroit pour transfert d'empreinte	ICD00

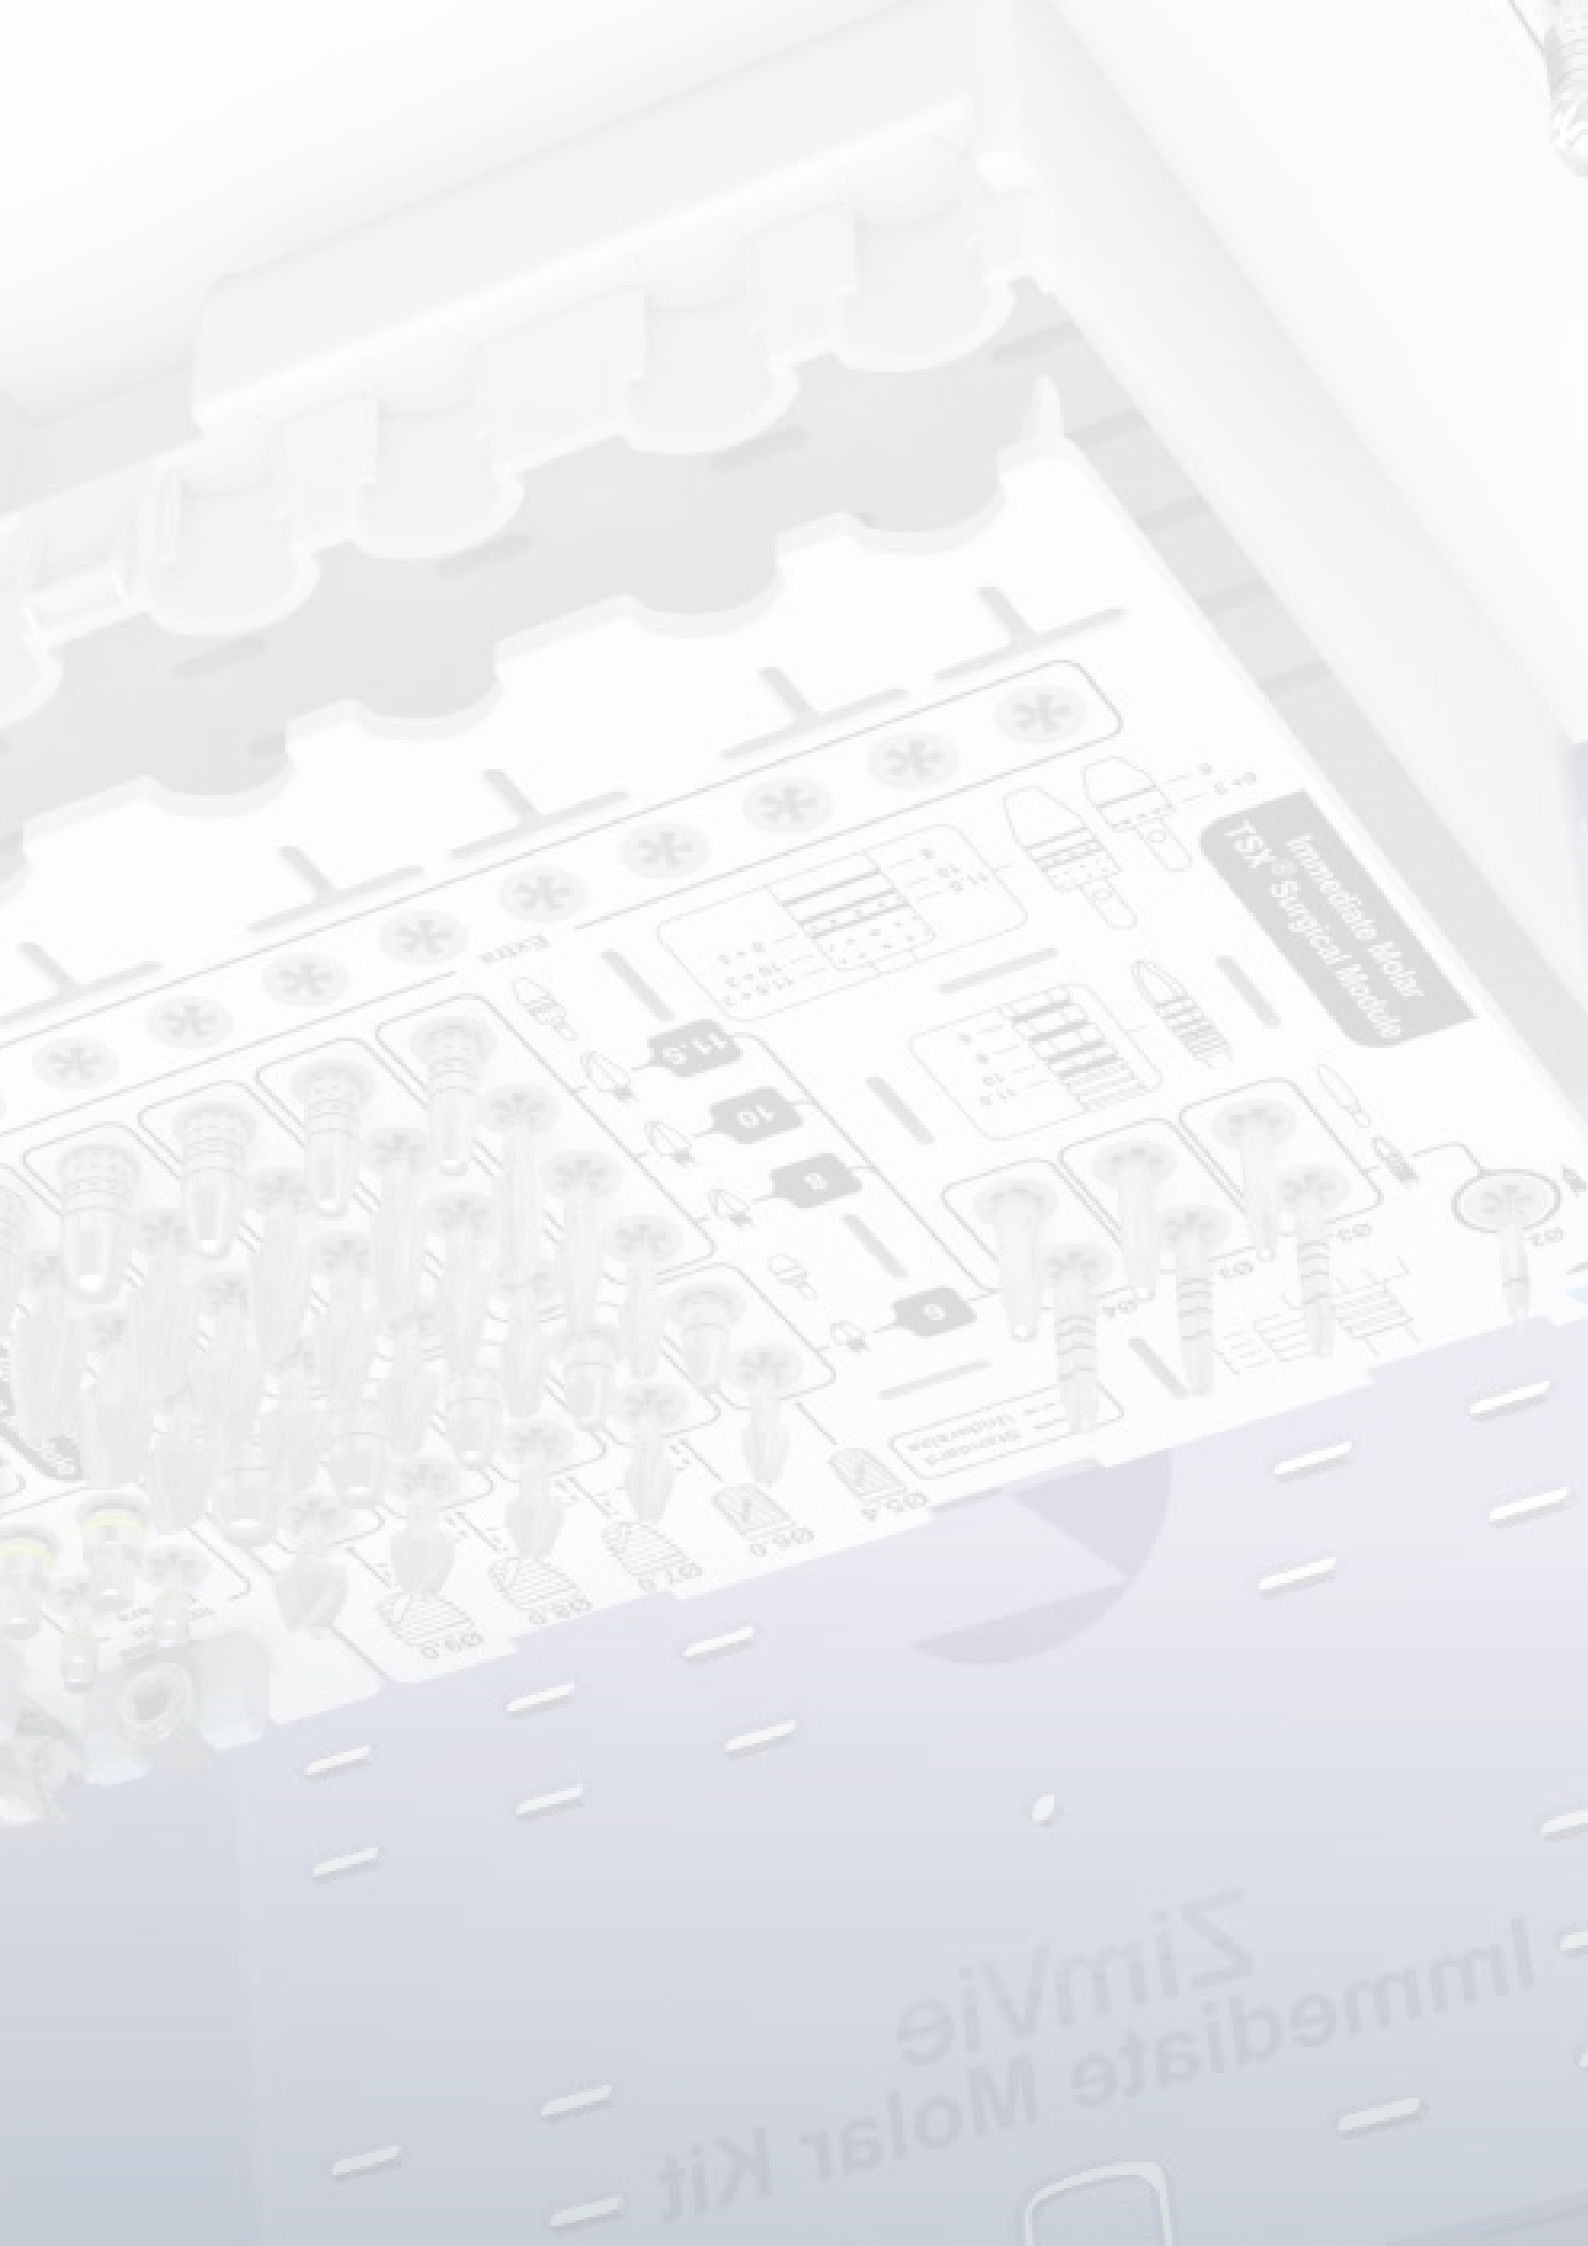
Immediate Molar
TSX Surgical Implant

Notes

Notes

Pour plus d'informations, consulter ZimVie.eu

ZimVie US Corp LLC
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410, États-Unis
Tél. : +1-561-776-6700
Télécopie : +1-561-776-1272
dentalCS@ZimVie.com

ZimVie France SAS
Bâtiment Québec
19 Rue d'Arcueil
94528 Rungis Cedex
Tel. : 0141-05-43-43
Fax : 0141-05-43-40
ZV.commandes@ZimVie.com

Les images Super-Pouvoirs pour des Super-Héros sont fournies à titre d'illustration uniquement. Les performances du produit dépendent d'une application clinique appropriée et de facteurs individuels propres au patient.

Sauf indication contraire, comme indiqué dans les présentes, toutes les marques de commerce et tous les droits de propriété intellectuelle sont la propriété de ZimVie Inc. et de ses filiales ; et tous les produits sont fabriqués par une ou plusieurs des filiales dentaires de ZimVie US Corp LLC (Biomet 3i, LLC, etc.) et distribués par ZimVie US Corp LLC et par ses partenaires de commercialisation autorisés. Classification au titre du RDM de l'UE : implants dentaires (Classe IIb), piliers dentaires et disques (Classe IIb), Instrumentation (Classe IIa et Classe I), Scanbody (Classe I). Pour plus d'informations sur l'utilisation prévue des dispositifs, consulter le site labeling.ZimVie.com. Les produits présentés ici ne sont pas remboursables en France. Pour les autres pays, veuillez consulter les lois et réglementations locales. Pour plus d'informations sur un produit, consulter l'étiquetage ou la notice d'utilisation du produit en question. L'autorisation et la disponibilité du produit peuvent être limitées à certains pays/certaines régions. Ce document s'adresse uniquement aux praticiens et n'a pas pour objectif de fournir un avis ou des recommandations d'ordre médical. La distribution à tout autre destinataire est formellement interdite. Ce document ne peut être ni copié ni réimprimé sans l'autorisation écrite expresse de ZimVie.

ZVINST0241-EMEA-FR REV 2 07/26 ©2026 ZimVie. Tous droits réservés.

Le numéro de l'ON applicable à chaque dispositif se trouve sur l'étiquetage de produit, le cas échéant.

CE 2797 CE 0123 CE