Catalogo dei prodotti

T3® PRO

Immediate Molar
Sistema implantare

ZimVie

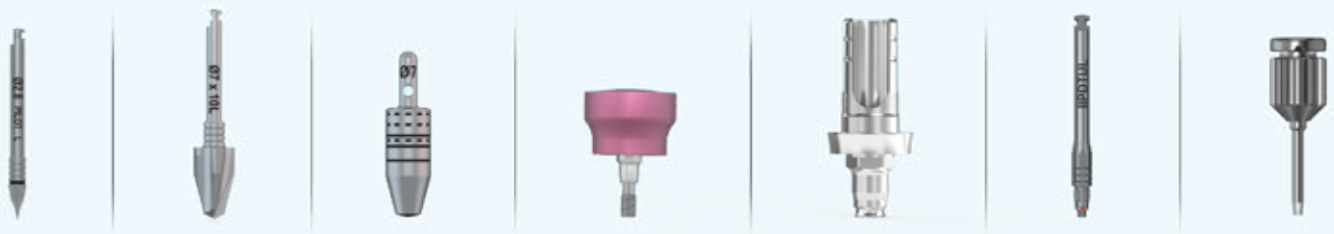

ZimVie

Indice

Impianti T3 PRO Immediate Molar	**5**
Kit chirurgico T3 PRO e moduli	**6**
Strumentazione chirurgica	10
Driver per impianti	11
Soluzioni protesiche	**12**
Abutment di guarigione	12
Restauri provvisori	13
Restauri definitivi con CAD/CAM	13
Componenti protesici GenTek®	14
Restauri calcinabili	16
Protesi cementate	16
Perno GingiHue® e componenti per abutment UCLA	16
Restauri avvitati	17
Viti	**18**
Strumenti protesici	**19**

NOTA: le immagini mostrate nel presente manuale sono di natura rappresentativa e potrebbero non essere in scala o mostrare la geometria esatta o il colore dei componenti effettivi.

Superpoteri

per

scenari complessi

Impianti T3 PRO Immediate Molar

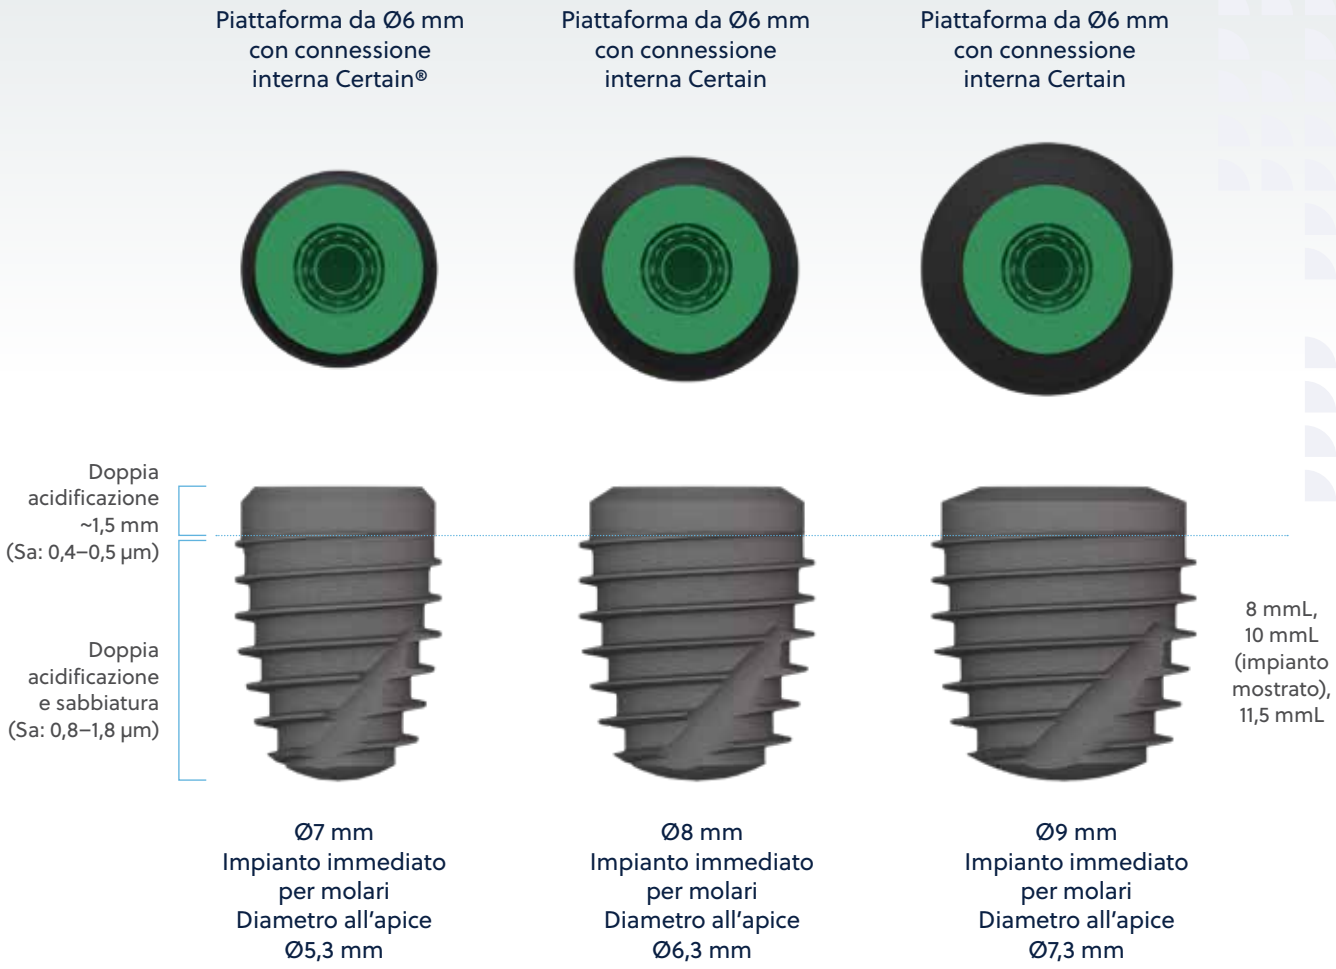

Diametro dell'impianto	Piattaforma implantare	Connessione	Lunghezza dell'impianto		
			8 mmL	10 mmL	11,5 mmL
Ø7,0 mm	Ø6,0 mm	Connessione interna Certain	T3PIM7D8L	T3PIM7D10L	T3PIM7D115L
Ø8,0 mm	Ø6,0 mm	Connessione interna Certain	T3PIM8D8L	T3PIM8D10L	T3PIM8D115L
Ø9,0 mm	Ø6,0 mm	Connessione interna Certain	T3PIM9D8L	T3PIM9D10L	T3PIM9D115L

Vite di copertura chirurgica

Descrizione	Piattaforma implantare	Codice
Vite di copertura, piatta (inclusa con l'impianto)	Ø6,0 mm	ICSF60

Kit chirurgico T3 PRO Immediate Molar e moduli

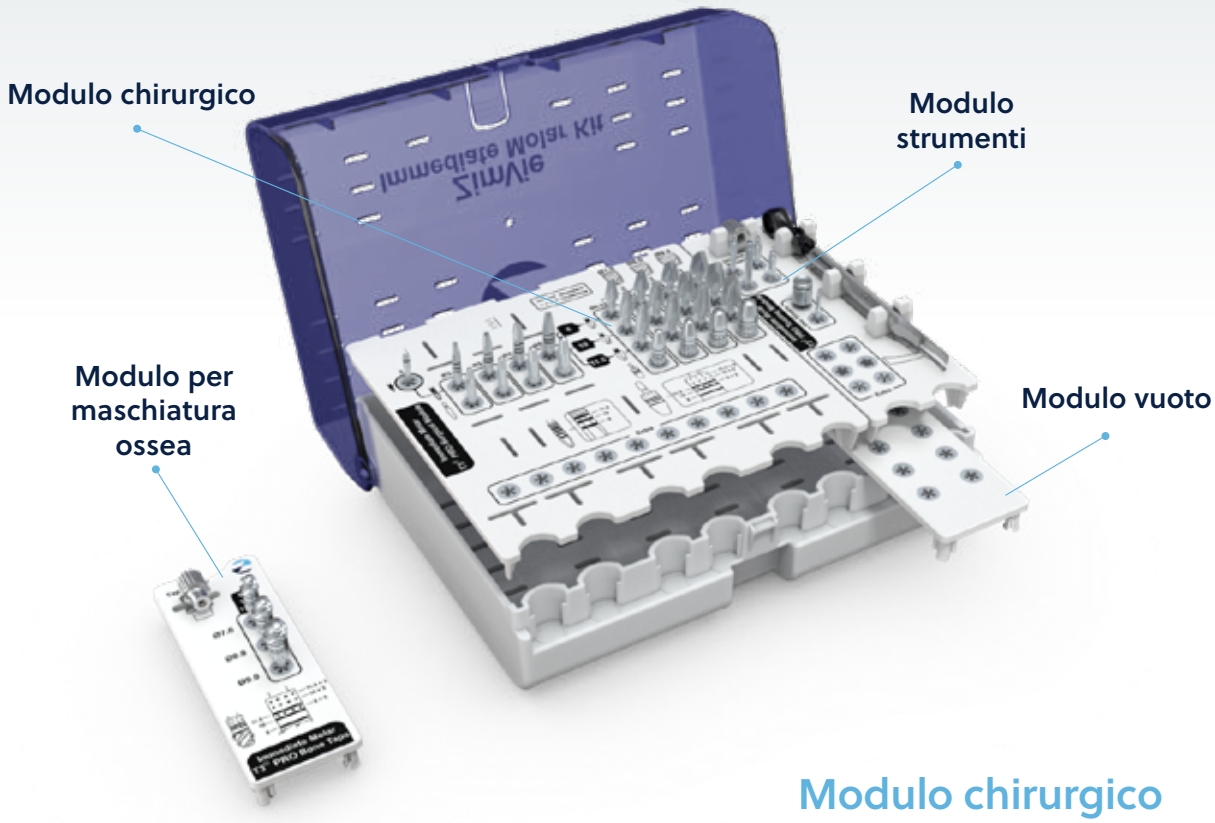

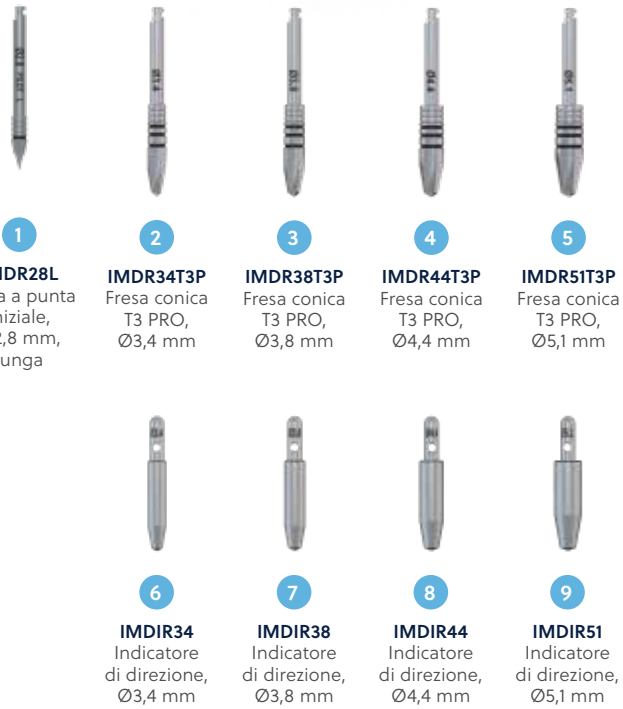

1 **IMDR28L**
Fresa a punta iniziale, Ø2,8 mm, lunga

2 **IMDR34T3P**
Fresa conica T3 PRO, Ø3,4 mm

3 **IMDR38T3P**
Fresa conica T3 PRO, Ø3,8 mm

4 **IMDR44T3P**
Fresa conica T3 PRO, Ø4,4 mm

5 **IMDR51T3P**
Fresa conica T3 PRO, Ø5,1 mm

6 **IMDIR34**
Indicatore di direzione, Ø3,4 mm

7 **IMDIR38**
Indicatore di direzione, Ø3,8 mm

8 **IMDIR44**
Indicatore di direzione, Ø4,4 mm

9 **IMDIR51**
Indicatore di direzione, Ø5,1 mm

Modulo chirurgico

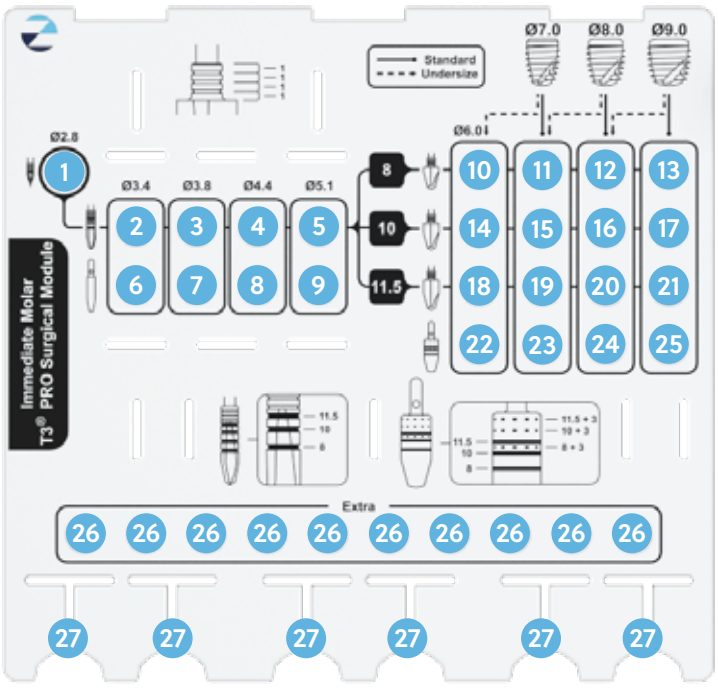

26 **Scomparti vuoti**

27 **Fessure per il posizionamento dell'impianto**

10

IMDR68
Fresa per profilo, Ø6 mm, 8 mmL

11

IMDR78
Fresa per profilo, Ø7 mm, 8 mmL

12

IMDR88
Fresa per profilo, Ø8 mm, 8 mmL

13

IMDR98
Fresa per profilo, Ø9 mm, 8 mmL

14

IMDR610
Fresa per profilo, Ø6 mm, 10 mmL

15

IMDR710
Fresa per profilo, Ø7 mm, 10 mmL

16

IMDR810
Fresa per profilo, Ø8 mm, 10 mmL

17

IMDR910
Fresa per profilo, Ø9 mm, 10 mmL

18

IMDR611
Fresa per profilo, Ø6 mm, 11,5 mmL

19

IMDR711
Fresa per profilo, Ø7 mm, 11,5 mmL

20

IMDR811
Fresa per profilo, Ø8 mm, 11,5 mmL

21

IMDR911
Fresa per profilo, Ø9 mm, 11,5 mmL

22

IMDI6
Indicatore di profondità Ø6 mm, 8–11,5 mmL

23

IMDI7
Indicatore di profondità Ø7 mm, 8–11,5 mmL

24

IMDI8
Indicatore di profondità Ø8 mm, 8–11,5 mmL

25

IMDI9
Indicatore di profondità Ø9 mm, 8–11,5 mmL

Modulo strumenti

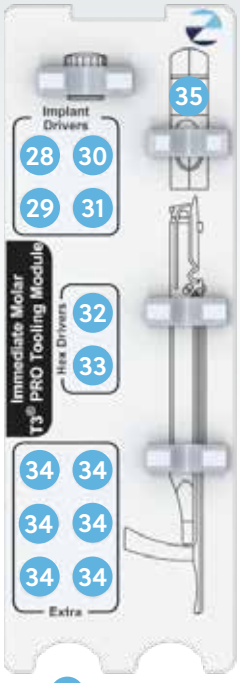

34

Scomparti vuoti

28

IIPDTUL
Punta per driver per il posizionamento universale di impianti con connessione interna (lunga)

30

IIPDTUS
Punta per driver per il posizionamento universale di impianti con connessione interna (corta)

29

IRE200U
Driver per estensione del cricchetto universale Certain (lungo)

31

IRE100U
Driver per estensione del cricchetto universale Certain (corto)

32

PHD02N
Driver esagonale Ø1,2 mm, 17 mmL

33

IHX1.2D
Driver esagonale con blocco a scatto e ritenzione GemLock, Ø1,2 mm, 24 mmL

35

H-TIRW
Chiave a cricchetto con indicazione torque elevato (0–90 Ncm)

Maschiatori ossei (opzionali)

36

ISOHEXADPT
Adattatore ISO esagonale con torque elevato (0–90 Ncm)

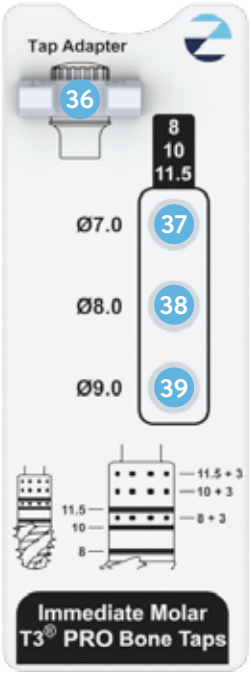

37

IMT7
Maschiatore osseo, Ø7 mm, 8–11,5 mmL

38

IMT8
Maschiatore osseo, Ø8 mm, 8–11,5 mmL

39

IMT9
Maschiatore osseo, Ø9 mm, 8–11,5 mmL

Kit chirurgico T3 PRO Immediate Molar, completo

Descrizione	Codice
Kit chirurgico T3 PRO Immediate Molar, completo	IMKITT3P

Nota: i maschiatori ossei sono strumenti opzionali e non sono inclusi nel kit chirurgico. È possibile acquistare separatamente un modulo per maschiatura ossea e aggiungerlo al kit. Il kit chirurgico include anche un modulo senza strumenti con 10 scomparti vuoti.

Componenti del kit chirurgico T3 PRO Immediate Molar

	SKU	Descrizione	IMKITT3P
Fresa a punta iniziale	IMDR28L	Fresa a punta iniziale Immediate Molar, Ø2,8 mm, lunga (30 mm) ◆	X
Frese coniche	IMDR34T3P	Fresa conica T3 PRO Immediate Molar, Ø3,4 mm	X
	IMDR38T3P	Fresa conica T3 PRO Immediate Molar, Ø3,8 mm	X
	IMDR44T3P	Fresa conica T3 PRO Immediate Molar, Ø4,4 mm	X
	IMDR51T3P	Fresa conica T3 PRO Immediate Molar, Ø5,1 mm	X
Frese per profilo	IMDR68	Fresa per profilo Immediate Molar, Ø6 mm, 8 mmL	X
	IMDR610	Fresa per profilo Immediate Molar, Ø6 mm, 10 mmL	X
	IMDR611	Fresa per profilo Immediate Molar, Ø6 mm, 11,5 mmL	X
	IMDR78	Fresa per profilo Immediate Molar, Ø7 mm, 8 mmL	X
	IMDR710	Fresa per profilo Immediate Molar, Ø7 mm, 10 mmL	X
	IMDR711	Fresa per profilo Immediate Molar, Ø7 mm, 11,5 mmL	X
	IMDR88	Fresa per profilo Immediate Molar, Ø8 mm, 8 mmL	X
	IMDR810	Fresa per profilo Immediate Molar, Ø8 mm, 10 mmL	X
	IMDR811	Fresa per profilo Immediate Molar, Ø8 mm, 11,5 mmL	X
	IMDR98	Fresa per profilo Immediate Molar, Ø9 mm, 8 mmL	X
	IMDR910	Fresa per profilo Immediate Molar, Ø9 mm, 10 mmL	X
	IMDR911	Fresa per profilo Immediate Molar, Ø9 mm, 11,5 mmL	X
Indicatori di direzione	IMDIR34	Indicatore di direzione Immediate Molar, Ø3,4 mm	X
	IMDIR38	Indicatore di direzione Immediate Molar, Ø3,8 mm	X
	IMDIR44	Indicatore di direzione Immediate Molar, Ø4,4 mm	X
	IMDIR51	Indicatore di direzione Immediate Molar, Ø5,1 mm	X
Indicatori di profondità	IMDI6	Indicatore di profondità Immediate Molar Ø6 mm, 8–11,5 mmL	X
	IMDI7	Indicatore di profondità Immediate Molar Ø7 mm, 8–11,5 mmL	X
	IMDI8	Indicatore di profondità Immediate Molar Ø8 mm, 8–11,5 mmL	X
	IMDI9	Indicatore di profondità Immediate Molar Ø9 mm, 8–11,5 mmL	X
Driver per impianti	IRE100U	Driver per impianti per estensione del cricchetto universale Certain (corto)	X
	IRE200U	Driver per impianti per estensione del cricchetto universale Certain (lungo)	X
	IIPDTUS	Punta per driver per il posizionamento universale di impianti con connessione interna (corta)	X
	IIPDTUL	Punta per driver per il posizionamento universale di impianti con connessione interna (lunga)	X
Driver protesici	IHX1.2D	Driver esagonale con blocco a scatto e ritenzione GemLock, Ø1,2 mm, 24 mmL	X
	PHD02N	Driver esagonale Ø1,2 mm, 17 mmL	X
Chiave dinamometrica	H-TIRW	Chiave a cricchetto con indicatore di torque elevato	X

◆ IMDR28S: fresa Immediate Molar, Ø2,8 mm, corta (27 mm), disponibile separatamente.

Maschiatori ossei (opzionali)

Descrizione	Codice
Modulo maschiatori ossei T3 PRO Immediate Molar	IMT3PTAPS
Componenti	
Maschiatore Immediate Molar Ø7,0 mm, 8–11,5 mmL	IMT7
Maschiatore Immediate Molar Ø8,0 mm, 8–11,5 mmL	IMT8
Maschiatore Immediate Molar Ø9,0 mm, 8–11,5 mmL	IMT9
Adattatore esagonale con blocco a scatto e torque elevato*	ISOHEXADPT

*Nota: i maschiatori ossei Immediate Molar sono dotati di connessione con blocco a scatto specifica. Questo adattatore consente l'uso manuale dei maschiatori ossei Immediate Molar quando accoppiati alla chiave a cricchetto con indicatore di torque elevato (H-TIRW) ZimVie.

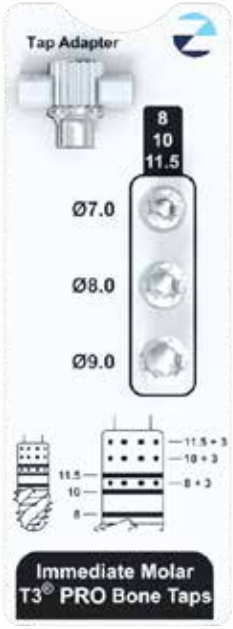

Vassoio e moduli vuoti

Descrizione	Codice
Kit chirurgico T3 PRO Immediate Molar Include coperchio e base per kit chirurgico, modulo chirurgico e strumenti vuoto	IMKITT3PUNP
Modulo chirurgico T3 PRO Immediate Molar	IMT3PDRILLSUNP
Modulo strumenti T3 PRO Immediate Molar	IMT3PTOOLINGUNP
Modulo maschiatori ossei T3 PRO Immediate Molar	IMT3PTAPSUNP
Vassoio modulare, vuoto, fissa saldamente gli strumenti a scatto ISO	UNPMODTRAY

Strumentazione chirurgica

Frese a punta iniziali

Descrizione	Codice
Fresa a punta iniziale Immediate Molar, Ø2,8 mm, corta^	IMDR28S
Fresa a punta iniziale Immediate Molar, Ø2,8 mm, lunga*	IMDR28L

^Acquistabile separatamente
*Inclusa nel kit chirurgico T3 PRO Immediate Molar

Frese coniche

Descrizione	Codice
Fresa T3 PRO Immediate Molar, Ø3,4 mm	IMDR34T3P
Fresa T3 PRO Immediate Molar, Ø3,8 mm	IMDR38T3P
Fresa T3 PRO Immediate Molar, Ø4,4 mm	IMDR44T3P
Fresa T3 PRO Immediate Molar, Ø5,1 mm	IMDR51T3P

Frese per profilo

Diametro	8 mmL	10 mmL	11,5 mmL
Ø6,0 mm	IMDR68	IMDR610	IMDR611
Ø7,0 mm	IMDR78	IMDR710	IMDR711
Ø8,0 mm	IMDR88	IMDR810	IMDR811
Ø9,0 mm	IMDR98	IMDR910	IMDR911

Indicatori di direzione

Descrizione	Codice
Indicatore di direzione Immediate Molar, Ø3,4 mm	IMDIR34
Indicatore di direzione Immediate Molar, Ø3,8 mm	IMDIR38
Indicatore di direzione Immediate Molar, Ø4,4 mm	IMDIR44
Indicatore di direzione Immediate Molar, Ø5,1 mm	IMDIR51

Indicatori di profondità

Descrizione	Codice
Indicatore di profondità Immediate Molar Ø6 mm, 8–11,5 mmL	IMDI6
Indicatore di profondità Immediate Molar Ø7 mm, 8–11,5 mmL	IMDI7
Indicatore di profondità Immediate Molar Ø8 mm, 8–11,5 mmL	IMDI8
Indicatore di profondità Immediate Molar Ø9 mm, 8–11,5 mmL	IMDI9

Driver per impianti

Driver per impianti

Descrizione	Modalità d'uso	Codice
Driver per impianti per estensione del cricchetto universale Certain (lungo)	Cricchetto	IRE200U
Driver per impianti per estensione del cricchetto universale Certain (corto)	Cricchetto	IRE100U
Punta per driver per il posizionamento universale di impianti con connessione interna (lunga)	Manipolo	IIPDTUL
Punta per driver per il posizionamento universale di impianti con connessione interna (corta)	Manipolo	IIPDTUS

Driver per viti chirurgiche e viti protesiche

Descrizione	Modalità d'uso	Codice
Driver esagonale manuale da Ø1,2 mm, 17 mmL	Manuale	PHD02N
Driver esagonale manuale da Ø1,2 mm, 24 mmL	Manuale	PHD03N
Driver esagonale con blocco a scatto e ritenzione GemLock, Ø1,2 mm, 24 mmL	Manipolo	IHX1.2D
Driver esagonale con blocco a scatto e ritenzione GemLock, Ø1,2 mm, 30 mmL	Manipolo	IXL1.2D

Chiave a cricchetto con indicatore di torque

Descrizione	Codice
Chiave a cricchetto con indicatore di torque elevato, 0–90 Ncm (inclusa nel kit T3 PRO Immediate Molar)	H-TIRW

Soluzioni protesiche
Abutment di guarigione

Encode® Emergence

Piattaforma protesica	Profilo di emergenza	Altezza	
		3 mmH	5 mmH
Ø6,0 mm	6,0 mmP	IEEHA663	IEEHA665
	6,8 mmP	IEEHA6683	IEEHA6685
	7,5 mmP	IEEHA673	IEEHA675



Abutment di guarigione monopezzo EP®

Piattaforma protesica	Profilo di emergenza	Altezza del collare				
		2 mmH	3 mmH	4 mmH	6 mmH	8 mmH
Ø6,0 mm	6,0 mmP	ISWHA62	ISWHA63	ISWHA64	ISWHA66	ISWHA68
	6,8 mmP	IWTH62	IWTH63	IWTH64	IWTH66	IWTH68
	7,5 mmP	IWTH672	IWTH673	IWTH674	IWTH676	IWTH678

Restauri provvisori

Perni PreFormance®
(materiale: PEEK - connessione in lega di titanio)

Piattaforma protesica	Profilo di emergenza	Altezza del collare			
		4 mmH		6 mmH	
		Dritto	Pre-angolato a 15°	Dritto	Pre-angolato a 15°
Ø6,0 mm	6,0 mmP	IWPFP664	IPAPF664	IWPFP666	IPAPF666

Cilindri temporanei

Cilindri temporanei PreFormance
(materiale: PEEK - connessione in lega di titanio)

Piattaforma protesica	Descrizione	
	Esagonale	Non esagonale
Ø6,0 mm	IWPFTC61	IWPFTC62

Cilindri temporanei in titanio (materiale: connessione in lega di titanio)

Piattaforma protesica	Descrizione	
	Esagonale	Non esagonale
Ø6,0 mm	IWTCS61	IWTCS62

Nota: tutti gli abutment provvisori (perni PreFormance e cilindri temporanei) includono la vite esagonale in titanio corrispondente (UNIHT).

Restauri definitivi con CAD/CAM

Progettazione assistita da computer e precisione CAD/CAM con fresature personalizzate.

Per ulteriori informazioni, contattare un rappresentante di ZimVie.

Componenti protesici GenTek®

Ti-Base GenTek®

Include: vite adesiva ed esalobata Gold-Tite®

Altezza perno	Piattaforma protesica	Altezza del collare	Ti-Base con ingaggio	Ti-Base senza ingaggio
7 mm	Ø5,0 mm	0,3 mm	ZFX11ZB-CE50ASZ03E	ZFX11ZB-CE50ASZ03N
		1,3 mm	ZFX11ZB-CE50AS13E	ZFX11ZB-CE50AS13N
		2,6 mm	ZFX11ZB-CE50AS26E	-

Nota: gli impianti Immediate Molar possono essere restaurati con componenti protesici da 5,0 mm.

Viti per Ti-Base GenTek

Descrizione	Ti-Base con ingaggio	Ti-Base senza ingaggio
Vite esalobata Gold-Tite	ZFX09-ZB-CE-HLGTE	ZFX09-ZB-CE-HLGTN
Vite Try-In esalobata	ZFX09-ZB-CE-HLTISE	ZFX09-ZB CE-HLTISN

Ti-Base GenTek con perno standard

Include: viti Gold-Tite e adesive

Altezza perno	Piattaforma protesica	Ti-Base con ingaggio	Ti-Base senza ingaggio
7 mm	Ø5,0 mm	ZFX11-ZB-CE-5047-EL	ZFX11-ZB-CE-5047-NEL

Nota: gli impianti Immediate Molar possono essere restaurati con componenti protesici da 5,0 mm.

Viti per Ti-Base GenTek con perno standard

Descrizione	Ti-Base con ingaggio	Ti-Base senza ingaggio
Vite Gold-Tite	ZFX09-ZB-CE-HGTS	ZFX09-ZB-CE-LGTS
Vite Try-In	ZFX09-ZB-CE-HTIS	ZFX09-ZB-CE-NHTIS

Blank per abutment prefresato in titanio

Include: Vite Gold-Tite®

Piattaforma protesica	Codice
Ø5,0 mm	ZFX18-ZB-CE-4160

Nota: gli impianti Immediate Molar possono essere restaurati con componenti protesici da 5,0 mm.

Viti per blank per abutment prefresati in titanio

Descrizione	Codice
Vite Gold-Tite	ZFX09-ZB-CE-HGTS
Vite Try-In	ZFX09-ZB-CE-HTIS

Scan body GenTek

Include: Vite

Piattaforma protesica	Codice
Ø6,0 mm	ZFX05Z-ZB-CE-60

Analoghi digitali GenTek

Include: Vite

Piattaforma protesica	Codice
Ø6,0 mm	ZFX15Z-ZB-CE-60

Accessori per analoghi digitali GenTek

Descrizione	Codice
Vite di fissaggio per analogo digitale *(4 viti per confezione)*	ZFX15Z-FS

Restauri calcinabili

Abutment UCLA dorato esagonale (materiale: cilindro in lega aurea lavorata con unitube in plastica)

Piattaforma protesica	Descrizione	Materiale	Codice
Ø6,0 mm	Esagonale	Oro	IWGA61C
	Non esagonale (con vite Gold-Tite® di diametro grande)	Oro	IWGA62C
	Non esagonale (con vite in Ti di diametro grande)	Oro	IWGA62T

Nota: gli abutment esagonali in oro UCLA non includono la vite.
La vite finale Gold-Tite (IUNIHG) deve essere ordinata separatamente.

Protesi cementate

Perni GingiHue® (materiale: lega di titanio)

Piattaforma protesica	Profilo di emergenza	Altezza del collare			
		2 mmH		4 mmH	
		Dritto	Pre-angolato a 15°	Dritto	Pre-angolato a 15°
Ø6,0 mm	6,0 mmP	IWPP662G	IPAP662G	IWPP664G	IPAP664G
	7,5 mmP	IWPP672G	IPAP672G	IWPP674G	IPAP672G

Perno GingiHue e componenti per abutment UCLA

Transfer da impronta di trasferimento

Piattaforma protesica	Profilo di emergenza	Codice
Ø6,0 mm	6,0 mm	IWIP60
	6,8 mm	IWIP66
	7,5 mm	IWIP67

Transfer da impronta Twist Lock™

Piattaforma protesica	Profilo di emergenza	Codice
Ø6,0 mm	6,0 mm	IWIT60
	6,8 mm	IWIT66
	7,5 mm	IWIT67

Analogo da laboratorio

Piattaforma protesica	Codice
Ø6,0 mm	IILAW6

Componenti aggiuntivi

Descrizione	Codice
Vite Gold-Tite	IUNIHG
Viti Try-In (confezione da 5)	IUNITS
Supporto per abutment da laboratorio	ILTAH57
Vite esagonale Gold-Tite grande	ILRGHG

Restauri avvitati

Abutment a basso profilo (materiale: lega di titanio)

Piattaforma protesica	Altezza del collare	Dritto (non esagonale)	Dritto (esagonale)	Angolato a 17° (esagonale)	Angolato a 30° (esagonale)
Ø5,0 mm*	1,0 mm	ILPC541U	ILPC541	—	—
	2,0 mm	ILPC542U	ILPC542	ILPAC5217	—
	3,0 mm	ILPC543U	ILPC543	—	ILPAC5330
	4,0 mm	ILPC544U	ILPC544	ILPAC5417	—
	5,0 mm	—	—	—	ILPAC5530



*Nota: Gli impianti Immediate Molar possono essere restaurati con componenti protesici da 5,0 mm.

Componenti per abutment a basso profilo

Descrizione	Piattaforma protesica da 4,8 mm
Cappetta per impronta di trasferimento (esagonale) ⬢	LPCPIC1
Cappetta per impronta di trasferimento (non esagonale) ⬢	LPCPIC2
Cappetta per impronta Twist Lock (esagonale) ○	LPCTIC1
Cappetta per impronta Twist Lock (non esagonale) ○	LPCTIC2
Cappetta per impronta QuickBridge®	LPCRIC
Analogo da laboratorio	LPCLA
Cilindro temporaneo (esagonale)	LPCTC1
Cilindro temporaneo (non esagonale)	LPCTC2
Cappetta di guarigione ⬢	LPCHC
Cilindro temp. PreFormance (esagonale)	LPCPTC1
Cilindro temp. PreFormance (non esagonale)	LPCPTC2
QuickBridge	LPCQB
Cappetta di ricambio QuickBridge	LPCQBCAP
Estensione distale	LPCDE
Cilindro in oro (esagonale)	LPCGC1
Cilindro in oro (non esagonale)	LPCGC2
Cilindro calcinabile (esagonale)	LPCCC1
Cilindro calcinabile (non esagonale)	LPCCC2
Cilindro saldato al laser	LPCTUCA
Vite per ceratura	LPCWS
Vite di ritenzione ⬢	LPCGSH, LPCTSH
Strumento per levigare	LPCAMI
Protezione per lucidatura	LPCPP

Compatibilità degli abutment		
Componente	Abutment esagonale	Abutment non esagonale
Esagonale	Sì	No
Non esagonale	Sì	Sì

⬢ = richiede l'uso di un driver esagonale PHD02N, PHD03N o di una punta per driver IHX1.2D, IXL1.2D, RASH3N, RASH8N

○ = richiede l'uso di un driver per transfer da impronta ICD00

Viti

Viti per abutment

	Vite Gold-Tite	Vite in titanio	Vite Gold-Tite grande	Vite in titanio grande
Viti	IUNIHG	IUNIHT	ILRGHG	ILRGHT
Driver	PHD02N, PHD03N	PHD02N, PHD03N	PHD02N, PHD03N	PHD02N, PHD03N
Punte per driver	IHX1.2D, IXL1.2D, RASH3N, RASH8N	IHX1.2D, IXL1.2D, RASH3N, RASH8N	IHX1.2D, IXL1.2D, RASH3N, RASH8N	IHX1.2D, IXL1.2D, RASH3N, RASH8N
Torque	20 Ncm	20 Ncm	20 Ncm	20 Ncm
Per l'uso con:	Abutment UCLA, Express e Flex esagonali, perno GingiHue, perno GingiHue 15°, cilindro temporaneo esagonale	Abutment UCLA, perno GingiHue, perno GingiHue 15°, cilindro temporaneo esagonale	Abutment UCLA non esagonali, abutment Express e Flex non esagonali, cilindro temporaneo non esagonale, barre	Abutment UCLA non esagonale, cilindro temporaneo non esagonale, barre

Viti di ritenzione

	Vite Gold-Tite per abutment a basso profilo	Vite in titanio per abutment a basso profilo
Viti	LPCGSH	LPCTSH
Driver	PHD02N, PHD03N	PHD02N, PHD03N
Punte per driver	IHX1.2D, IXL1.2D, RASH3N, RASH8N	IHX1.2D, IXL1.2D, RASH3N, RASH8N
Torque	10 Ncm	10 Ncm
Per l'uso con:	Abutment a basso profilo	Abutment a basso profilo

Viti per ceratura e viti Try-In

	Vite per ceratura da laboratorio	Vite esagonale Try-In (confezione da 5)
Viti	IWSU30	IUNITS
Driver	PHD02N, PHD03N	PHD02N, PHD03N
Punte per driver	IHX1.2D, IXL1.2D, RASH3N, RASH8N	IHX1.2D, IXL1.2D, RASH3N, RASH8N
Per l'uso con:	Transfer da impronta e prelievo, procedure di laboratorio a livello dell'impianto	Abutment UCLA esagonale, perno GingiHue, perno GingiHue 15°

Strumenti protesici

Descrizione	Codice
Chiave a cricchetto con indicatore di torque ridotto Include: adattatore L-TIRW standard ISO 1797 (C9980)	L-TIRW
Adattatore con blocco a scatto standard L-TIRW	C9980
Adattatore con blocco a scatto L-TIRW corto	C9981
Alesatore e manico	IRH600
Strumento attivatore Certain QuickSeat®	IQSA01
Protezione per lucidatura, abutment UCLA, Ø6 mm	IPPIA6
Protezione per lucidatura, abutment UCLA, Ø3,4 mm, Ø4,1 mm, Ø5 mm, Ø6 mm	ILTAH57
Kit guida protesica angolare, 15°, 25°, 35°	AG900
Perno di misurazione del tessuto	TMP80
Driver esalobato per vite di ritenzione esalobata, 21 mmL	ZFX02HLD21
Driver esalobato per vite di ritenzione esalobata, 28 mmL	ZFX02HLD28
Driver esalobato per vite di ritenzione esalobata, 36 mmL	ZFX02HLD36

Kit di rimozione per viti

Descrizione	Codice
Kit strumenti di rimozione per viti Certain	ISRT10N
Componenti	
Impugnatura con guida per fresa Certain	ISRT05N
Estrattore per la rimozione di viti Certain	ISRT06N
Fresa di rimozione manuale	USRT07
Vite per ceratura/perno guida Certain	IWSU30

Descrizione	Codice
Kit chiave a cricchetto con indicatore di torque ridotto	L-TIRWK
Componenti	
Punta stretta per driver esagonale ad angolo retto, 24 mmL	RASH3N
Punta stretta per driver quadrato ad angolo retto, 24 mmL	RASQ3N
Chiave a cricchetto con indicatore di torque ridotto	L-TIRW
Vassoio per chiave dinamometrica protesica	RTI2035TR

Driver per abutment a basso profilo

Descrizione	Codice
Driver per abutment posteriori, 17 mmL	PAD00
Driver per abutment posteriori, 24 mmL	PAD24
Punta per driver per abutment ad angolo retto, acciaio	RASA3



Driver per viti chirurgiche e viti protesiche

Descrizione	Modalità d'uso	Codice
Driver esagonale manuale da Ø1,2 mm, 17 mmL	Manuale	PHD02N
Driver esagonale manuale da Ø1,2 mm, 24 mmL	Manuale	PHD03N
Driver esagonale con blocco a scatto e ritenzione GemLock, Ø1,2 mm, 24 mmL	Manipolo	IHX1.2D
Driver esagonale con blocco a scatto e ritenzione GemLock, Ø1,2 mm, 30 mmL	Manipolo	IXL1.2D
Punta stretta per driver esagonale ad angolo retto, 24 mmL		RASH3N
Punta stretta per driver esagonale ad angolo retto, 30 mmL		RASH8N

Driver per transfer da impronta Twist Lock

Descrizione	Codice
Driver per transfer da impronta stretto	ICD00

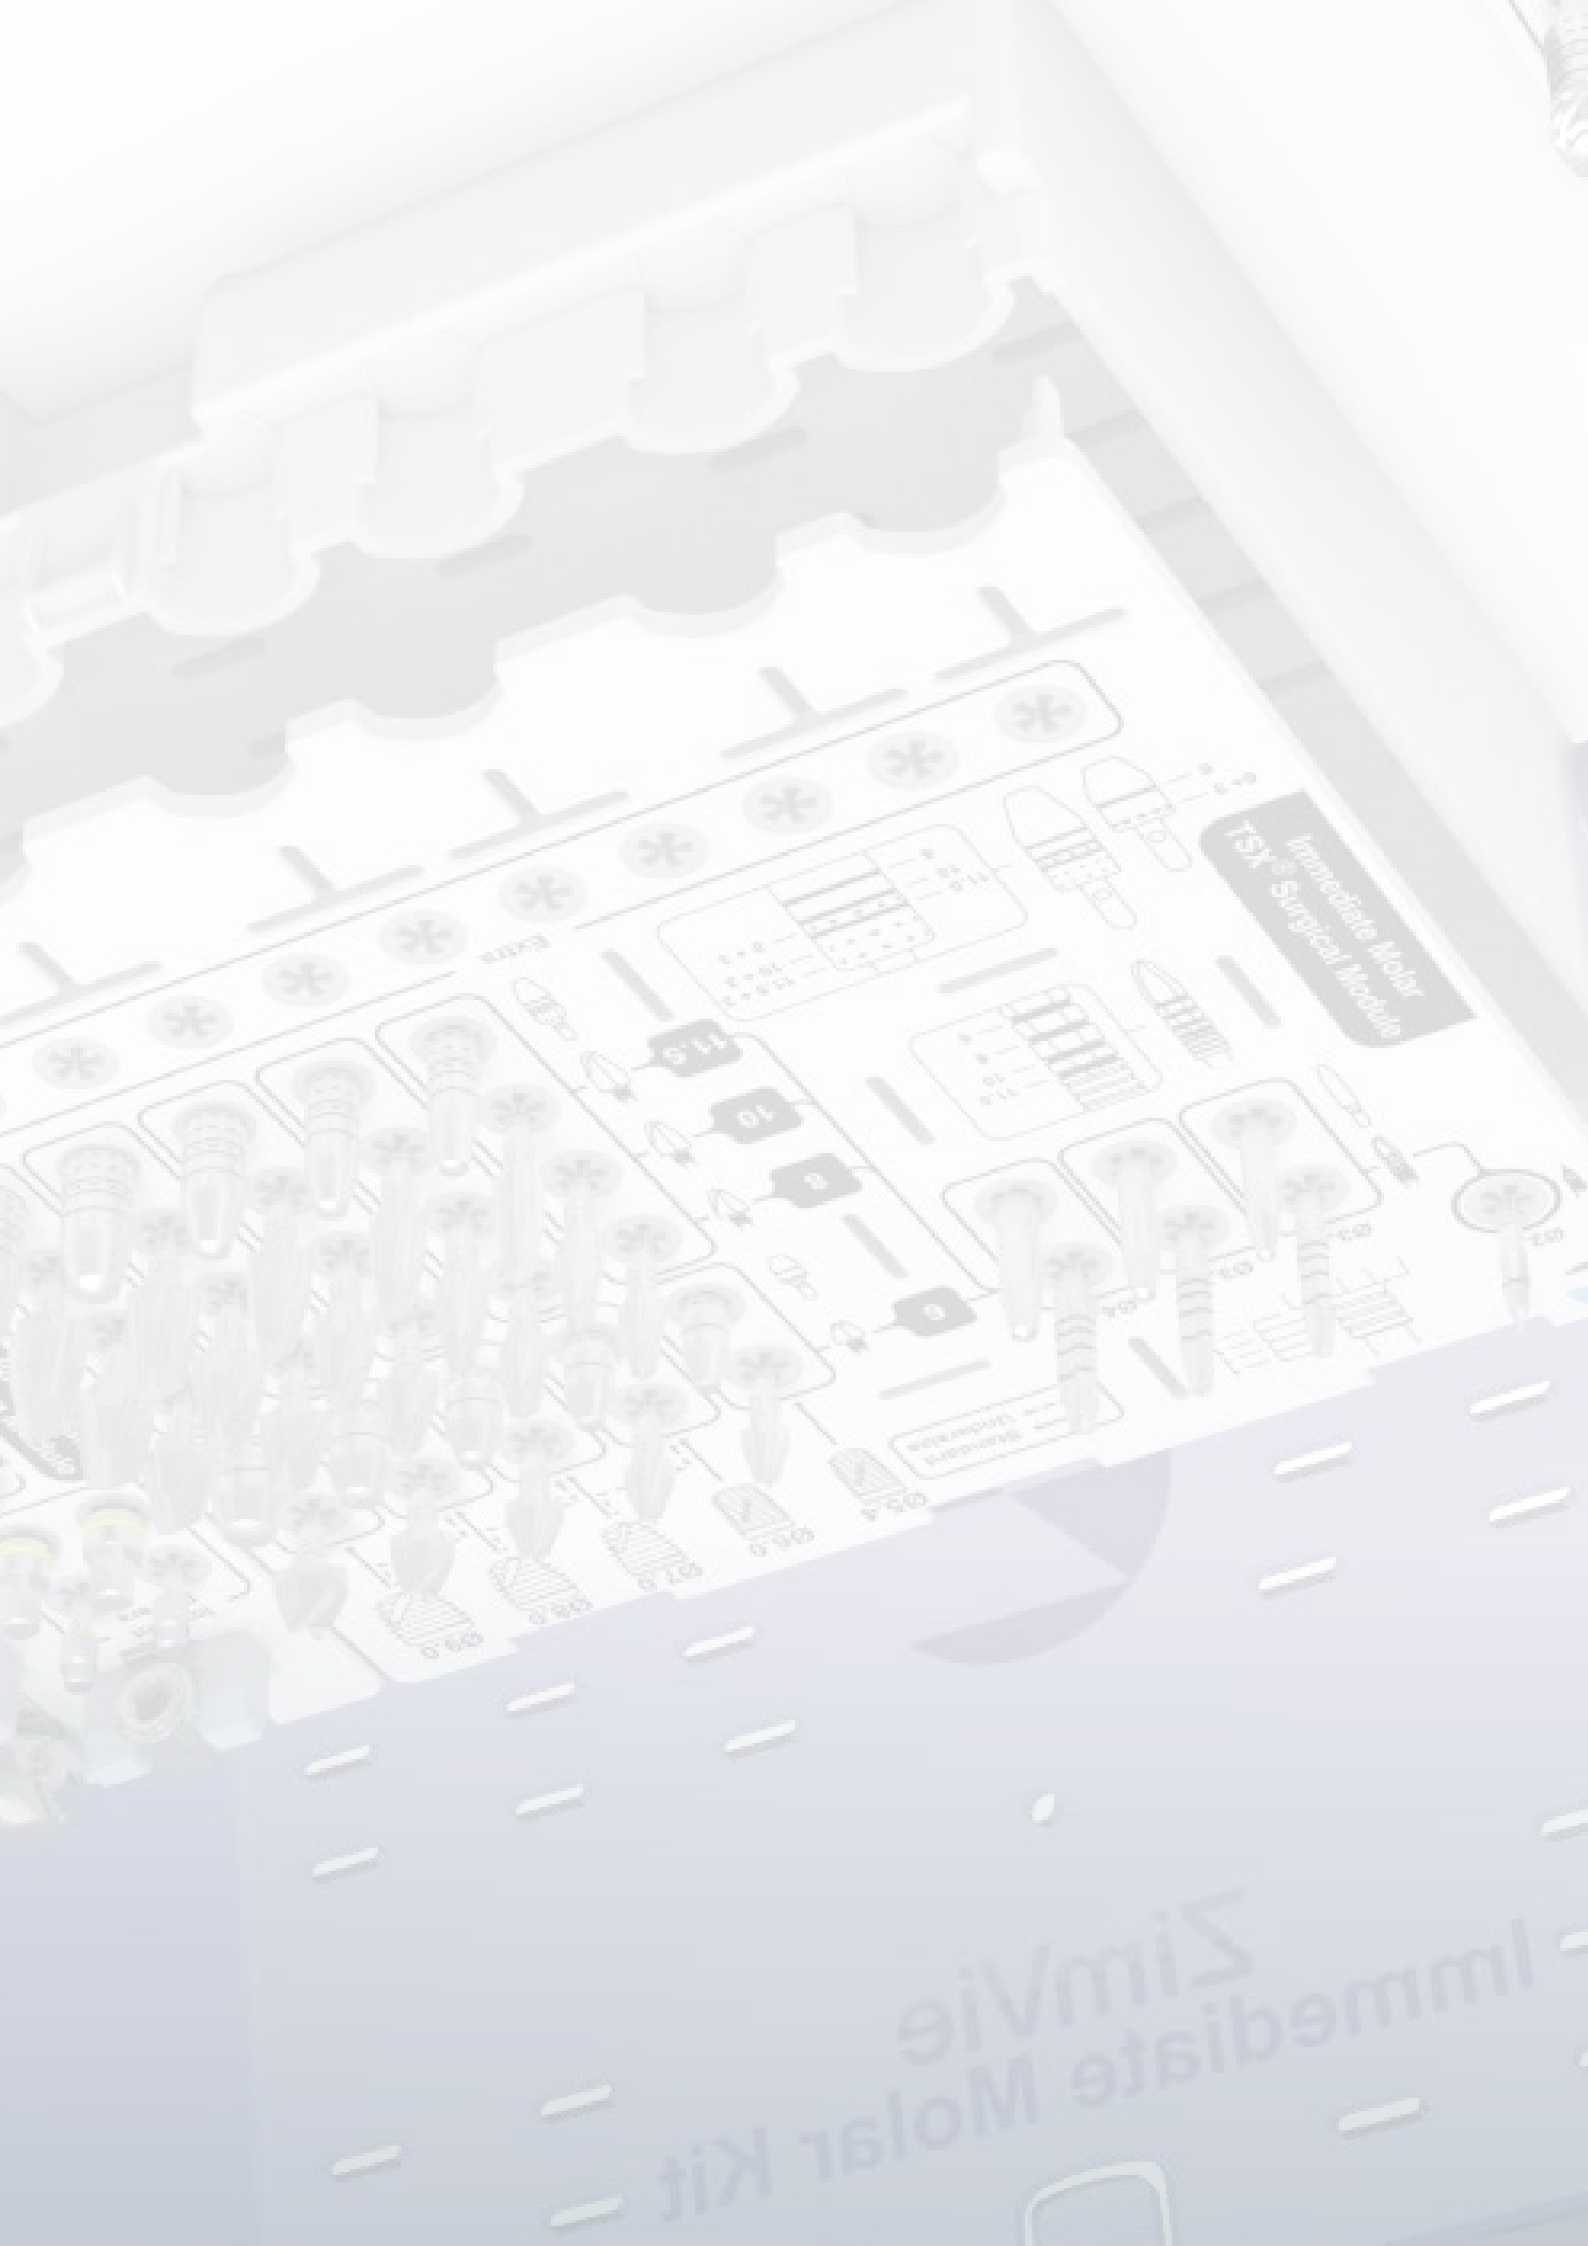
Immediate Molar
TSX Surgical Implant

Note

Note

Per ulteriori informazioni, visitare il sito ZimVie.eu

ZimVie US Corp LLC
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Tel.: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272
dentalCS@ZimVie.com

Le immagini Superpoteri per scenari complessi sono riportate a puro scopo illustrativo. Le prestazioni del prodotto dipendono dalla corretta applicazione clinica e dai fattori individuali del paziente. Salvo diverse indicazioni, tutti i marchi e i diritti di proprietà intellettuale qui indicati sono di proprietà di ZimVie Inc. e delle sue società affiliate. Tutti i prodotti sono fabbricati da una o più consociate di ZimVie US Corp LLC del settore dentale (Biomet 3i, LLC, ecc.) e sono distribuiti da ZimVie US Corp LLC e dai suoi partner commerciali autorizzati. Classificazione MDR UE: impianti dentali (Classe IIb), abutment e blank dentali (Classe IIb), strumenti (Classe IIa e Classe I), scan body (Classe I). Ulteriori informazioni sulla destinazione d'uso dei dispositivi sono disponibili all'indirizzo labeling.ZimVie.com. In Francia, i prodotti qui mostrati non sono rimborsabili. Per gli altri Paesi, consultare le leggi e le normative locali. Per ulteriori informazioni, vedere l'etichetta del singolo prodotto o le istruzioni per l'uso specifiche. L'autorizzazione alla distribuzione dei prodotti e la loro disponibilità potrebbero essere limitate a determinati Paesi/aree geografiche. Questo materiale è destinato esclusivamente ai medici e non include indicazioni o raccomandazioni di carattere medico. È vietata la distribuzione a qualsiasi altro destinatario. Questo materiale non può essere copiato o ristampato senza l'esplicito consenso scritto di ZimVie. ZVINST0241-EMEA-IT REV 2 07/26 ©2026 ZimVie. Tutti i diritti riservati.

Il numero NB applicabile a ciascun dispositivo è riportato sull'etichetta del prodotto, se pertinente.

CE 2797 CE 0123 CE