Catálogo de produtos

T3® PRO

Sistema de implante Immediate Molar

ZimVie

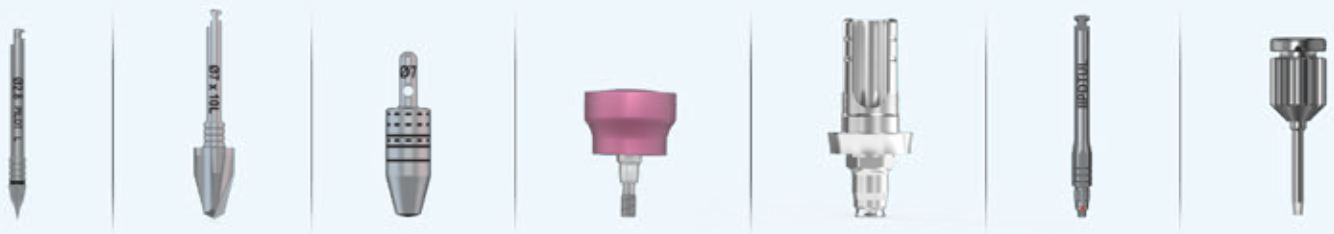

ZimVie

Índice

Implantes T3 PRO Immediate Molar **5**

Kit cirúrgico e módulos T3 PRO **6**

Instrumentos cirúrgicos 10

Chaves de implante 11

Soluções de restauração **12**

Pilares de cicatrização 12

Restaurações provisórias 13

Restaurações definitivas CAD/CAM 13

Componentes de restauração GenTek® 14

Restaurações moldáveis 16

Restaurações cimentadas 16

Componentes da estrutura GingiHue® e do pilar UCLA 16

Restaurações aparafusadas 17

Parafusos **18**

Chaves de componentes protéticos **19**

NOTA: as imagens apresentadas neste manual têm natureza meramente exemplificativa e podem não estar à escala ou apresentar a geometria ou cor exata dos componentes reais.

SuperPoderes

para

Super-heróis

Implantes T3 PRO Immediate Molar

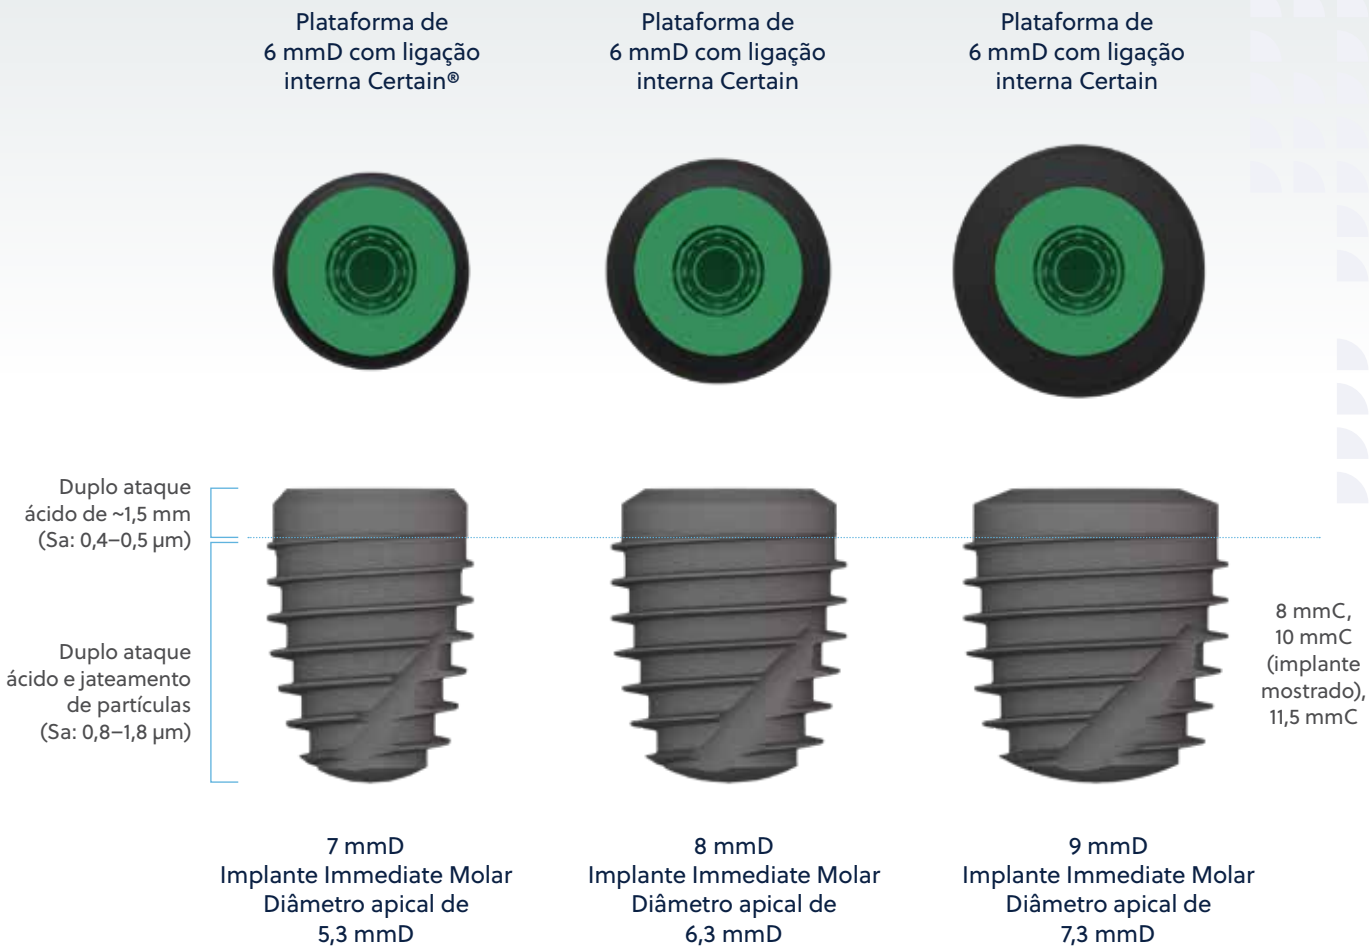

Diâmetro do implante	Plataforma de implante	Conexão	Comprimento do implante		
			8 mmC	10 mmC	11,5 mmC
7,0 mmD	6,0 mmD	Conexão interna Certain	T3PIM7D8L	T3PIM7D10L	T3PIM7D115L
8,0 mmD	6,0 mmD	Conexão interna Certain	T3PIM8D8L	T3PIM8D10L	T3PIM8D115L
9,0 mmD	6,0 mmD	Conexão interna Certain	T3PIM9D8L	T3PIM9D10L	T3PIM9D115L

Parafuso de fecho cirúrgico

Descrição	Plataforma de implante	Referência
Parafuso de fecho, plano (incluído com o implante)	6,0 mmD	ICSF60

Kit Cirúrgico e Módulos T3 PRO Immediate Molar

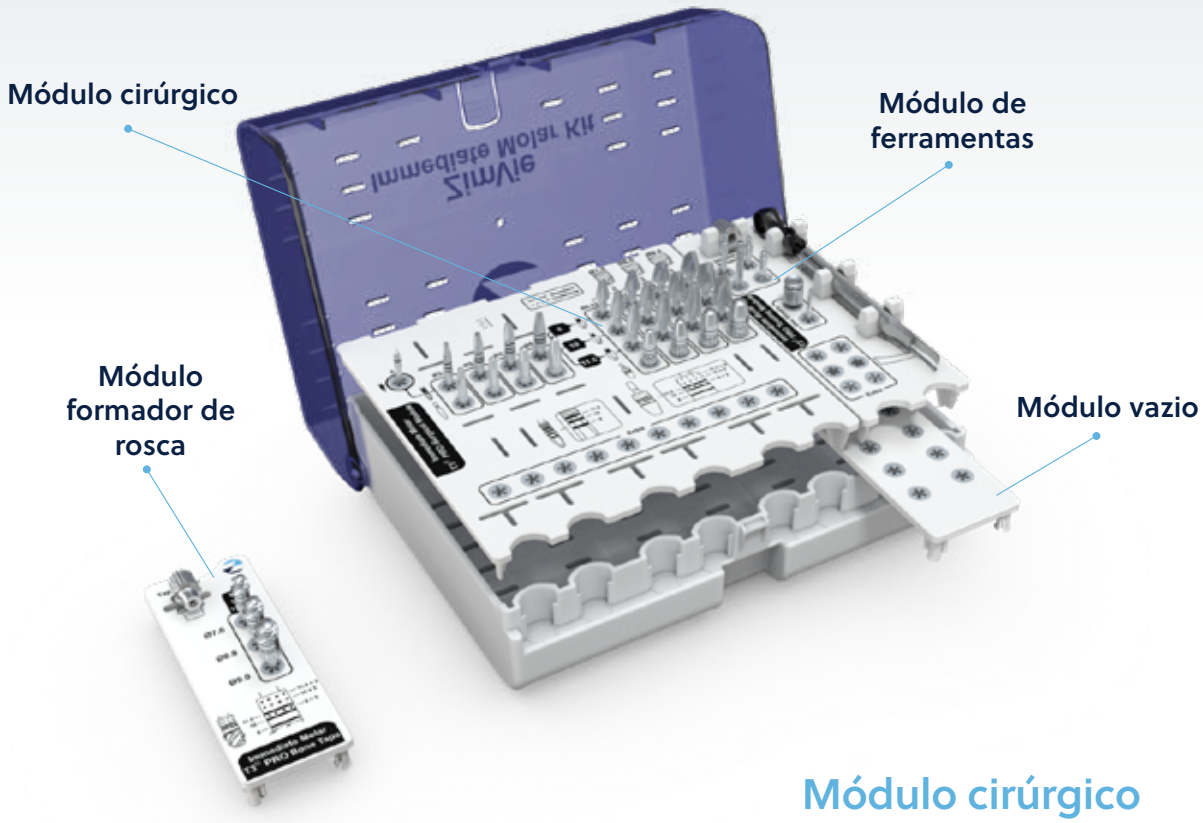

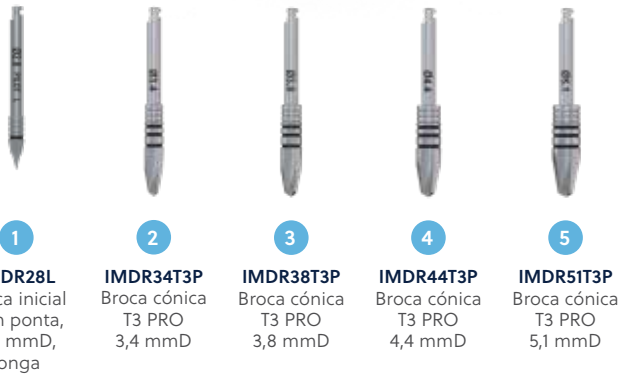

1 **IMDR28L** Broca inicial com ponta, 2,8 mmD, longa

2 **IMDR34T3P** Broca cónica T3 PRO 3,4 mmD

3 **IMDR38T3P** Broca cónica T3 PRO 3,8 mmD

4 **IMDR44T3P** Broca cónica T3 PRO 4,4 mmD

5 **IMDR51T3P** Broca cónica T3 PRO 5,1 mmD

6 **IMDIR34** Indicador de direção de 3,4 mmD

7 **IMDIR38** Indicador de direção de 3,8 mmD

8 **IMDIR44** Indicador de direção de 4,4 mmD

9 **IMDIR51** Indicador de direção de 5,1 mmD

Módulo cirúrgico

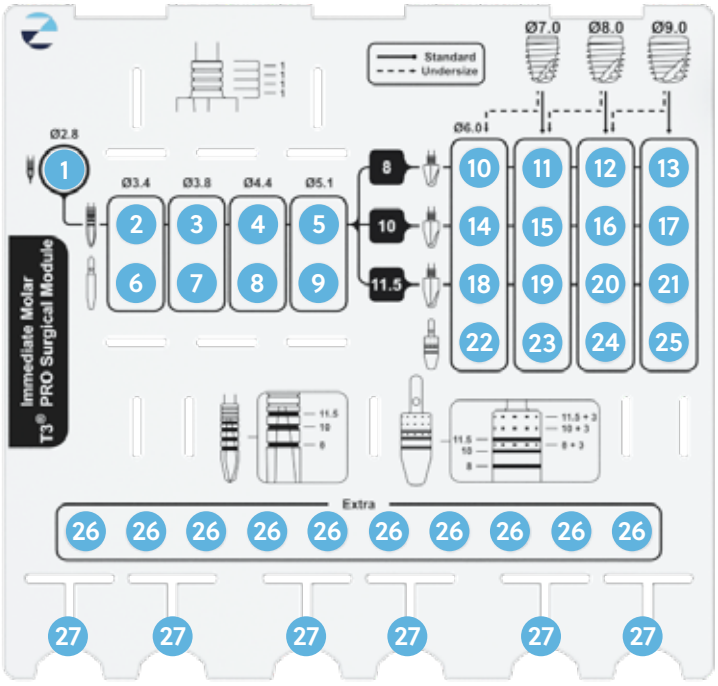

26 Anilhas vazias

27 Ranhuras de preparação do implante

10

IMDR68
Broca de modelação de 6 mmD, 8 mmC

11

IMDR78
Broca de modelação de 7 mmD, 8 mmC

12

IMDR88
Broca de modelação de 8 mmD, 8 mmC

13

IMDR98
Broca de modelação de 9 mmD, 8 mmC

14

IMDR610
Broca de modelação de 6 mmD, 10 mmC

15

IMDR710
Broca de modelação de 7 mmD, 10 mmC

16

IMDR810
Broca de modelação de 8 mmD, 10 mmC

17

IMDR910
Broca de modelação de 9 mmD, 10 mmC

18

IMDR611
Broca de modelação de 6 mmD, 11,5 mmC

19

IMDR711
Broca de modelação de 7 mmD, 11,5 mmC

20

IMDR811
Broca de modelação de 8 mmD, 11,5 mmC

21

IMDR911
Broca de modelação de 9 mmD, 11,5 mmC

22

IMDI6
Indicador de profundidade de 6 mmD, 8–11,5 mmC

23

IMDI7
Indicador de profundidade de 7 mmD, 8–11,5 mmC

24

IMDI8
Indicador de profundidade de 8 mmD, 8–11,5 mmC

25

IMDI9
Indicador de profundidade de 9 mmD, 8–11,5 mmC

Módulo de ferramentas

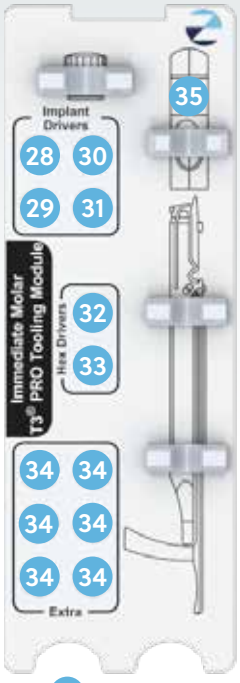

34

Anilhas vazias

28

IIPDTUL
Ponta de chave para colocação universal de conexões internas (longa)

30

IIPDTUS
Ponta de chave para colocação universal de conexões internas (curta)

29

IRE200U
Chave para extensão de roquete universal Certain (longa)

31

IRE100U
Chave para extensão de roquete universal Certain (curta)

32

PHD02N
Chave sextavada 1,2 mmD 17 mmC

33

IHX1.2D
Ponta de chave hexagonal Latch-Lock com retenção GemLock, 1,2 mmD, 24 mmC

35

H-TIRW
Chave de roquete dinanométrica de torque elevado (0–90 Ncm)

Formadores de rosca (opcional)

36

ISOHEXADPT
Adaptador hexagonal ISO de torque elevado (0–90 Ncm)

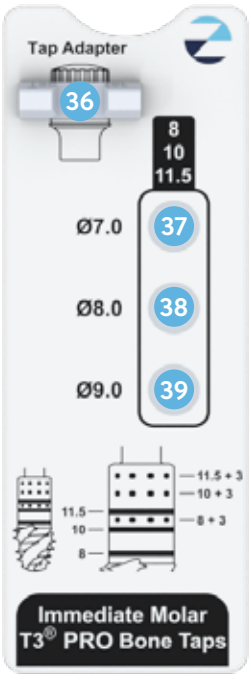

37

IMT7
Formador de rosca, 7 mmD, 8–11,5 mmC

38

IMT8
Formador de rosca de 8 mmD 8–11,5 mmC

39

IMT9
Formador de rosca de 9 mmD, 8–11,5 mmC

Kit Cirúrgico T3 PRO Immediate Molar, completo

Descrição	Referência
Kit Cirúrgico T3 PRO Immediate Molar, completo	IMKITT3P

Nota: Os formadores de rosca são instrumentos opcionais e não estão incluídos no kit cirúrgico. Um módulo de formador de rosca pode ser adquirido separadamente e adicionado ao kit. O kit cirúrgico também inclui um módulo não preenchido com 10 anilhas vazias.

Componentes do Kit Cirúrgico T3 PRO Immediate Molar

	SKU	Descrição	IMKITT3P
Broca inicial	IMDR28L	Broca inicial Immediate Molar de 2,8 mmD (30 mm) de comprimento ◆	X
Brocas cónicas	IMDR34T3P	Broca cónica T3 PRO Immediate Molar, 3,4 mmD	X
	IMDR38T3P	Broca cónica T3 PRO Immediate Molar, 3,8 mmD	X
	IMDR44T3P	Broca cónica T3 PRO Immediate Molar, 4,4 mmD	X
	IMDR51T3P	Broca cónica T3 PRO Immediate Molar, 5,1 mmD	X
Brocas de modelação	IMDR68	Broca de modelação Immediate Molar de 6 mmD, 8 mmC	X
	IMDR610	Broca de modelação Immediate Molar de 6 mmD, 10 mmC	X
	IMDR611	Broca de modelação Immediate Molar de 6 mmD, 11,5 mmC	X
	IMDR78	Broca de modelação Immediate Molar de 7 mmD, 8 mmC	X
	IMDR710	Broca de modelação Immediate Molar de 7 mmD, 10 mmC	X
	IMDR711	Broca de modelação Immediate Molar de 7 mmD, 11,5 mmC	X
	IMDR88	Broca de modelação Immediate Molar de 8 mmD, 8 mmC	X
	IMDR810	Broca de modelação Immediate Molar de 8 mmD, 10 mmC	X
	IMDR811	Broca de modelação Immediate Molar de 8 mmD, 11,5 mmC	X
	IMDR98	Broca de modelação Immediate Molar de 9 mmD, 8 mmC	X
	IMDR910	Broca de modelação Immediate Molar de 9 mmD, 10 mmC	X
	IMDR911	Broca de modelação Immediate Molar de 9 mmD, 11,5 mmC	X
Indicadores de direção	IMDIR34	Indicador de direção Immediate Molar de 3,4 mmD	X
	IMDIR38	Indicador de direção Immediate Molar de 3,8 mmD	X
	IMDIR44	Indicador de direção Immediate Molar de 4,4 mmD	X
	IMDIR51	Indicador de direção Immediate Molar de 5,1 mmD	X
Indicadores de profundidade	IMDI6	Indicador de profundidade Immediate Molar de 6 mmD, 8–11,5 mmC	X
	IMDI7	Indicador de profundidade Immediate Molar de 7 mmD, 8–11,5 mmC	X
	IMDI8	Indicador de profundidade Immediate Molar de 8 mmD, 8–11,5 mmC	X
	IMDI9	Indicador de profundidade Immediate Molar de 9 mmD, 8–11,5 mmC	X
Implante Chaves	IRE100U	Chave de implante para extensão de roquete universal Certain (curta)	X
	IRE200U	Chave de implante para extensão de roquete universal Certain (longa)	X
	IIPDTUS	Ponta de chave para colocação universal de conexões internas (curta)	X
	IIPDTUL	Ponta de chave para colocação universal de conexões internas (longa)	X
Chaves de restauração	IHX1.2D	Ponta de chave hexagonal Latch-Lock com retenção GemLock, 1,2 mmD, 24 mmC	X
	PHD02N	Chave sextavada 1,2 mmD, 17 mmC	X
Chave de torque	H-TIRW	Chave de roquete indicadora de alto torque	X

◆ IMDR28S: Broca Immediate Molar de 2,8 mmD curta (27 mm) disponível separadamente.

Formadores de rosca (opcional)

Descrição	Referência
Módulo de perfuradores ósseos T3 PRO Immediate Molar	IMT3PTAPS
Componentes	
Rosca Immediate Molar 7,0 mmD, 8–11,5 mmC	IMT7
Rosca Immediate Molar 8,0 mmD, 8–11,5 mmC	IMT8
Rosca Immediate Molar 9,0 mmD, 8–11,5 mmC	IMT9
Adaptador hexagonal Latch-Lock de torque elevado*	ISOHEXADPT

*Nota: Os formadores de rosca Immediate Molar têm uma Latch-Lock especializada. Este adaptador permite a utilização manual dos formadores de rosca Immediate Molar quando encaixados com a chave de roquete indicadora de torque elevado ZimVie (H-TIRW).

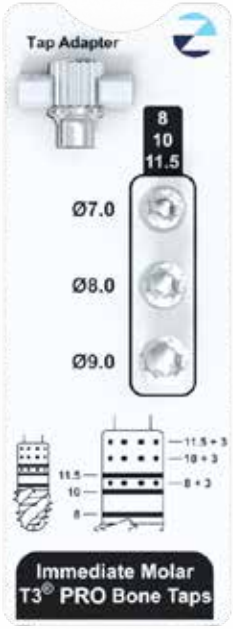

Tabuleiro e módulos vazios

Descrição	Referência
Kit Cirúrgico T3 PRO Immediate Molar Inclui tampa e base do kit cirúrgico, módulo cirúrgico e de ferramentas vazio	IMKITT3PUNP
Módulo Cirúrgico T3 PRO Immediate Molar	IMT3PDRILLSUNP
Módulo de ferramentas T3 PRO Immediate Molar	IMT3PTOOLINGUNP
Módulo de perfuradores ósseos T3 PRO Immediate Molar	IMT3PTAPSUNP
Tabuleiro modular, vazio, suporta com segurança instrumentos com fecho ISO	UNPMODTRAY

Instrumentos cirúrgicos

Brocas iniciais com ponta

Descrição	Referência
Broca inicial Immediate Molar, 2,8 mmD curta^	IMDR28S
Broca inicial Immediate Molar, 2,8 mmD longa*	IMDR28L

^Disponível para compra em separado
*Incluído no Kit Cirúrgico T3 PRO Immediate Molar

Brocas cónicas

Descrição	Referência
Broca T3 PRO Immediate Molar, 3,4 mmD	IMDR34T3P
Broca T3 PRO Immediate Molar, 3,8 mmD	IMDR38T3P
Broca T3 PRO Immediate Molar, 4,4 mmD	IMDR44T3P
Broca T3 PRO Immediate Molar, 5,1 mmD	IMDR51T3P

Brocas de modelação

Diâmetro	8 mmC	10 mmC	11,5 mmC
6,0 mmD	IMDR68	IMDR610	IMDR611
7,0 mmD	IMDR78	IMDR710	IMDR711
8,0 mmD	IMDR88	IMDR810	IMDR811
9,0 mmD	IMDR98	IMDR910	IMDR911

Indicadores de direção

Descrição	Referência
Indicador de direção Immediate Molar de 3,4 mmD	IMDIR34
Indicador de direção Immediate Molar de 3,8 mmD	IMDIR38
Indicador de direção Immediate Molar de 4,4 mmD	IMDIR44
Indicador de direção Immediate Molar de 5,1 mmD	IMDIR51

Indicadores de profundidade

Descrição	Referência
Indicador de profundidade Immediate Molar de 6 mmD, 8–11,5 mmC	IMDI6
Indicador de profundidade Immediate Molar de 7 mmD, 8–11,5 mmC	IMDI7
Indicador de profundidade Immediate Molar de 8 mmD, 8–11,5 mmC	IMDI8
Indicador de profundidade Immediate Molar de 9 mmD, 8–11,5 mmC	IMDI9

Chaves de implante

Chaves de implante

Descrição	Modo de utilização	Referência
Chave de implante para extensão de roquete universal Certain (longa)	Porta implantes para	IRE200U
Chave de implante para extensão de roquete universal Certain (curta)	Porta implantes para	IRE100U
Ponta de chave para colocação universal de conexões internas (longa)	Peça de mão	IIPDTUL
Ponta de chave para colocação universal de conexões internas (curta)	Peça de mão	IIPDTUS

Chaves para parafusos cirúrgicos e parafusos protéticos

Descrição	Modo de utilização	Referência
Chave hexagonal manual de 1,2 mmD, 17 mmC	Manual	PHD02N
Chave hexagonal manual de 1,2 mmD, 24 mmC	Manual	PHD03N
Chave hexagonal Latch-Lock com retenção GemLock, 1,2 mmD, 24 mmC	Peça de mão	IHX1.2D
Chave hexagonal Latch-Lock com retenção GemLock, 1,2 mmD, 30 mmC	Peça de mão	IXL1.2D

Chave de roquete indicadora de torque

Descrição	Referência
Chave de roquete indicadora de torque elevado, 0–90 Ncm (incluída no Kit T3 PRO Immediate Molar)	H-TIRW

Pilares de cicatrização de soluções de restauração

Encode® Emergência

Plataforma de restauração	Perfil de emergência	Altura	
		3 mm (A)	5 mm (A)
6,0 mmD	6,0 mm (P)	IEEHA663	IEEHA665
	6,8 mm (P)	IEEHA6683	IEEHA6685
	7,5 mm (P)	IEEHA673	IEEHA675

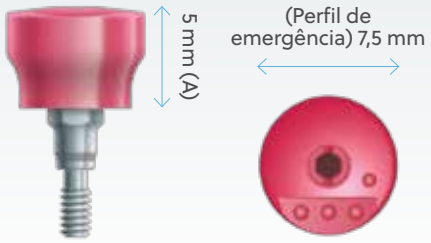

Pilares de cicatrização EP® de peça única

Plataforma de restauração	Perfil de emergência	Altura do colo				
		2 mm (A)	3 mm (A)	4 mm (A)	6 mm (A)	8 mm (A)
6,0 mmD	6,0 mm (P)	ISWHA62	ISWHA63	ISWHA64	ISWHA66	ISWHA68
	6,8 mm (P)	IWTH62	IWTH63	IWTH64	IWTH66	IWTH68
	7,5 mm (P)	IWTH672	IWTH673	IWTH674	IWTH676	IWTH678

Restaurações provisórias

Estruturas PreFormance®
(Material: PEEK: conexão em liga de titânio)

Plataforma de restauração	Perfil de emergência	Altura do colo			
		4 mm (A)		6 mm (A)	
		Reto	Pré-angulado, 15°	Reto	Pré-angulado, 15°
6,0 mmD	6,0 mm (P)	IWPFP664	IPAPF664	IWPFP666	IPAPF666

Cilindros temporários

Cilindros Temporários PreFormance
(Material: PEEK - Conexão de liga de titânio)

Plataforma de restauração	Descrição	
	Hexagonal	Não hexagonal
6,0 mmD	IWPFTC61	IWPFTC62

Cilindros temporários de titânio
(Material: conexão de liga de titânio)

Plataforma de restauração	Descrição	
	Hexagonal	Não hexagonal
6,0 mmD	IWTCS61	IWTCS62

Nota: Todos os pilares provisórios (estruturas PreFormance e cilindros temporários) têm incluído o parafuso hexagonal de titânio correspondente (UNIHT).

Restaurações definitivas CAD/CAM

Concebidos por computador e precisão CAD/CAM com fresagem personalizada.

Consulte um representante da ZimVie para obter informações adicionais.

Componentes de restauração GenTek®

Bases de titânio GenTek®

Inclui: Parafuso Gold-Tite® hexalobular e de colagem

Alturas da estrutura	Plataforma de restauração	Altura do colo	Base de titânio não rotativa	Base de titânio rotativa
7 mm	5,0 mmD	0,3 mm	ZFX11ZB-CE50ASZ03E	ZFX11ZB-CE50ASZ03N
		1,3 mm	ZFX11ZB-CE50AS13E	ZFX11ZB-CE50AS13N
		2,6 mm	ZFX11ZB-CE50AS26E	-

Nota: os Implantes Immediate Molar podem ser restaurados com componentes de restauração de 5,0 mm.

Parafusos para bases de titânio GenTek

Descrição	Base de titânio não rotativa	Base de titânio rotativa
Parafuso hexalobular Gold-Tite	ZFX09-ZB-CE-HLGTE	ZFX09-ZB-CE-HLGTN
Parafuso Try-In hexalobular	ZFX09-ZB-CE-HLTISE	ZFX09-ZB CE-HLTISN

Bases de titânio GenTek com estrutura padrão

Inclui: parafusos Gold-Tite e de colagem

Alturas da estrutura	Plataforma de restauração	Base de titânio não rotativa	Base de titânio rotativa
7 mm	5,0 mmD	ZFX11-ZB-CE-5047-EL	ZFX11-ZB-CE-5047-NEL

Nota: os Implantes Immediate Molar podem ser restaurados com componentes de restauração de 5,0 mm.

Parafusos para bases de titânio GenTek com estrutura padrão

Descrição	Base de titânio não rotativa	Base de titânio rotativa
Parafuso Gold-Tite	ZFX09-ZB-CE-HGTS	ZFX09-ZB-CE-LGTS
Parafuso Try-In	ZFX09-ZB-CE-HTIS	ZFX09-ZB-CE-NHTIS

Blank de pilar pré-fresado em titânio

Inclui: Parafuso Gold-Tite®

Plataforma de restauração	Referência
5,0 mmD	ZFX18-ZB-CE-4160

Nota: os Implantes Immediate Molar podem ser restaurados com componentes de restauração de 5,0 mm.

Parafusos para blanks de pilares pré-fresados em titânio

Descrição	Referência
Parafuso Gold-Tite	ZFX09-ZB-CE-HGTS
Parafuso Try-In	ZFX09-ZB-CE-HTIS

Scan Bodies GenTek

Inclui: Parafuso

Plataforma de restauração	Referência
6,0 mmD	ZFX05Z-ZB-CE-60

Análogos digitais GenTek

Inclui: Parafuso

Plataforma de restauração	Referência
6,0 mmD	ZFX15Z-ZB-CE-60

Acessórios para análogos digitais GenTek

Descrição	Referência
Parafuso de fixação de análogo digital *(4 parafusos numa embalagem)*	ZFX15Z-FS

Restaurações moldáveis

Pilares Gold UCLA hexagonais (Material: cilindro mecanizado em liga de ouro com tubo de plástico)

Plataforma de restauração	Descrição	Material	Referência
6,0 mmD	Hexagonal	Ouro	IWGA61C
	Não hexagonal (com parafuso Gold-Tite® de diâmetro grande)	Ouro	IWGA62C
	Não hexagonal (com parafuso de titânio de diâmetro grande)	Ouro	IWGA62T

Nota: Os pilares Gold UCLA hexagonais não incluem o parafuso.
O parafuso final Gold-Tite (IUNIHG) tem de ser encomendado em separado.

Restaurações cimentadas

Postes GingiHue® (Material: liga de titânio)

Plataforma de restauração	Perfil de emergência	Altura do colo			
		2 mm (A)		4 mm (A)	
		Reto	Pré-angulado, 15°	Reto	Pré-angulado, 15°
6,0 mmD	6,0 mm (P)	IWPP662G	IPAP662G	IWPP664G	IPAP664G
	7,5 mm (P)	IWPP672G	IPAP672G	IWPP674G	IPAP672G

Componentes da estrutura GingiHue e do pilar UCLA

Coifa de impressão de moldeira aberta

Plataforma de restauração	Perfil de emergência	Referência
6,0 mmD	6,0 mm	IWIP60
	6,8 mm	IWIP66
	7,5 mm	IWIP67

Coifa de impressão Twist Lock™

Plataforma de restauração	Perfil de emergência	Referência
6,0 mmD	6,0 mm	IWIT60
	6,8 mm	IWIT66
	7,5 mm	IWIT67

Análogo de laboratório

Plataforma de restauração	Referência
6,0 mmD	IILAW6

Componentes adicionais

Descrição	Referência
Parafuso Gold-Tite	IUNIHG
Parafusos Try-In (embalagem de 5)	IUNITS
Suporte de pilares de laboratório	ILTAH57
Parafuso hexagonal grande Gold-Tite	ILRGHG

Restaurações aparafusadas

Pilares de perfil curto (Material: liga de titânio)

Plataforma de restauração	Altura do colo	Reto (não hexagonal)	Reto (hexagonal)	Angulado, 17° (hexagonal)	Angulado, 30° (hexagonal)
5,0 mmD*	1,0 mm	ILPC541U	ILPC541	—	—
	2,0 mm	ILPC542U	ILPC542	ILPAC5217	—
	3,0 mm	ILPC543U	ILPC543	—	ILPAC5330
	4,0 mm	ILPC544U	ILPC544	ILPAC5417	—
	5,0 mm	—	—	—	ILPAC5530



*Nota: os Implantes Immediate Molar podem ser restaurados com componentes de restauração de 5,0 mm.

Componentes para pilares de perfil curto

Descrição		Plataforma de restauração de 4,8 mm
Coifa de impressão pick-up (hexagonal)	⬢	LPCPIC1
Coifa de impressão pick-up (não hexagonal)	⬢	LPCPIC2
Coifa de impressão Twist Lock (hexagonal)	○	LPCTIC1
Coifa de impressão Twist Lock (não hexagonal)	○	LPCTIC2
Coifa de impressão QuickBridge®		LPCRIC
Análogo de laboratório		LPCLA
Cilindro temporário (hexagonal)		LPCTC1
Cilindro temporário (não hexagonal)		LPCTC2
Tampa de cicatrização	⬢	LPCHC
Temp. PreFormance Cilindro (hexagonal)		LPCPTC1
Temp. PreFormance Cilindro (não hexagonal)		LPCPTC2
QuickBridge		LPCQB
Tampa de substituição QuickBridge		LPCQBCAP
Extensão distal		LPCDE
Cilindro Gold (hexagonal)		LPCGC1
Cilindro Gold (não hexagonal)		LPCGC2
Cilindro moldável (hexagonal)		LPCCC1
Cilindro moldável (não hexagonal)		LPCCC2
Cilindro soldado a laser		LPCTUCA
Parafuso para waxing		LPCWS
Parafuso de retenção	⬢	LPCGSH, LPCTSH
Ferramenta de polimento		LPCAMI
Protetor de polimento		LPCPP

Compatibilidade do pilar		
Componente	Pilar hexagonal	Pilar não hexagonal
Hexagonal	Sim	Não
Não hexagonal	Sim	Sim

⬢ = Requer a utilização da chave hexagonal PHD02N, PHD03N ou da ponta de chave IHX1.2D, IXL1.2D, RASH3N, RASH8N

○ = Requer a utilização da chave de coifa de impressão ICD00

Parafusos

Parafusos de pilar

	Parafuso Gold-Tite	Parafuso de titânio	Parafuso Gold-Tite grande	Parafuso de titânio grande
Parafusos	IUNIHG	IUNIHT	ILRGHG	ILRGHT
Chaves	PHD02N, PHD03N	PHD02N, PHD03N	PHD02N, PHD03N	PHD02N, PHD03N
Pontas de chave	IHX1.2D, IXL1.2D, RASH3N, RASH8N	IHX1.2D, IXL1.2D, RASH3N, RASH8N	IHX1.2D, IXL1.2D, RASH3N, RASH8N	IHX1.2D, IXL1.2D, RASH3N, RASH8N
Torque	20 Ncm	20 Ncm	20 Ncm	20 Ncm
Para utilização com:	Pilar UCLA Express e Flex hexagonal, poste GingiHue, poste GingiHue 15°, cilindro temporário hexagonal	Pilar UCLA, poste GingiHue, poste GingiHue 15°, cilindro temporário hexagonal	Pilar UCLA não hexagonal, pilares Express e Flex não hexagonais, cilindro temporário não hexagonal, barras	Pilar UCLA não hexagonal, Cilindro temporário não hexagonal, Barras

Parafusos de retenção

	Parafuso Gold-Tite para pilar de perfil curto	Parafuso de titânio para pilar de perfil curto
Parafusos	LPCGSH	LPCTSH
Chaves	PHD02N, PHD03N	PHD02N, PHD03N
Pontas de chave	IHX1.2D, IXL1.2D, RASH3N, RASH8N	IHX1.2D, IXL1.2D, RASH3N, RASH8N
Torque	10 Ncm	10 Ncm
Para utilização com:	Pilar de perfil curto	Pilar de perfil curto

Parafusos para waxing e parafusos Try-in

	Parafuso para waxing laboratorial	Parafuso Try-In hexagonal (embalagem de 5)
Parafusos	IWSU30	IUNITS
Chaves	PHD02N, PHD03N	PHD02N, PHD03N
Pontas de chave	IHX1.2D, IXL1.2D, RASH3N, RASH8N	IHX1.2D, IXL1.2D, RASH3N, RASH8N
Para utilização com:	Coifas de impressão e pick-up, procedimentos laboratoriais ao nível do implante	Pilar UCLA hexagonal, poste GingiHue, poste GingiHue 15°

Chaves de componentes protéticos

Descrição	Referência
Chave de roquete indicadora de baixo torque Inclui: Adaptador L-TIRW em conformidade com a norma ISO 1797 (C9980)	L-TIRW
Adaptador Latch-Lock padrão L-TIRW	C9980
Adaptador Latch-Lock curto L-TIRW	C9981
Alargador e cabo	IRH600
Ferramenta Certain QuickSeat® Activator	IQSA01
Protetor de polimento, pilar UCLA, 6 mmD	IPPIA6
Protetor de polimento, pilar UCLA, 3,4 mmD, 4,1 mmD, 5 mmD, 6 mmD	ILTAH57
Kit de guia de ângulo protético, 15°, 25°, 35°	AG900
Estrutura de medição de tecidos	TMP80
Chave hexalobular para parafuso de retenção hexalobular, 21 mmC	ZFX02HLD21
Chave hexalobular para parafuso de retenção hexalobular, 28 mmC	ZFX02HLD28
Chave hexalobular para parafuso de retenção hexalobular, 36 mmC	ZFX02HLD36

Kit de remoção de parafusos

Descrição	Referência
Kit de chaves para remoção de parafuso Certain	ISRT10N
Componentes	
Cabo guia da broca para implantes Certain	ISRT05N
Ferramenta de extração para remoção de parafusos Certain	ISRT06N
Broca de inversão manual	USRT07
Parafuso para waxing/Pino de guia Certain	IWSU30

Descrição	Referência
Kit de chaves de roquete indicadora de torque baixo	L-TIRWK
Componentes	
Ponta de chave hexagonal de ângulo reto estreita, 24 mmC	RASH3N
Ponta de chave quadrada de ângulo reto estreita, 24 mmC	RASQ3N
Chave de roquete indicadora de baixo torque	L-TIRW
Tabuleiro de torque de restauração	RTI2035TR

Chaves para pilares de perfil curto

Descrição	Referência
Chave para pilar posterior, 17 mmC	PAD00
Chave para pilar posterior, 24 mmC	PAD24
Ponta de chave de aço para pilar de ângulo reto	RASA3



Chaves para parafusos cirúrgicos e parafusos protéticos

Descrição	Modo de utilização	Referência
Chave hexagonal manual de 1,2 mmD, 17 mmC	Manual	PHD02N
Chave hexagonal manual de 1,2 mmD, 24 mmC	Manual	PHD03N
Chave hexagonal Latch-Lock com retenção GemLock, 1,2 mmD, 24 mmC	Peça de mão	IHX1.2D
Chave hexagonal Latch-Lock com retenção GemLock, 1,2 mmD, 30 mmC	Peça de mão	IXL1.2D
Ponta de chave hexagonal de ângulo reto estreita, 24 mmC		RASH3N
Ponta de chave hexagonal de ângulo reto estreita, 30 mmC		RASH8N

Chaves para coifas de impressão de transferência Twist Lock

Descrição	Referência
Chave de coifa de impressão estreita	ICD00

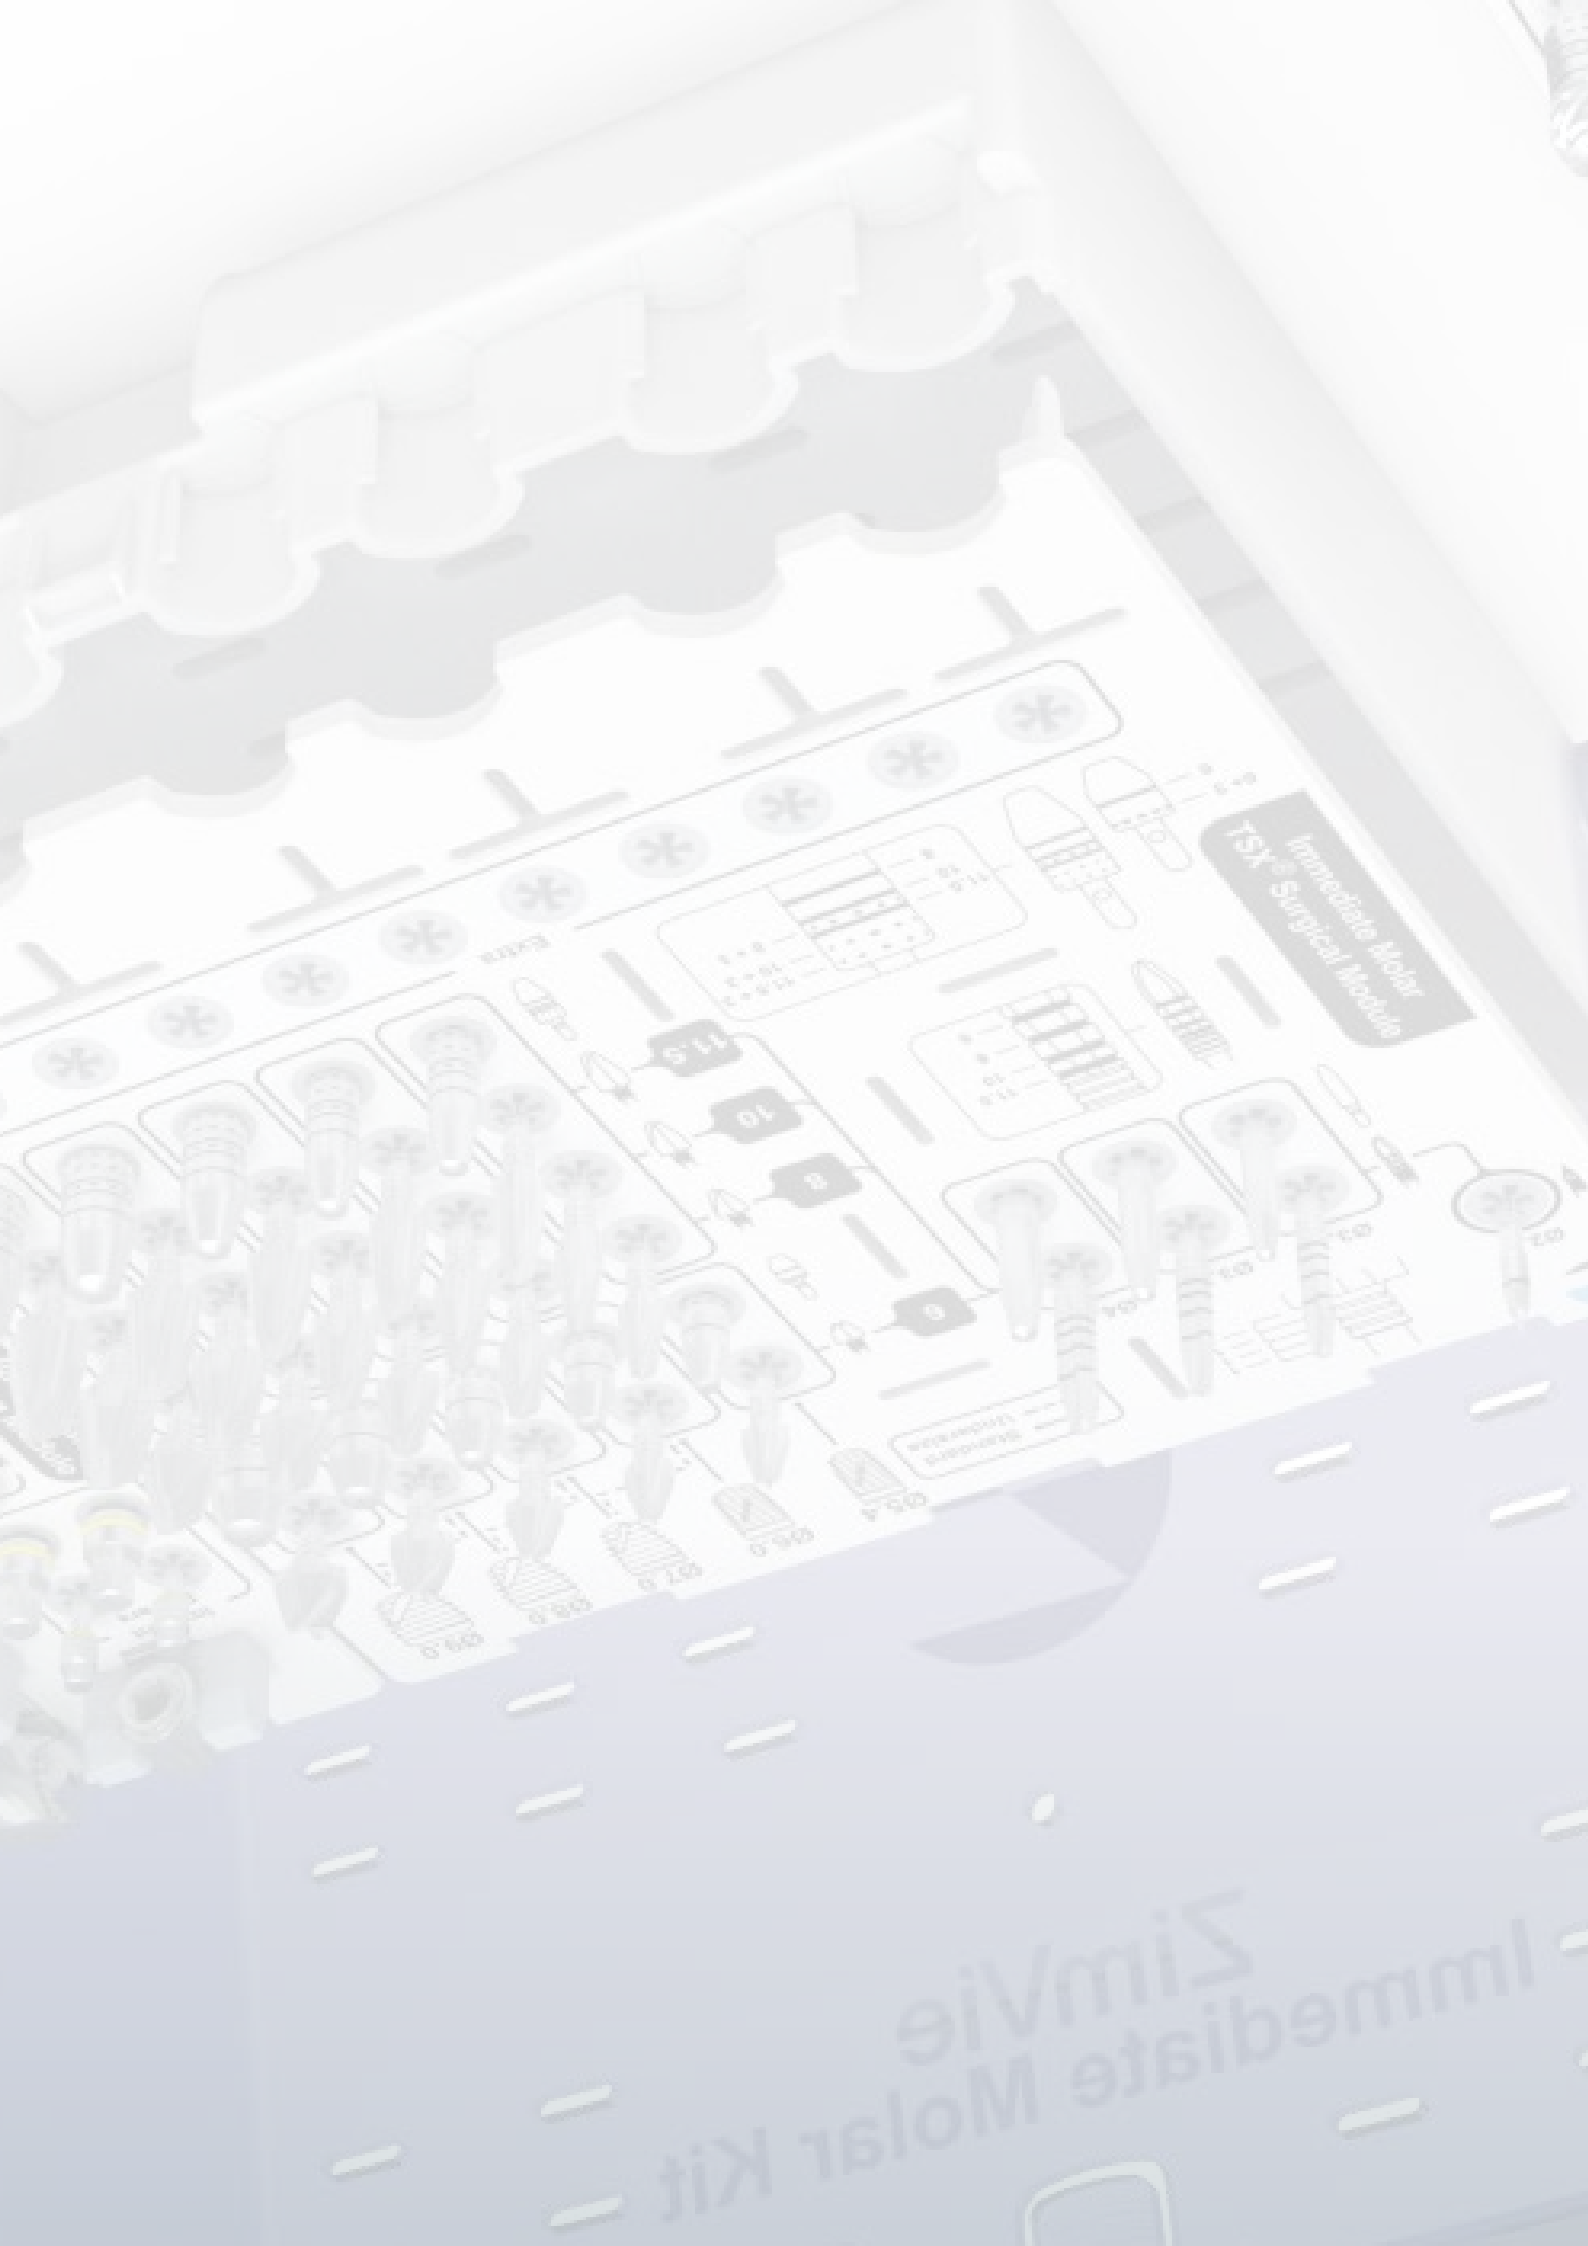
Immediate Molar
TSX Surgical Implant

Notas

Notas

Para obter mais informações, visite ZimVie.eu

ZimVie US Corp LLC
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Tel.: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272
dentalCS@ZimVie.com

ZimVie Spain S.L.U.
WTC Almeda Park, Ed. 4, Pl. 2
C/Tirso de Molina, 40 (entrada Plaça de la Pau)
08940, Cornellà de Llobregat, Espanha
Atención al cliente: 800-827-836
Fax para pedidos: +34-93-445-81-36
ZV.pedidos@ZimVie.com

As imagens de Superpoderes para Super-Heróis são meramente ilustrativas. O desempenho do produto depende da aplicação clínica adequada e de fatores individuais do paciente.
Salvo indicação em contrário, conforme mencionado no presente documento, todas as marcas comerciais e os direitos de propriedade intelectual são propriedade da ZimVie Inc. ou de uma afiliada, e todos os produtos são fabricados por uma ou mais subsidiárias da divisão de medicina dentária da ZimVie US Corp LLC (Biomet 3i, LLC, etc.) e distribuídos pela ZimVie US Corp LLC e pelos seus parceiros de comercialização autorizados. Classificação do MDR da UE: Implantes dentários (Classe IIb), pilares e blanks dentários (Classe IIb), instrumentos (Classe IIa e Classe I), scanbody (Classe I). Estão disponíveis mais informações sobre a finalidade prevista dos dispositivos em: labeling.ZimVie.com. Os produtos aqui apresentados não são elegíveis para reembolso em França. Para outros países, consulte as leis e os regulamentos locais. Para obter informações adicionais sobre os produtos, consulte a rotulagem individual dos produtos ou as instruções de utilização respetivas. Os produtos podem não estar disponíveis ou autorizados em determinados países/regiões. Este material destina-se apenas a profissionais médicos e não constitui parecer ou recomendações médicas. É proibida a distribuição a qualquer outro destinatário. Este material não pode ser copiado nem reproduzido sem o expresso consentimento escrito da ZimVie. ZVINST0241-EMEA-PT REV 2 07/26 ©2026 ZimVie. Todos os direitos reservados.

O número do ON aplicável a cada dispositivo pode ser encontrado na rotulagem do produto, se aplicável.

CE 2797 CE 0123 CE