Tabla de distribución del sistema de kit quirúrgico modular TSX®

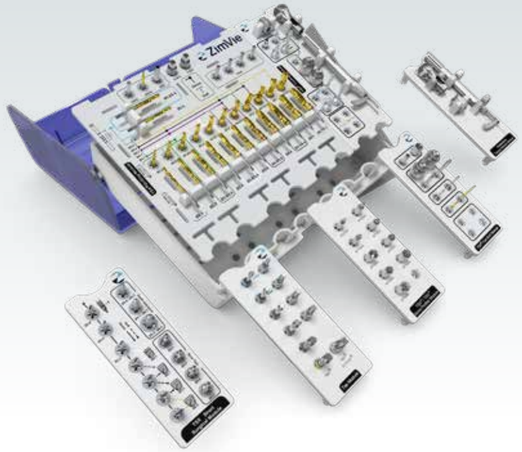

1 **1203G**
Fresa redonda
Ø2,0 mm

2 **0201G**
Fresa piloto cónica
de Ø2,1/1,6 mm
8,0 mm - 11,5 mm (L)

3 **DEG**
Extensor de fresas

4 **CLRT2**
Herramienta de
extracción para
pilares NP

5 **TLRT2**
Herramienta de
extracción para
pilares con conexión
hexagonal interna

6 **PPAR**
Instrumento de
paralelización
(cantidad: 4)

7 **EZT28D24G**
Fresa escalonada
de Ø2,8/2,4 mm,
22 mm (L)

8 **EZT24G**
Fresa de
Ø2,4 mm, 22 mm (L)

9 **TSV23SG**
Fresa de
Ø2,3 mm,
16 mm (L)

10 **TSV28SG**
Fresa de
Ø2,8 mm,
16 mm (L)

11 **TSV34D28SG**
Fresa escalonada
de Ø3,4/2,8 mm,
16 mm (L)

12 **TSV34SG**
Fresa de
Ø3,4 mm, 16 mm (L)

13 **TSV38D34SG**
Fresa escalonada
de Ø3,8/3,4 mm,
16 mm (L)

14 **TSV38SG**
Fresa de
Ø3,8 mm,
16 mm (L)

15 **TSV44D38SG**
Fresa escalonada
de Ø4,4/3,8 mm,
16 mm (L)

16 **TSV44SG**
Fresa de
Ø4,4 mm,
16 mm (L)

Módulo de fresa (incluido en TSXKIT)

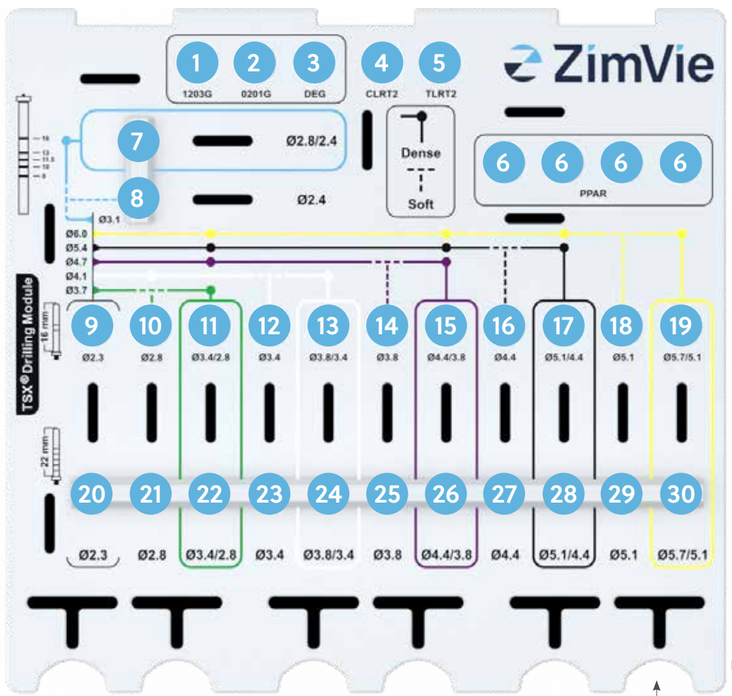

Alojamientos
para el blíster
del implante

17 **TSV51D44SG**
Fresa escalonada
de Ø5,1/4,4 mm,
16 mm (L)

18 **TSV51SG**
Fresa de
Ø5,1 mm,
16 mm (L)

19 **TSV57D51SG**
Fresa escalonada
de Ø5,7/5,1 mm,
16 mm (L)

20 **TSV23G**
Fresa de
Ø2,3 mm,
22 mm (L)

21 **TSV28G**
Fresa de
Ø2,8 mm,
22 mm (L)

22 **TSV34D28G**
Fresa escalonada
de Ø3,4/2,8 mm,
22 mm (L)

23 **TSV34G**
Fresa de
Ø3,4 mm,
22 mm (L)

24 **TSV38D34G**
Fresa escalonada
de Ø3,8/3,4 mm,
22 mm (L)

25 **TSV38G**
Fresa de
Ø3,8 mm,
22 mm (L)

26 **TSV44D38G**
Fresa escalonada
de Ø4,4/3,8 mm,
22 mm (L)

27 **TSV44G**
Fresa de
Ø4,4 mm,
22 mm (L)

28 **TSV51D44G**
Fresa escalonada
de Ø5,1/4,4 mm,
22 mm (L)

29 **TSV51G**
Fresa de
Ø5,1 mm,
22 mm (L)

30 **TSV57D51G**
Fresa escalonada
de Ø5,7/5,1 mm,
22 mm (L)

Módulo de herramientas
(incluido en TSXKIT)



31 **ZTIRW**
Llave de carraca
indicadora de
alto torque de
(0-90 Ncm)

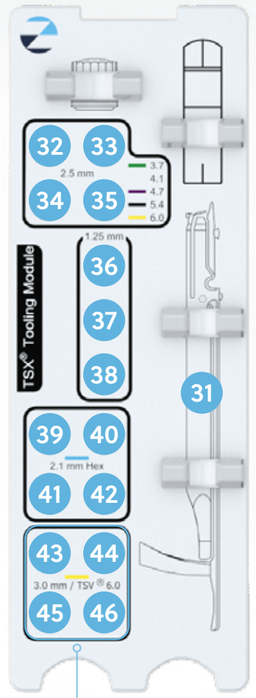

Destornilladores hexagonales de 3,0 mm utilizados con el implante TSV de Ø6,0 mm cuando se retira el transportador
(se adquieren por separado)

32 **GHX2.5D**
Punta destornilladora
hexagonal GemLock®
de 2,5 mm, corta

33 **GHX2.5DL**
Punta destornilladora
hexagonal GemLock
de 2,5 mm, larga

34 **GHX2.5**
Destornillador
hexagonal de 2,5 mm
GemLock, corto

35 **GHX2.5L**
Destornillador
hexagonal GemLock
de 2,5 mm, larga

36 **HX1.25D**
Punta destornilladora
hexagonal de
1,25 mm, corta

37 **HXLGR1.25**
Destornillador
hexagonal de 1,25 mm
GemLock, largo

38 **HXGR1.25**
Destornillador
hexagonal de 1,25 mm
GemLock, corto

39 **CHD2.1**
Punta destornilladora
hexagonal GemLock
de 2,1 mm, corta

40 **CHDL2.1**
Punta destornilladora
hexagonal GemLock
de 2,1 mm, larga

41 **CHR2.1**
Extensor hexagonal
GemLock, 2,1 mm,
corto

42 **CHRL2.1**
Extensor hexagonal
GemLock, 2,1 mm,
largo

43 **RHX3.0DS**
Punta destornilladora
hexagonal
Ø3,0 mm, 21 mm (L)
(se adquieren por separado)

44 **RHX3.0DL**
Punta destornilladora hexagonal
Ø3,0 mm, 25 mm (L)
(se adquieren por separado)

45 **RHX3.0RS**
Destornillador hexagonal,
carraca,
Ø3,0 mm, 17 mm (L)
(se adquieren por separado)

46 **RHX3.0RM**
Destornillador hexagonal,
carraca,
Ø3,0 mm, 22 mm (L)
(se adquieren por separado)

Tabla de distribución del sistema de kit quirúrgico modular TSX

Módulo de terrajas (TAPMOD)

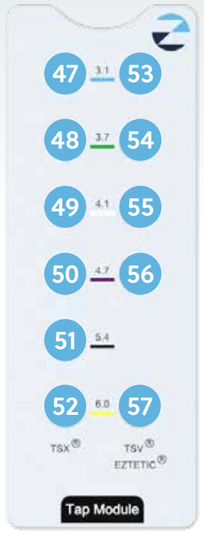

47 **TSXTAP31**
Ø3,1 mm
Terraja ósea TSX

48 **TSXTAP37**
Ø3,7 mm
Terraja ósea TSX

49 **TSXTAP41**
Ø4,1 mm
Terraja ósea TSX

50 **TSXTAP47**
Ø4,7 mm
Terraja ósea TSX

51 **TSXTAP54**
Ø5,4 mm
Terraja ósea TSX

52 **TSXTAP60**
Ø6,0 mm
Terraja ósea TSX

53 **ZOPTT30**
Ø3,0 mm
Terraja ósea
Eztetic

54 **TT3.7**
Ø3,7 mm
Terraja ósea TSV

55 **TT4.1**
Ø4,1 mm
Terraja ósea TSV

56 **TT4.7**
Ø4,7 mm
Terraja ósea TSV

57 **TT6.0**
Ø6,0 mm
Terraja ósea TSV

Módulo de perfilador óseo (TSXBPRO)

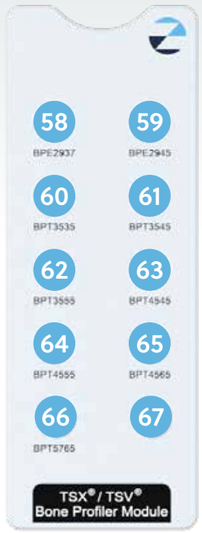

58 **BPE2937**
Ø2,9 mm X
3,7 mm (P)
Perfilador óseo
NP

59 **BPE2945**
Ø2,9 mm X
4,5 mm (P)
Perfilador óseo
NP

60 **BPT3535**
Ø3,5 mm X
3,5 mm (P)
Perfilador óseo

61 **BPT3545**
Ø3,5 mm X
4,5 mm (P)
Perfilador óseo

62 **BPT3555**
Ø3,5 mm X
5,5 mm (P)
Perfilador óseo

63 **BPT4545**
Ø4,5 mm X
4,5 mm (P)
Perfilador óseo

64 **BPT4555**
Ø4,5 mm X
5,5 mm (P)
Perfilador óseo

65 **BPT4565**
Ø4,5 mm X
6,5 mm (P)
Perfilador óseo

66 **BPT5765**
Ø5,7 mm X
6,5 mm (P)
Perfilador óseo

67 Arandela vacía

Módulo de llave dinamométrica de restauración (TSXRESTORTW)

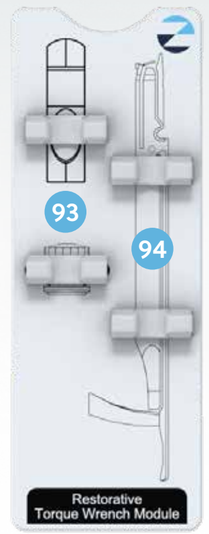

93 **TWR***
Llave
dinamométrica
protésica

94 **L-TIRW**
Llave de carraca
indicadora de bajo
torque (incluye
adaptador Latchlock
C9980)

Módulo restaurador de arcada completa (TSXRESTOR)

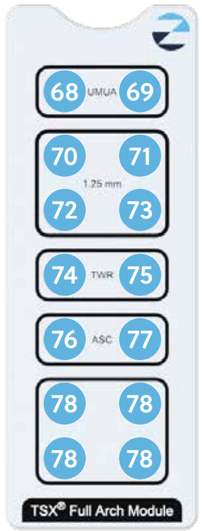

68 **UMUA-D**
Destornillador
Multi-Unit
universal

69 **ISO4X4A**
Punta
transportadora
Latchlock 4x4

70 **HXGR1.25**
Destornillador
hexagonal
de 1,25 mm
GemLock, corto

71 **HXLGR1.25**
Destornillador
hexagonal
de 1,25 mm
GemLock, largo

72 **HX1.25D**
1,25 mm
Punta
destornilladora
hexagonal, corta

73 **HXL1.25D**
1,25 mm
Punta
destornilladora
hexagonal, larga

74 **TW1.25**
1,25 mm
Destornillador
hexagonal
para llave
dinamométrica,
corto

75 **TW1.25L**
1,25 mm
Destornillador
hexagonal
para llave
dinamométrica,
largo

76 **ASC-SD24**
Punta
destornilladora
para canal
de tornillo
angulado,
24 mm (L)

77 **ASC-SD30**
Punta
destornilladora
para canal
de tornillo
angulado,
30 mm (L)

78 Arandela vacía

Módulo quirúrgico para implante corto TSX (TSXSMOD)

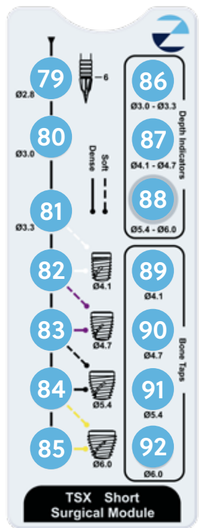

79 **IMDR28L**
Fresa de
iniciación de
Ø2,8 mm, larga

80 **TSX3D6**
Fresa cónica
de Ø3,0 mm,
6 mm (L)

81 **TSX33D6**
Fresa de perfil
de Ø3,3 mm,
6 mm (L)

82 **TSX41D6**
Fresa de perfil
de Ø4,1 mm,
6 mm (L)

83 **TSX47D6**
Fresa de perfil
de Ø4,7 mm,
6 mm (L)

84 **IMDR56**
Fresa de perfil
de Ø5,4 mm,
6 mm (L)

85 **IMDR66**
Fresa de perfil
de Ø6 mm,
6 mm (L)

86 **TSXDI3D33D**
Indicador de
profundidad
de doble cara,
Ø3,0 mm,
Ø3,3 mm

87 **TSXDI41D47D**
Indicador de
profundidad
de doble cara,
Ø4,1 mm,
Ø4,7 mm

88 **TSXDI54D6D**
Indicador de
profundidad
de doble cara,
Ø5,4 mm,
Ø6,0 mm

89 **TSXTAP41D6**
Terraja ósea
de Ø4,1 mm,
6 mm (L)

90 **TSXTAP47D6**
Terraja ósea
de Ø4,7 mm,
6 mm (L)

91 **TSXTAP54D6**
Terraja ósea
de Ø5,4 mm,
6 mm (L)

92 **TSXTAP60D6**
Terraja ósea
de Ø6,0 mm,
6 mm (L)

95 **UNPMODTRAY**
Bandeja modular, vacía, sujeta de forma segura los instrumentos de cierre Latchlock
(se adquieren por separado)

Para obtener más información, visita ZimVie.com

ZimVie US Corp LLC
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Teléfono: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272
dentalCS@ZimVie.com

ZimVie Spain S.L.U.
WTC Almeda Park, Ed. 4, Pl. 2
C/Tirso de Molina, 40 (entrada Plaça de la Pau)
08940, Cornellà de Llobregat
Atención al cliente España: 900-800-303
Atención al cliente Portugal: 800-827-836
Fax para pedidos: 93-445-81-36
ZV.pedidos@ZimVie.com

*** NOTA:** La TWR se incluye en el módulo lleno TSXRESTORTW y puede almacenarse opcionalmente en los dos soportes de silicona izquierdos, numerados como 93. Sigue las instrucciones de esterilización del fabricante para la TWR.

Las imágenes incluidas son de carácter representativo y pueden no estar a escala o no mostrar la geometría o el color exactos de los componentes reales.

Salvo que se indique lo contrario, tal y como se especifica en el presente documento, todas las marcas comerciales y los derechos de propiedad intelectual son propiedad de ZimVie Inc. o sus filiales, y todos los productos son fabricados por una o varias de las filiales dentales de ZimVie US Corp LLC (Biomet 3i, LLC, etc.), y distribuidos por ZimVie US Corp LLC y sus socios comerciales autorizados. Los pilares OverdenSURE y Multi-Unit Universal son fabricados por Terrats Medical S.R.L. TWR es fabricado por Josef Ganter GmbH. ZTIRW y L-TIRW son fabricados por Elos Medtech Pinol A/S. Clasificación de productos sanitarios de la UE: implante TSX (IIb), implante TSV (IIb), componentes de restauración (IIa). La finalidad de los implantes dentales es sustituir una pieza individual (restauraciones de una sola pieza) o varias piezas que falten, o restaurar arcadas dentales edéntulas (puente fijo retenido por implantes, sobredentadura implantosoportadas). Los productos aquí mostrados no cumplen los criterios para el reembolso en Francia. Para otros países, consulta las leyes y normativas locales. Si deseas más información sobre algún producto, consulta el etiquetado o las instrucciones de uso del producto en cuestión. La autorización y la disponibilidad del producto pueden estar limitadas a ciertos países o regiones. Este material está destinado exclusivamente a odontólogos y no incluye asesoramiento ni recomendaciones de carácter médico. Queda prohibida su distribución a ningún otro destinatario. Está prohibido copiar o reimprimir este material sin el consentimiento expreso por escrito de ZimVie. ZVINST2414-GLBL-ES REV B 05/26 ©2026 ZimVie. Todos los derechos reservados.

CE 2797 CE 0051

El número de NB aplicable a cada dispositivo se puede encontrar en la etiqueta del producto, si procede.

ZimVie