Tableau du contenu du système de trousse chirurgicale modulable TSX®

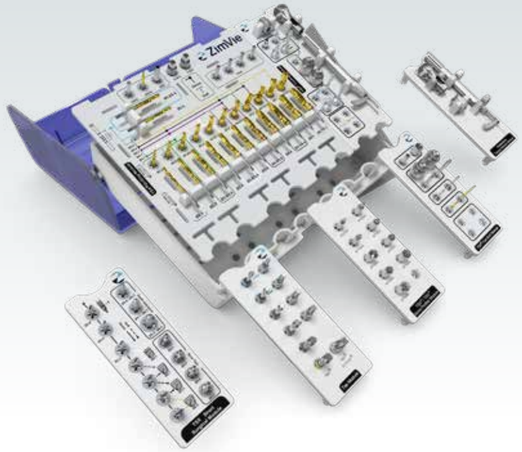

1
1203G
Ø 2,0 mm
Fraise boule

2
0201G
Ø 2,1/1,6 mm
Foret pilote conique,
L 8,0 mm - 11,5 mm

3
DEG
Prolongateur
de foret

4
CLRT2
Extracteur de
piliers NP

5
TLRT2
Extracteur de
piliers d'implants à
hexagone interne

6
PPAR
Jauge de parallélisme
(4 pièces)

7
EZT28D24G
Ø 2,8/2,4 mm,
Foret étagé
L 22 mm

8
EZT24G
Ø 2,4 mm,
Foret
L 22 mm

9
TSV23SG
Ø 2,3 mm,
Foret
L 16 mm

10
TSV28SG
Ø 2,8 mm,
Foret
L 16 mm

11
TSV34D28SG
Ø 3,4/2,8 mm,
Foret étagé
L 16 mm

12
TSV34SG
Ø 3,4 mm,
Foret
L 16 mm

13
TSV38D34SG
Ø 3,8/3,4 mm,
Foret étagé
L 16 mm

14
TSV38SG
Ø 3,8 mm,
Foret
L 16 mm

15
TSV44D38SG
Ø 4,4/3,8 mm,
Foret étagé
L 16 mm

16
TSV44SG
Ø 4,4 mm,
Foret
L 16 mm

Module de forets (inclus dans le TSXKIT)

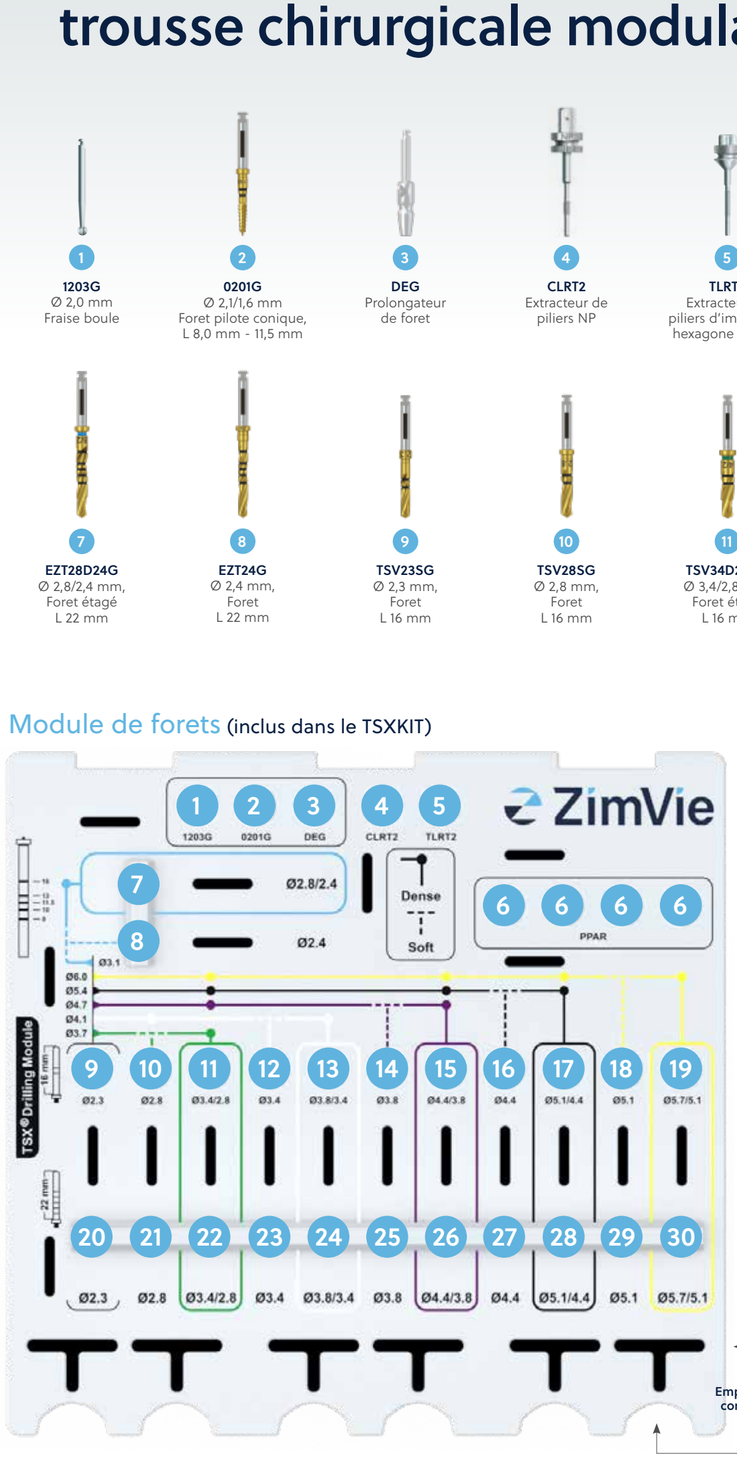

Emplacement pour conditionnement d'implant

17
TSV51D44SG
Ø 5,1/4,4 mm
Foret étagé,
L 16 mm

18
TSV51SG
Ø 5,1 mm,
Foret
L 16 mm

19
TSV57D51SG
Ø 5,7/5,1 mm
Foret étagé
L 16 mm

20
TSV23G
Ø 2,3 mm,
Foret
L 22 mm

21
TSV28G
Ø 2,8 mm,
Foret
L 22 mm

22
TSV34D28G
Ø 3,4/2,8 mm,
Foret étagé
L 22 mm

23
TSV34G
Ø 3,4 mm,
Foret
L 22 mm

24
TSV38D34G
Ø 3,8/3,4 mm,
Foret étagé
L 22 mm

25
TSV38G
Ø 3,8 mm,
Foret
L 22 mm

26
TSV44D38G
Ø 4,4/3,8 mm,
Foret étagé
L 22 mm

27
TSV44G
Ø 4,4 mm,
Foret
L 22 mm

28
TSV51D44G
Ø 5,1/4,4 mm,
Foret étagé
L 22 mm

29
TSV51G
Ø 5,1 mm,
Foret
L 22 mm

30
TSV57D51G
Ø 5,7/5,1 mm,
Foret étagé
L 22 mm

Module d'instrumentation (inclus dans TSXKIT)

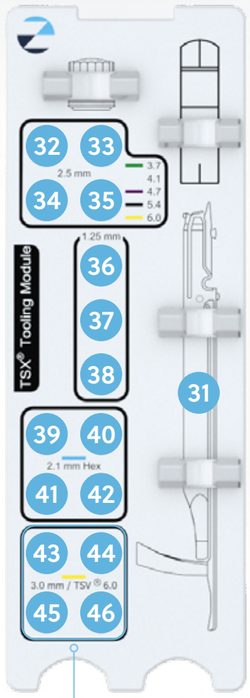

Connecteur de pose hexagonaux de 3,0 mm utilisés avec l'implant TSV de 6,0 mm lorsque le porte-implant est retiré (vendu séparément)



31
ZTIRW
Clé dynamométrique
chirurgicale à couple
élevé (0–90 Ncm)

32
GHX2.5D
Connecteur de pose hexagonal
GemLock® de 2,5 mm pour
contre-angle, court

33
GHX2.5DL
Connecteur de pose hexagonal
GemLock de 2,5 mm pour
contre-angle, long

34
GHX2.5
Connecteur de pose hexagonal
GemLock de 2,5 mm, court

35
GHX2.5L
Connecteur de pose hexagonal
GemLock de 2,5 mm, long

36
HX1.25D
Tournevis hexagonal
de 1,25 mm pour
contre-angle, court

37
HXLGR1.25
Tournevis hexagonal
GemLock de 1,25 mm,
long

38
HXGR1.25
Tournevis hexagonal
GemLock de 1,25 mm,
court

39
CHD2.1
Connecteur de pose hexagonal
GemLock de 2,1 mm pour
contre-angle, court

40
CHDL2.1
Connecteur de pose hexagonal
GemLock de 2,1 mm pour
contre-angle, long

41
CHR2.1
Connecteur de pose hexagonal
GemLock court 2,1 mm

42
CHRL2.1
Connecteur de pose hexagonal
GemLock de 2,1 mm, long

43
RHX3.0DS
Connecteur de pose hexagonal
pour contre-angle,
Ø 3,0 mm x L 21 mm
(vendu séparément)

44
RHX3.0DL
Connecteur de pose hexagonal
pour contre-angle,
Ø 3,0 mm x L 25 mm
(vendu séparément)

45
RHX3.0RS
Connecteur de pose hexagonal,
clé à cliquet,
Ø 3,0 mm x L 17 mm
(vendu séparément)

46
RHX3.0RM
Connecteur de pose hexagonal,
clé à cliquet,
Ø 3,0 mm x L 22 mm
(vendu séparément)

Tableau du contenu du système de trousse chirurgicale modulable TSX

Module de tarauds (TAPMOD)

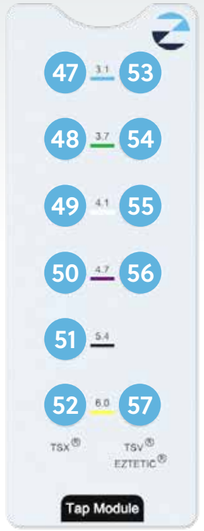

47
TSXTAP31
Ø 3,1 mm
Taraud
chirurgical TSX

48
TSXTAP37
Ø 3,7 mm
Taraud
chirurgical TSX

49
TSXTAP41
Ø 4,1 mm
Taraud
chirurgical TSX

50
TSXTAP47
Ø 4,7 mm
Taraud
chirurgical TSX

51
TSXTAP54
Ø 5,4 mm
Taraud
chirurgical TSX

52
TSXTAP60
Ø 6,0 mm
Taraud
chirurgical TSX

53
ZOPTT30
Ø 3,0 mm
Taraud
chirurgical
Eztetic

54
TT3.7
Ø 3,7 mm
Taraud
chirurgical TSV

55
TT4.1
Ø 4,1 mm
Taraud
chirurgical TSV

56
TT4.7
Ø 4,7 mm
Taraud
chirurgical TSV

57
TT6.0
Ø 6,0 mm
Taraud
chirurgical TSV

Module de profileurs d'os (TSXBPRO)

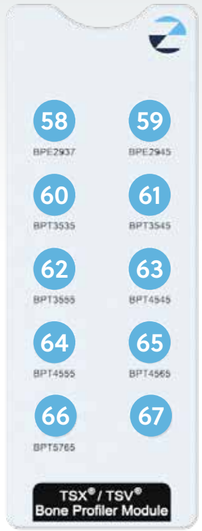

58
BPE2937
Ø 2,9 mm x
P 3,7 mm
Profileur d'os NP

59
BPE2945
Ø 2,9 mm x
P 4,5 mm
Profileur d'os NP

60
BPT3535
Ø 3,5 mm x
P 3,5 mm
Profileur d'os

61
BPT3545
Ø 3,5 mm x
P 4,5 mm
Profileur d'os

62
BPT3555
Ø 3,5 mm x
P 5,5 mm
Profileur d'os

63
BPT4545
Ø 4,5 mm x
P 4,5 mm
Profileur d'os

64
BPT4555
Ø 4,5 mm x
P 5,5 mm
Profileur d'os

65
BPT4565
Ø 4,5 mm x
P 6,5 mm
Profileur d'os

66
BPT5765
Ø 5,7 mm x
P 6,5 mm
Profileur d'os

67
Emplacement
vide

Module de clé dynamométrique prothétique (TSXRESTORTW)

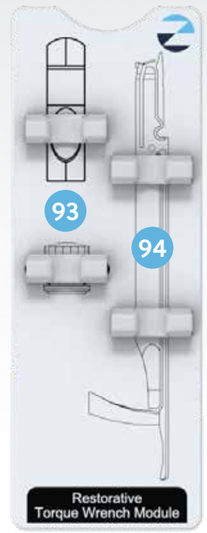

93
TWR*
Clé dynamométrique,
prothétique

94
L-TIRW
Clé dynamométrique
prothétique à
faible couple
(avec adaptateur à
contre-angle C9980)

95
UNPMODTRAY
Plateau modulable, vide, maintient
fermement les instruments pour
contre-angle
(vendu séparément)

Module prothétique pour arcade complète (TSXRESTOR)

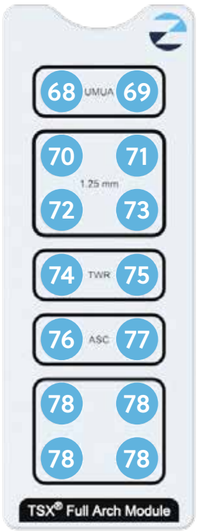

68
UMUA-D
Tournevis pour
Multi-Unit
Universel droit

69
ISO4X4A
Adaptateur
connexion carrée
4x4 pour contre-
angle

70
HXGR1.25
Tournevis
hexagonal
GemLock de
1,25 mm, court

71
HXLGR1.25
Tournevis
hexagonal
GemLock de
1,25 mm, long

72
HX1.25D
Tournevis
hexagonal 1,25 mm,
pour contre-angle,
court

73
HXL1.25D
Tournevis
hexagonal
1,25 mm, pour
contre-angle,
long

74
TW1.25
Tournevis hexagonal
1,25 mm pour clé
dynamométrique,
court

75
TW1.25L
Tournevis hexagonal
1,25 mm pour clé
dynamométrique,
long

76
ASC-SD24
Tournevis
mandrin pour
Ti-Base A avec
canal de vis
désaxé L 24 mm

77
ASC-SD30
Tournevis
mandrin pour
Ti-Base A avec
canal de vis
désaxé L 30 mm

78
Emplacement
vide

Module chirurgical TSX Short (TSXSMOD)

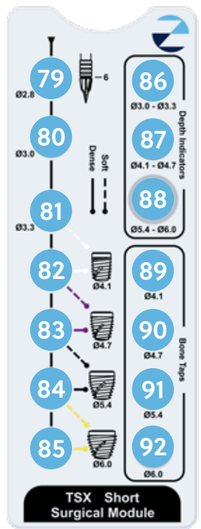

79
IMDR28L
Foret pilote
Ø 2,8 mm, long

80
TSX3D6
Foret conique
Ø 3,0 mm,
L 6 mm

81
TSX33D6
Foret de
façonnage
Ø 3,3 mm,
L 6 mm

82
TSX41D6
Foret de
façonnage
Ø 4,1 mm,
L 6 mm

83
TSX47D6
Foret de
façonnage
Ø 4,7 mm,
L 6 mm

84
IMDR56
Foret de
façonnage
Ø 5,4 mm,
L 6 mm

85
IMDR66
Foret de
façonnage
Ø 6 mm,
L 6 mm

86
TSXDI3D33D
Jauge de
profondeur
double,
Ø 3,0 mm,
Ø 3,3 mm

87
TSXDI41D47D
Jauge de
profondeur
double,
Ø 4,1 mm,
Ø 4,7 mm

88
TSXDI54D6D
Jauge de
profondeur
double,
Ø 5,4 mm,
Ø 6,0 mm

89
TSXTAP41D6
Taraud
chirurgical
Ø 4,1 mm,
L 6 mm

90
TSXTAP47D6
Taraud
chirurgical
Ø 4,7 mm,
L 6 mm

91
TSXTAP54D6
Taraud
chirurgical
Ø 5,4 mm,
L 6 mm

92
TSXTAP60D6
Taraud
chirurgical
Ø 6,0 mm,
L 6 mm

Pour plus d'informations, consulter ZimVie.com

ZimVie US Corp LLC
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens,
FL 33410, États-Unis
Téléphone : +1-561-776-6700
Télécopie : +1-561-776-1272
dentalCS@ZimVie.com

ZimVie France SAS
Bâtiment Québec
19 Rue d'Arcueil
94528 Rungis Cedex
Tel. : 0141-05-43-43
Fax : 0141-05-43-40
ZV.commandes@ZimVie.com

*** REMARQUE :** le TWR est inclus dans le module rempli TSXRESTORTW et peut être rangé en option dans les deux supports en silicone de gauche numérotés 93. Suivre les instructions de stérilisation du fabricant pour le TWR.

Les images sont représentatives et peuvent ne pas être à l'échelle ou ne pas correspondre à la géométrie ou à la couleur exacte des instruments réels.

Sauf indication contraire, comme indiqué dans les présentes, toutes les marques de commerce et tous les droits de propriété intellectuelle sont la propriété de ZimVie Inc. et de ses filiales ; et tous les produits sont fabriqués par une ou plusieurs des filiales dentaires de ZimVie US Corp LLC (Biomet 3i, LLC, etc.) et distribués par ZimVie US Corp LLC et par ses partenaires de commercialisation autorisés. Les piliers OverdenSURE et les piliers Multi-Unit universels sont fabriqués par Terrats Medical S.R.L. Le TWR est fabriqué par Josef Ganter GmbH. Les dispositifs Z-TIRW et L-TIRW sont fabriqués par Elos Medtech Pinol A/S. Classification des dispositifs médicaux de l'UE : implant TSX (IIb), implant TSV (IIb), composants prothétiques (IIa). Les implants dentaires sont conçus pour remplacer des dents unitaires manquantes (prothèses unitaires), plusieurs dents manquantes ou pour restaurer l'arcade dentaire chez les patients édentés (bridge fixe implanto-porté, prothèse amovible supra-implantaire). Les produits présentés dans ce document ne sont pas remboursables en France. Pour les autres pays, veuillez consulter les lois et réglementations locales. Pour plus d'informations sur le produit, consultez l'étiquette individuelle ou la notice d'utilisation du produit. L'autorisation et la disponibilité du produit peuvent être limitées à certains pays/certaines régions. Ce document s'adresse uniquement aux praticiens et n'a pas pour objectif de fournir un avis ou des recommandations d'ordre médical. La distribution à tout autre destinataire est formellement interdite. Ce document ne peut être ni copié ni réimprimé sans l'autorisation écrite expresse de ZimVie. ZVINST2414-GLBL-FR REV. B 05/26 ©2026 ZimVie. Tous droits réservés.

CE 2797 CE 0051

Le numéro de l'ON applicable à chaque dispositif se trouve sur l'étiquetage de produit, le cas échéant.

ZimVie