Tabella per la disposizione del sistema del kit chirurgico modulare TSX®

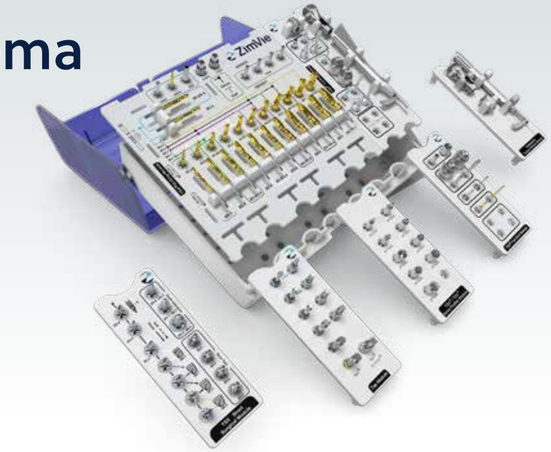

1
1203G
Ø2,0 mm
Fresa a rosetta

2
0201G
Ø2,1/1,6 mm
Fresa pilota conica,
8,0 mm - 11,5 mmL

3
DEG
Prolunga della fresa

4
CLRT2
Strumento di rimozione per abutment NP

5
TLRT2
Strumento di rimozione per abutment con esagono interno

6
PPAR
Strumento di parallelismo (q.tà: 4)

7
EZT28D24G
Fresa a gradini
Ø2,8/2,4 mm, 22 mmL

8
EZT24G
Fresa
Ø2,4 mm, 22 mmL

9
TSV23SG
Fresa
Ø2,3 mm, 16 mmL

10
TSV28SG
Fresa
Ø2,8 mm, 16 mmL

11
TSV34D28SG
Fresa a gradini
Ø3,4/2,8 mm, 16 mmL

12
TSV34SG
Fresa
Ø3,4 mm, 16 mmL

13
TSV38D34SG
Fresa a gradini
Ø3,8/3,4 mm, 16 mmL

14
TSV38SG
Fresa
Ø3,8 mm, 16 mmL

15
TSV44D38SG
Fresa a gradini
Ø4,4/3,8 mm, 16 mmL

16
TSV44SG
Fresa
Ø4,4 mm, 16 mmL

Modulo frese (incluso in TSXKIT)

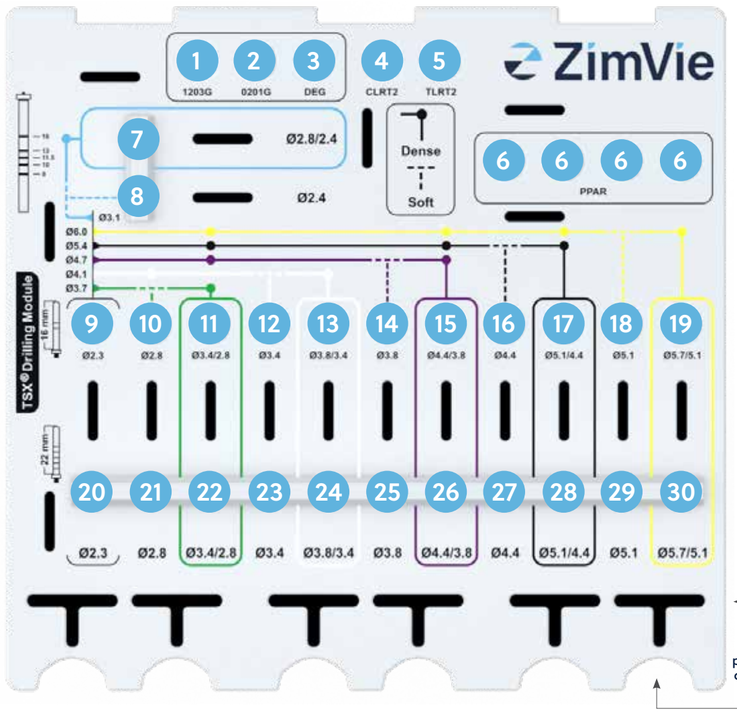

Slot per la pianificazione dell'impianto

17
TSV51D44SG
Ø5,1/4,4 mm
Fresa a gradini,
16 mmL

18
TSV51SG
Fresa
Ø5,1 mm, 16 mmL

19
TSV57D51SG
Fresa a gradini
Ø5,7/5,1 mm, 16 mmL

20
TSV23G
Fresa
Ø2,3 mm, 22 mmL

21
TSV28G
Fresa
Ø2,8 mm, 22 mmL

22
TSV34D28G
Fresa a gradini
Ø3,4/2,8 mm, 22 mmL

23
TSV34G
Fresa
Ø3,4 mm, 22 mmL

24
TSV38D34G
Fresa a gradini
Ø3,8/3,4 mm, 22 mmL

25
TSV38G
Fresa
Ø3,8 mm, 22 mmL

26
TSV44D38G
Fresa a gradini
Ø4,4/3,8 mm, 22 mmL

27
TSV44G
Fresa 4,
Ø4 mm, 22 mmL

28
TSV51D44G
Fresa a gradini
Ø5,1/4,4 mm, 22 mmL

29
TSV51G
Fresa
Ø5,1 mm, 22 mmL

30
TSV57D51G
Fresa a gradini
Ø5,7/5,1 mm, 22 mmL

Modulo strumentazione
(incluso in TSXKIT)

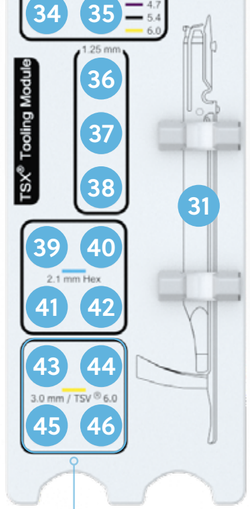

Driver esagonali da 3,0 mm da usare con l'impianto TSV da 6,0 mmD quando viene rimosso il dispositivo di fissaggio
(acquistabili separatamente)

31
ZTIRW
Cricchetto con indicazione di torque elevato (0-90 Ncm)

32
GHX2.5D
Driver esagonale con blocco a scatto GemLock®, 2,5 mm, corto

33
GHX2.5DL
Driver esagonale con blocco a scatto GemLock, 2,5 mm, lungo

34
GHX2.5
Driver esagonale GemLock, 2,5 mm, corto

35
GHX2.5L
Driver esagonale GemLock, 2,5 mm, lungo

36
HX1.25D
Driver esagonale, 1,25 mm, blocco a scatto, corto

37
HXLGR1.25
Driver esagonale GemLock, 1,25 mm, lungo

38
HXGR1.25
Driver esagonale GemLock, 1,25 mm, corto

39
CHD2.1
Driver esagonale GemLock, 2,1 mm, blocco a scatto, corto

40
CHDL2.1
Driver esagonale GemLock, 2,1 mm, blocco a scatto, lungo

41
CHR2.1
Chiave esagonale GemLock
da 2,1 mm, corta

42
CHRL2.1
Strumento esagonale GemLock, 2,1 mm, lungo

43
RHX3.0DS
Cacciavite esagonale, blocco a scatto
3,0 mmD x 21 mmL
(acquistabili separatamente)

44
RHX3.0DL
Cacciavite esagonale, blocco a scatto
Ø3,0 mm x 25 mmL
(acquistabili separatamente)

45
RHX3.0RS
Cacciavite esagonale, cricchetto,
Ø3,0 mm x 17 mmL
(acquistabili separatamente)

46
RHX3.0RM
Cacciavite esagonale, cricchetto,
Ø3,0 mm x 22 mmL
(acquistabili separatamente)

Tabella per la disposizione del sistema del kit chirurgico modulare TSX

Modulo maschiatore (TAPMOD)

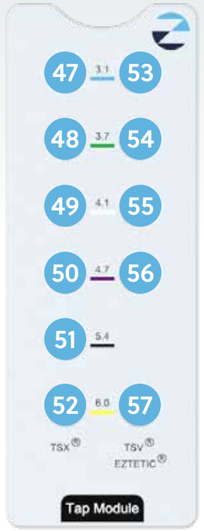

47 **TSXTAP31**
Ø3,1 mm
Maschiatore osseo TSX

48 **TSXTAP37**
Ø3,7 mm
Maschiatore osseo TSX

49 **TSXTAP41**
Ø4,1 mm
Maschiatore osseo TSX

50 **TSXTAP47**
Ø4,7 mm
Maschiatore osseo TSX

51 **TSXTAP54**
Ø5,4 mm
Maschiatore osseo TSX

52 **TSXTAP60**
Ø6,0 mm
Maschiatore osseo TSX

53 **ZOPTT30**
Ø3,0 mm
Maschiatore osseo Eztetic

54 **TT3.7**
Ø3,7 mm
Maschiatore osseo TSV

55 **TT4.1**
Ø4,1 mm
Maschiatore osseo TSV

56 **TT4.7**
Ø4,7 mm
Maschiatore osseo TSV

57 **TT6.0**
Ø6,0 mm
Maschiatore osseo TSV

Modulo di profilatura ossea (TSXBPRO)

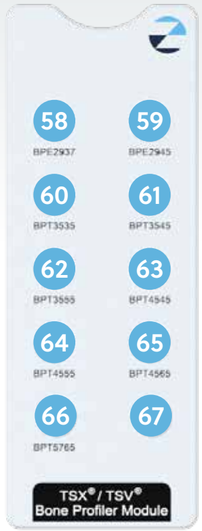

58 **BPE2937**
Ø2,9 mm x 3,7 mmP
Profilatore osseo NP

59 **BPE2945**
Ø2,9 mm x 4,5 mmP
Profilatore osseo NP

60 **BPT3535**
Ø3,5 mm x 3,5 mmP
Profilatore osseo

61 **BPT3545**
Ø3,5 mm x 4,5 mmP
Profilatore osseo

62 **BPT3555**
Ø3,5 mm x 5,5 mmP
Profilatore osseo

63 **BPT4545**
Ø4,5 mm x 4,5 mmP
Profilatore osseo

64 **BPT4555**
Ø4,5 mm x 5,5 mmP
Profilatore osseo

65 **BPT4565**
Ø4,5 mm x 6,5 mmP
Profilatore osseo

66 **BPT5765**
Ø5,7 mm x 6,5 mmP
Profilatore osseo

67 Scomparto vuoto

Modulo chiave dinamometrica protesica (TSXRESTORTW)

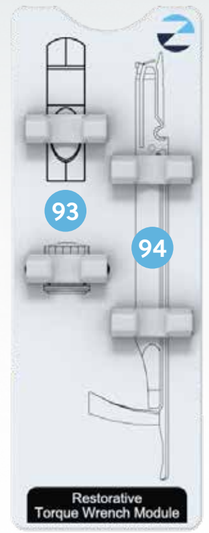

93 **TWR***
Chiave dinamometrica protesica

94 **L-TIRW**
Chiave a cricchetto con indicazione del torque basso (include adattatore per blocco a scatto C9980)

95 **UNPMODTRAY**
Vassoio modulare, vuoto, contiene in sicurezza gli strumenti con blocco a scatto
(acquistabili separatamente)

Modulo per restauro dell'arcata completa (TSXRESTOR)

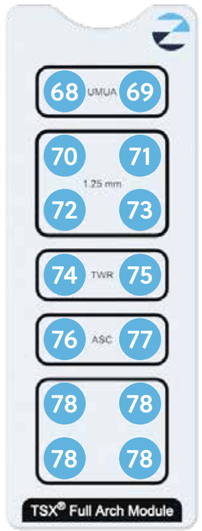

68 **UMUA-D**
Driver multi-unit universale

69 **ISO4X4A**
Driver con blocco a scatto 4x4

70 **HXGR1.25**
Driver esagonale GemLock, 1,25 mm, corto

71 **HXLGR1.25**
Driver esagonale GemLock, 1,25 mm, lungo

72 **HX1.25D**
1,25 mm Driver esagonale, blocco a scatto, corto

73 **HXL1.25D**
1,25 mm Driver esagonale, blocco a scatto, lungo

74 **TW1.25**
1,25 mm Driver esagonale per chiave dinamometrica, corto

75 **TW1.25L**
1,25 mm Driver esagonale per chiave dinamometrica, lungo

76 **ASC-SD24**
Cacciavite per canale della vite angolato, 24 mmL

77 **ASC-SD30**
Cacciavite per canale della vite angolato, 30 mmL

78 Scomparto vuoto

Modulo chirurgico per impianti TSX corti (TSXSMOD)

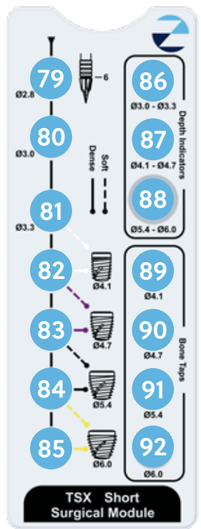

79 **IMDR28L**
Fresa a punta iniziale, Ø2,8 mm, lunga

80 **TSX3D6**
Fresa conica Ø3,0 mm, 6 mmL

81 **TSX33D6**
Fresa per profilo, Ø3,3 mm, 6 mmL

82 **TSX41D6**
Fresa per profilo, Ø4,1 mm, 6 mmL

83 **TSX47D6**
Fresa per profilo, Ø4,7 mm, 6 mmL

84 **IMDR56**
Fresa per profilo, Ø5,4 mm, 6 mmL

85 **IMDR66**
Fresa per profilo, Ø6 mm, 6 mmL

86 **TSXDI3D33D**
Indicatore di profondità a doppio lato, Ø3,0 mm, Ø3,3 mm

87 **TSXDI41D47D**
Indicatore di profondità a doppio lato, Ø4,1 mm, Ø4,7 mm

88 **TSXDI54D6D**
Indicatore di profondità a doppio lato, Ø5,4 mm, Ø6,0 mm

89 **TSXTAP41D6**
Maschiatore osseo
Ø4,1 mm, 6 mmL

90 **TSXTAP47D6**
Maschiatore osseo
Ø4,7 mm, 6 mmL

91 **TSXTAP54D6**
Maschiatore osseo
Ø5,4 mm, 6 mmL

92 **TSXTAP60D6**
Maschiatore osseo
Ø6,0 mm, 6 mmL

Per ulteriori informazioni, visita il sito ZimVie.com

ZimVie US Corp LLC
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Telefono: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272
dentalCS@ZimVie.com

ZimVie Italy s.r.l.
Viale Italia n.205/D
31015 Conegliano (TV)
Tel: + 39-0438-37681
ZimVie.Italy@ZimVie.com

*** NOTA:** il TWR è incluso nel modulo popolato TSXRESTORTW e può essere facoltativamente conservato in due supporti in silicone di sinistra numerati 93. Per il TWR, seguire le istruzioni di sterilizzazione del fabbricante.

Le immagini mostrate sono di natura rappresentativa e potrebbero non essere in scala e non visualizzare la geometria o il colore esatti dei componenti effettivi.

Salvo diverse indicazioni, tutti i marchi e i diritti di proprietà intellettuale qui indicati sono di proprietà di ZimVie Inc. e delle sue società affiliate. Tutti i prodotti sono fabbricati da una o più consociate di ZimVie US Corp LLC del settore dentale (Biomet 3i, LLC, ecc.) e sono distribuiti da ZimVie US Corp LLC e dai suoi partner commerciali autorizzati. OverdenSURE e gli abutment multi-unit universali sono prodotti da Terrats Medical S.R.L. TWR è prodotto da Josef Ganter GmbH. ZTIRW e L-TIRW sono prodotti da Elos Medtech Pinol A/S. Classificazione UE dei dispositivi medici: Impianto TSX (IIb), impianto TSV (IIb), componenti protesici (IIa). Lo scopo degli impianti dentali è sostituire singoli denti mancanti (restauri di dente singolo), più denti o ripristinare arcate dentali edentule (ponte fisso trattenuto da impianto, overdenture supportata da impianto). In Francia, i prodotti mostrati in questo materiale non sono rimborsabili. Per gli altri Paesi, consultare le leggi e le normative locali. Per ulteriori informazioni, vedere l'etichetta del singolo prodotto o le istruzioni per l'uso specifiche. L'autorizzazione alla distribuzione dei prodotti e la loro disponibilità potrebbero essere limitate a determinati Paesi/aree geografiche. Questo materiale è destinato esclusivamente ai medici e non include indicazioni o raccomandazioni di carattere medico. È vietata la distribuzione a qualsiasi altro destinatario. Questo materiale non può essere copiato o ristampato senza l'esplicito consenso scritto di ZimVie. ZVINST2414-GLBL-IT REV B 05/26 ©2026 ZimVie. Tutti i diritti riservati.

CE 2797 CE 0051

Il numero NB applicabile a ciascun dispositivo è riportato sull'etichetta del prodotto, se pertinente.

ZimVie