Gráfico do esquema do sistema de kit cirúrgico modular TSX®

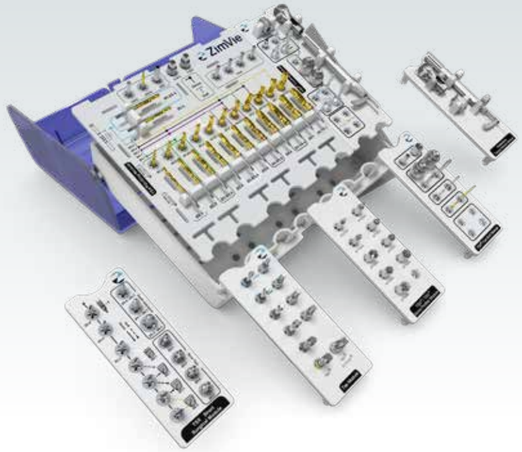

1 **1203G**
2,0 mm (D)
Broca esférica

2 **0201G**
2,1/1,6 mm (D)
Broca-piloto cónica de 8,0 mm–11,5 mm (C)

3 **DEG**
Extensor de broca

4 **CLRT2**
Ferramenta de remoção para pilares NP

5 **TLRT2**
Ferramenta de remoção para pilares hexagonais internos

6 **PPAR**
Paralelizador (Qtd.: 4)

7 **EZT28D24G**
Broca escalonada de 2,8/2,4 mm (D), 22 mm (C)

8 **EZT24G**
Broca de 2,4 mm (D), 22 mm (C)

9 **TSV23SG**
Broca de 2,3 mm (D), 16 mm (C)

10 **TSV28SG**
Broca de 2,8 mm (D), 16 mm (C)

11 **TSV34D28SG**
Broca escalonada de 3,4/2,8 mm (D), 16 mm (C)

12 **TSV34SG**
Broca de 3,4 mm (D), 16 mm (C)

13 **TSV38D34SG**
Broca escalonada de 3,8/3,4 mm (D), 16 mm (C)

14 **TSV38SG**
Broca de 3,8 mm (D), 16 mm (C)

15 **TSV44D38SG**
Broca escalonada de 4,4/3,8 mm (D), 16 mm (C)

16 **TSV44SG**
Broca de 4,4 mm (D), 16 mm (C)

Módulo de broca (incluído no TSXKIT)

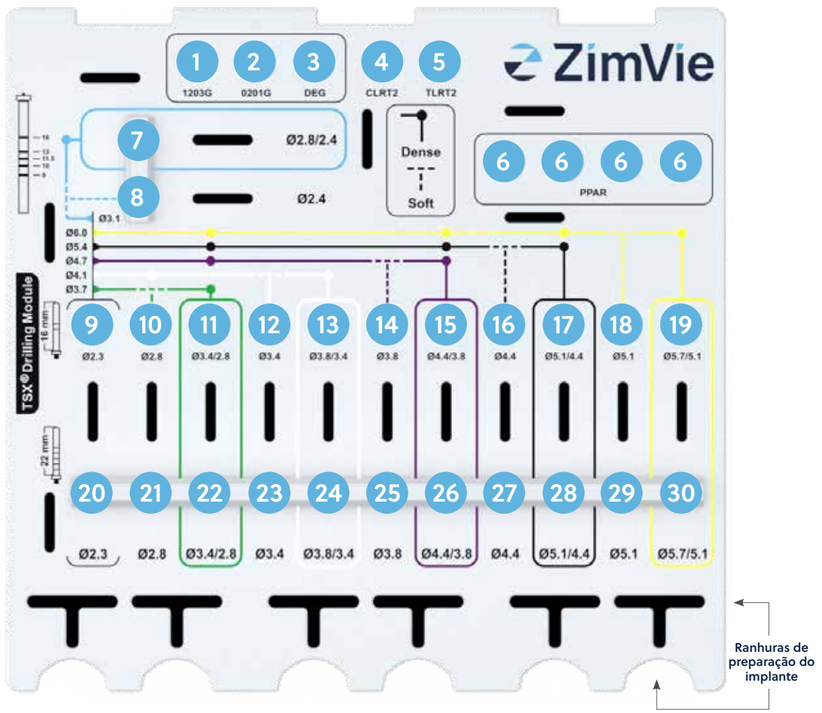

Ranhuras de preparação do implante

17 **TSV51D44SG**
5,1/4,4 mm (D)
Broca escalonada, 16 mm (C)

18 **TSV51SG**
Broca de 5,1 mm (D), 16 mm (C)

19 **TSV57D51SG**
Broca escalonada de 5,7/5,1 mm (D), 16 mm (C)

20 **TSV23G**
Broca de 2,3 mm (D), 22 mm (C)

21 **TSV28G**
Broca de 2,8 mm (D), 22 mm (C)

22 **TSV34D28G**
Broca escalonada de 3,4/2,8 mm (D), 22 mm (C)

23 **TSV34G**
Broca de 3,4 mm (D), 22 mm (C)

24 **TSV38D34G**
Broca escalonada de 3,8/3,4 mm (D), 22 mm (C)

25 **TSV38G**
Broca de 3,8 mm (D), 22 mm (C)

26 **TSV44D38G**
Broca escalonada de 4,4/3,8 mm (D), 22 mm (C)

27 **TSV44G**
Broca de 4,4 mm (D), 22 mm (C)

28 **TSV51D44G**
Broca escalonada de 5,1/4,4 mm (D), 22 mm (C)

29 **TSV51G**
Broca de 5,1 mm (D), 22 mm (C)

30 **TSV57D51G**
Broca escalonada de 5,7/5,1 mm (D), 22 mm (C)

Módulo de ferramentas (incluído no TSXKIT)

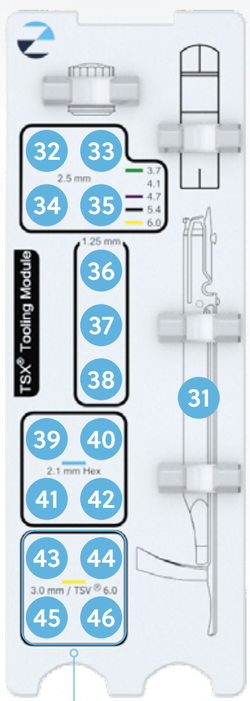

Chaves hexagonais de 3,0 mm utilizadas com o implante TSV de 6,0 mm (D) quando o suporte de fixação é removido (adquiridas em separado)



31 **ZTIRW**
Chave de roquete indicadora de torque elevado (0–90 Ncm)

32 **GHX2.5D**
Broca hexagonal GemLock® de 2,5 mm, com encaixe de contra-ângulo, curta

33 **GHX2.5DL**
Chave hexagonal GemLock de 2,5 mm, com encaixe de contra-ângulo, longa

34 **GHX2.5**
Chave hexagonal GemLock de 2,5 mm, curta

35 **GHX2.5L**
Chave hexagonal GemLock de 2,5 mm, longa

36 **HX1.25D**
Chave hexagonal de 1,25 mm, contra-ângulo, curta

37 **HXLGR1.25**
Chave hexagonal GemLock de 1,25 mm, longa

38 **HXGR1.25**
Chave hexagonal GemLock de 1,25 mm, curta

39 **CHD2.1**
Chave hexagonal GemLock de 2,1 mm, contra-ângulo, curta

40 **CHDL2.1**
Chave hexagonal GemLock de 2,1 mm, contra-ângulo, longa

41 **CHR2.1**
Ferramenta hexagonal GemLock de 2,1 mm, curta

42 **CHRL2.1**
Ferramenta hexagonal GemLock de 2,1 mm, longa

43 **RHX3.0DS**
Chave hexagonal, contra-ângulo, 3,0 mm (D) x 21 mm (C)
(adquirida em separado)

44 **RHX3.0DL**
Chave hexagonal, contra-ângulo, 3,0 mm (D) x 25 mm (C)
(adquirida em separado)

45 **RHX3.0RS**
Chave hexagonal, roquete, 3,0 mm (D) x 17 mm (C)
(adquirida em separado)

46 **RHX3.0RM**
Chave hexagonal, roquete, 3,0 mm (D) x 22 mm (C)
(adquirida em separado)

Gráfico do esquema do sistema de kit cirúrgico modular TSX

Módulo de toque (TAPMOD)

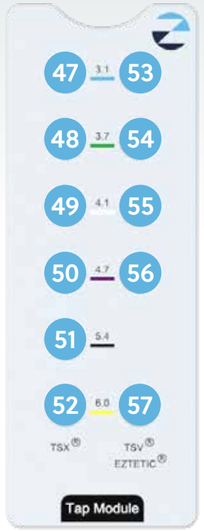

47 **TSXTAP31**
3,1 mm (D)
Formador de rosca TSX

48 **TSXTAP37**
3,7 mm (D)
Formador de rosca TSX

49 **TSXTAP41**
4,1 mm (D)
Formador de rosca TSX

50 **TSXTAP47**
4,7 mm (D)
Formador de rosca TSX

51 **TSXTAP54**
5,4 mm (D)
Formador de rosca TSX

52 **TSXTAP60**
6,0 mm (D)
Formador de rosca TSX

53 **ZOPTT30**
3,0 mm (D)
Formador de rosca Eztetic

54 **TT3.7**
3,7 mm (D)
Formador de rosca TSV

55 **TT4.1**
4,1 mm (D)
Formador de rosca TSV

56 **TT4.7**
4,7 mm (D)
Formador de rosca TSV

57 **TT6.0**
6,0 mm (D)
Formador de rosca TSV

Módulo de perfilador ósseo (TSXBPRO)

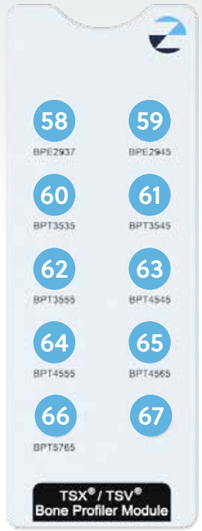

58 **BPE2937**
2,9 mm (D) x 3,7 mm (P)
Perfilador ósseo NP

59 **BPE2945**
2,9 mm (D) x 4,5 mm (P)
Perfilador ósseo NP

60 **BPT3535**
3,5 mm (D) x 3,5 mm (P)
Perfilador ósseo

61 **BPT3545**
3,5 mm (D) x 4,5 mm (P)
Perfilador ósseo

62 **BPT3555**
3,5 mm (D) x 5,5 mm (P)
Perfilador ósseo

63 **BPT4545**
4,5 mm (D) x 4,5 mm (P)
Perfilador ósseo

64 **BPT4555**
4,5 mm (D) x 5,5 mm (P)
Perfilador ósseo

65 **BPT4565**
4,5 mm (D) x 6,5 mm (P)
Perfilador ósseo

66 **BPT5765**
5,7 mm (D) x 6,5 mm (P)
Perfilador ósseo

67 Anilha vazia

Módulo de chave de torque de restauração (TSXRESTORTW)

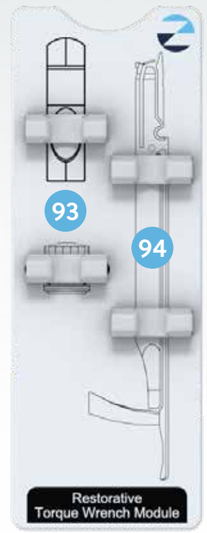

93 **TWR***
Chave de torque, restauração

94 **L-TIRW**
Chave de roquete indicadora de torque reduzido (inclui adaptador de contra-ângulo C9980)

Módulo de restauração de arcada completa (TSXRESTOR)

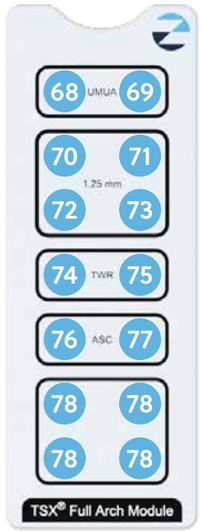

68 **UMUA-D**
Chave universal para restaurações múltiplas

69 **ISO4X4A**
Porta implantes contra-ângulo 4x4

70 **HXGR1.25**
Chave hexagonal GemLock de 1,25 mm, curta

71 **HXLGR1.25**
Chave hexagonal GemLock de 1,25 mm, longa

72 **HX1.25D**
1,25 mm Chave hexagonal, contra-ângulo, curta

73 **HXL1.25D**
1,25 mm Chave hexagonal, contra-ângulo, longa

74 **TW1.25**
1,25 mm Chave de torque hexagonal, curta

75 **TW1.25L**
1,25 mm Chave de torque hexagonal, longa

76 **ASC-SD24**
Chave de parafusos com canal de parafuso angulado, 24 mm (C)

77 **ASC-SD30**
Chave de parafusos com canal de parafuso angulado, 30 mm (C)

78 Anilha vazia

Módulo cirúrgico para implantes curtos TSX (TSXSMOD)

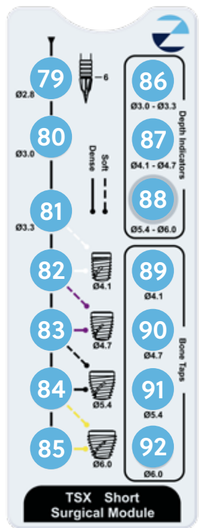

79 **IMDR28L**
Broca inicial de 2,8 mm (D), longa

80 **TSX3D6**
Broca cónica de 3,0 mm (D), 6 mm (C)

81 **TSX33D6**
Broca de modelação de 3,3 mm (D), 6 mm (C)

82 **TSX41D6**
Broca de modelação de 4,1 mm (D), 6 mm (C)

83 **TSX47D6**
Broca de modelação de 4,7 mm (D), 6 mm (C)

84 **IMDR56**
Broca de modelação de 5,4 mm (D), 6 mm (C)

85 **IMDR66**
Broca de modelação de 6 mm (D), 6 mm (C)

86 **TSXDI3D33D**
Indicador de profundidade de dupla face, 3,0 mm (D), 3,3 mm (D)

87 **TSXDI41D47D**
Indicador de profundidade de dupla face, 4,1 mm (D), 4,7 mm (D)

88 **TSXDI54D6D**
Indicador de profundidade de dupla face, 5,4 mm (D), 6,0 mm (D)

89 **TSXTAP41D6**
Formador de rosca de 4,1 mm (D), 6 mm (C)

90 **TSXTAP47D6**
Formador de rosca de 4,7 mm (D), 6 mm (C)

91 **TSXTAP54D6**
Formador de rosca de 5,4 mm (D), 6 mm (C)

92 **TSXTAP60D6**
Formador de rosca de 6,0 mm (D), 6 mm (C)

95 **UNPMODTRAY**
Tabuleiro modular, vazio, contém em segurança instrumentos com fecho
(adquirido em separado)

Para obter mais informações, visite ZimVie.com

ZimVie US Corp LLC
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Telefone: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272
dentalCS@ZimVie.com

ZimVie Spain S.L.U.
WTC Almeda Park, Ed. 4, Pl. 2
C/Tirso de Molina, 40 (entrada Plaça de la Pau)
08940, Cornellà de Llobregat, Espanha
Atención al cliente: 800-827-836
Fax para pedidos: +34-93-445-81-36
ZV.pedidos@ZimVie.com

*** NOTA:** O TWR está incluído no módulo preenchido TSXRESTORTW e pode ser opcionalmente armazenado nos dois suportes de silicone esquerdos com a numeração 93. Siga as instruções de esterilização do fabricante para TWR.

As imagens apresentadas têm natureza meramente exemplificativa e podem não estar à escala ou apresentar a geometria ou cor exatas dos componentes reais.

Salvo indicação em contrário, conforme mencionado no presente documento, todas as marcas comerciais e os direitos de propriedade intelectual são propriedade da ZimVie Inc. e das suas afiliadas, e todos os produtos são fabricados por uma ou mais subsidiárias da divisão de medicina dentária da ZimVie US Corp LLC (Biomet 3i, LLC, etc.) e distribuídos pela ZimVie US Corp LLC e pelos seus parceiros de comercialização autorizados. Os pilares OverdenSURE e os pilares universais de restaurações múltiplas são fabricados pela Terrats Medical S.R.L. O TWR é fabricado pela Josef Ganter GmbH. ZTIRW e L-TIRW são fabricados pela Elos Medtech Pinol A/S. Classificação da UE relativa a dispositivos médicos: Implante TSX (IIb), implante TSV (IIb), componentes de restauração (IIa). Os implantes dentários destinam-se a substituir dentes individuais em falta (restaurações de um único dente), vários dentes ou restaurar arcadas dentárias edêntulas (ponte fixa retida por implantes, sobredentadura suportada por implantes). Os produtos apresentados neste material de apoio não são elegíveis para reembolso em França. Para outros países, consulte as leis e regulamentos locais. Para obter informações adicionais sobre os produtos, consulte a rotulagem individual dos produtos ou as instruções de utilização respetivas. Os produtos podem não estar disponíveis ou autorizados em determinados países/regiões. Este material destina-se apenas a profissionais médicos e não constitui parecer ou recomendações médicas. É proibida a distribuição a qualquer outro destinatário. Este material não pode ser copiado nem reproduzido sem o consentimento expresso, por escrito, da ZimVie. ZVINST2414-GLBL-PT REV B 05/26 ©2026 ZimVie. Todos os direitos reservados.

CE 2797 CE 0051

O número do ON aplicável a cada dispositivo pode ser encontrado na rotulagem do produto, se aplicável.

ZimVie